

<b>Nom</b> HUIFENG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CHEN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/07/1977	<b>Profession</b> STEEL HELP
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7826	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 151 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,9 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 69 %

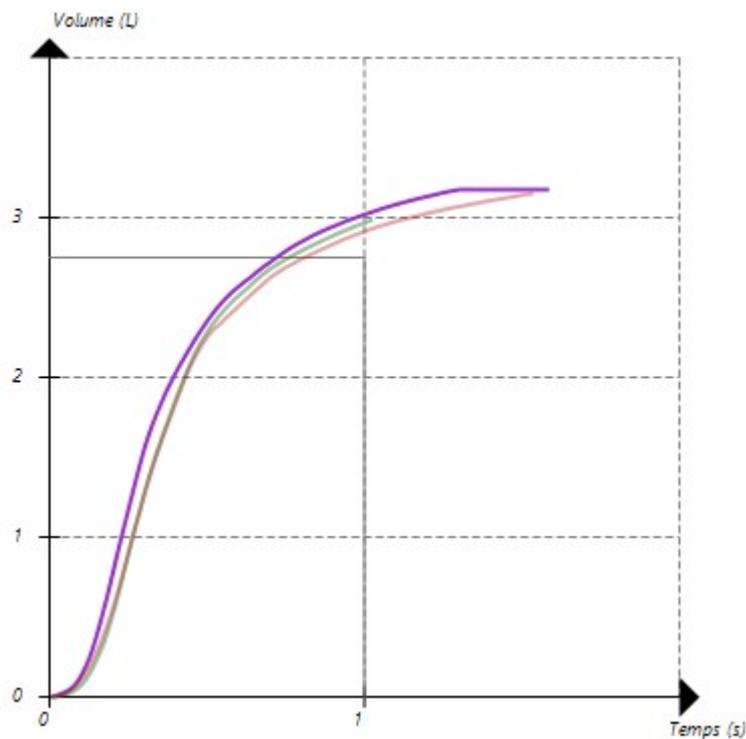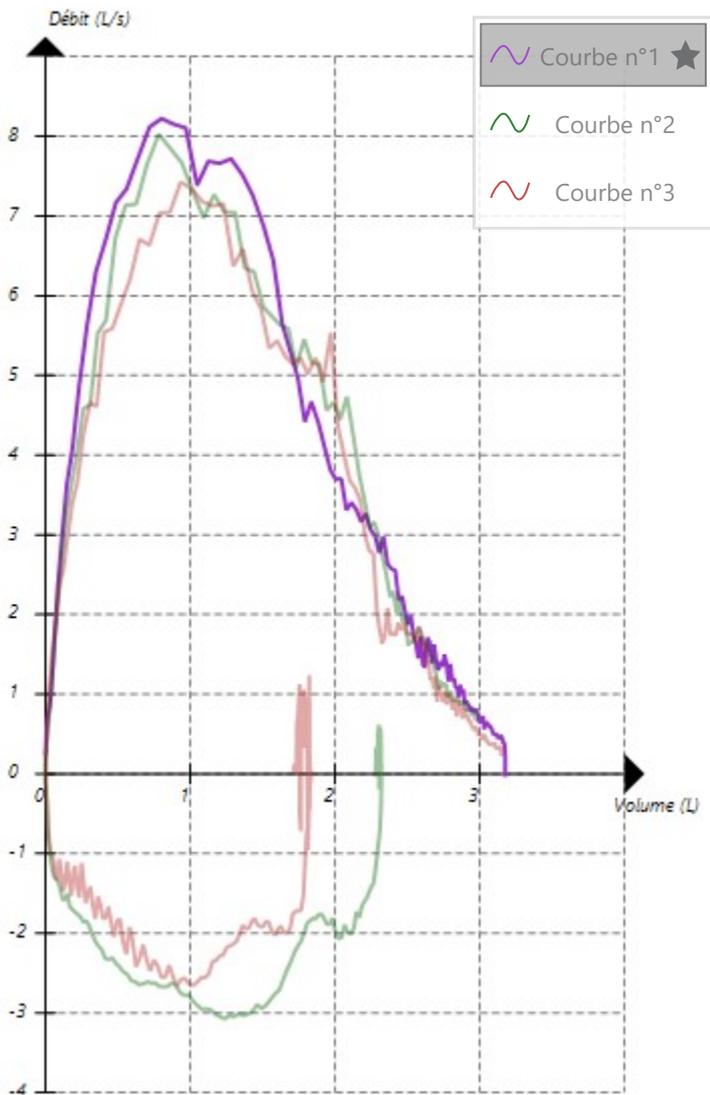

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,18 L	3,00 L	3,15 L	3,47 L	91,64 %
VEMS	3,09 L	3,00 L	2,99 L	2,75 L	112,36 %
DEP	8,34 L/s	8,33 L/s	7,57 L/s	7,72 L/s	108,03 %
VEMS/ CVF	97,17 %	100,00 %	94,92 %	78,15 %	124,34 %
Durée d'expiration	1,31 s	1,06 s	1,56 s	-	
DEMM	5,16 L/s	5,83 L/s	4,93 L/s	2,66 L/s	193,98 %
DEMM/ CVF	1,62 s-1	1,94 s-1	1,57 s-1	0,77 s-1	210,39 %
DE75	8,26 L/s	8,21 L/s	6,91 L/s	-	
DE50	6,51 L/s	5,55 L/s	5,49 L/s	-	
DE25	2,61 L/s	3,07 L/s	2,15 L/s	-	