

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SALIF</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1997</b>	<b>Profession EXCAVATEUR OPERATEUR</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 10305</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 180 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 61 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 23,7 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 57 %

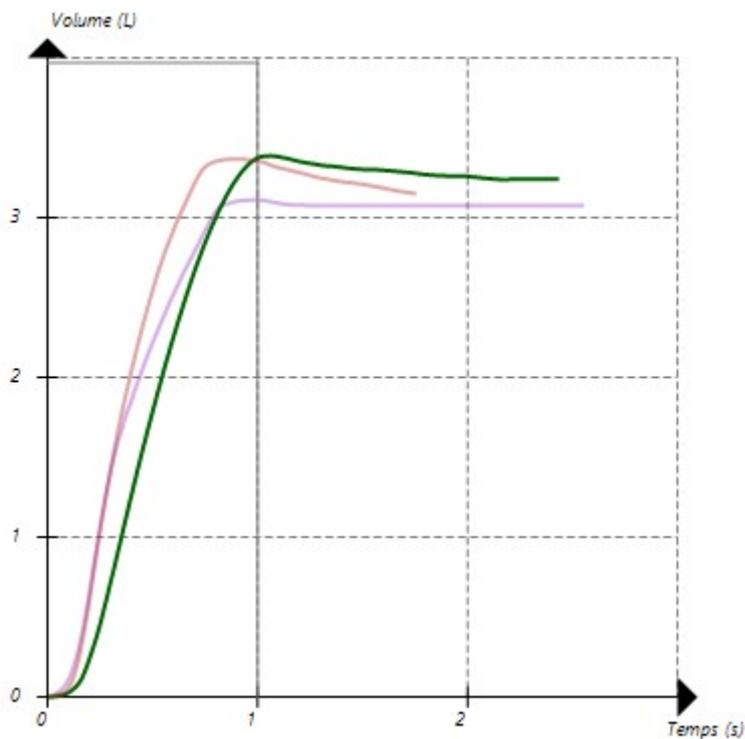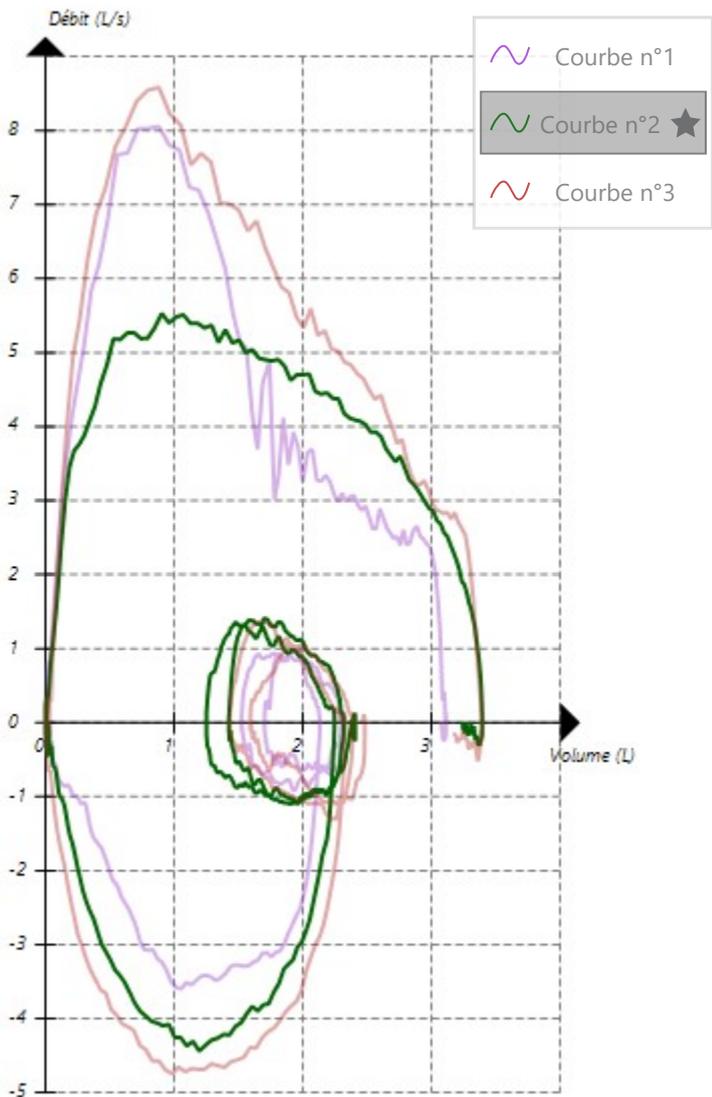

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,11 L	3,39 L	3,37 L	4,73 L	71,67 %
VEMS	3,11 L	3,39 L	3,37 L	3,97 L	85,39 %
DEP	8,26 L/s	5,57 L/s	8,74 L/s	9,94 L/s	56,04 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,99 s	1,07 s	0,91 s	-	
DEMM	4,83 L/s	4,92 L/s	6,24 L/s	4,35 L/s	113,10 %
DEMM/ CVF	1,55 s-1	1,45 s-1	1,85 s-1	0,92 s-1	157,61 %
DE75	7,87 L/s	5,40 L/s	8,56 L/s	-	
DE50	5,30 L/s	4,91 L/s	6,34 L/s	-	
DE25	2,98 L/s	3,95 L/s	4,34 L/s	-	