

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 884	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 72 %

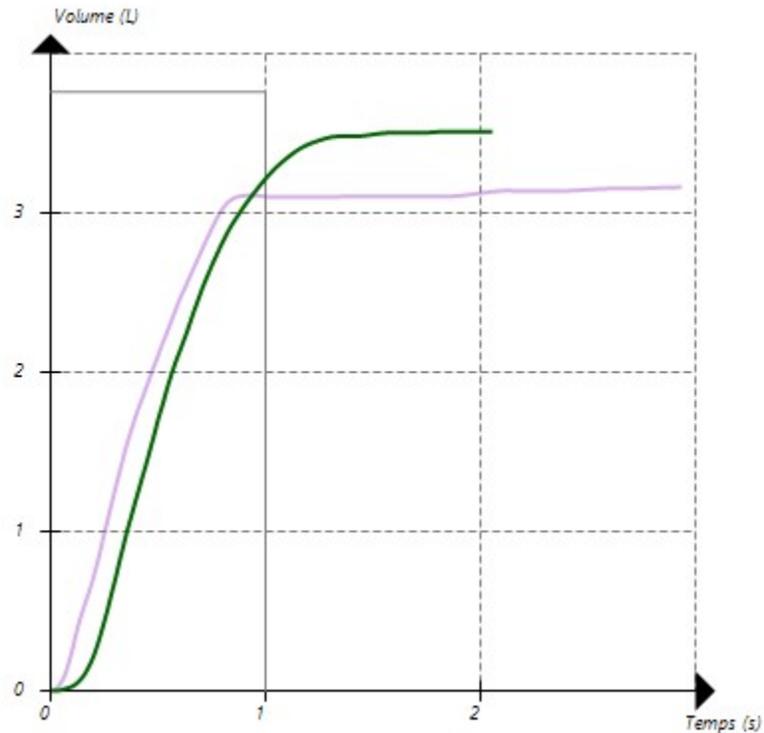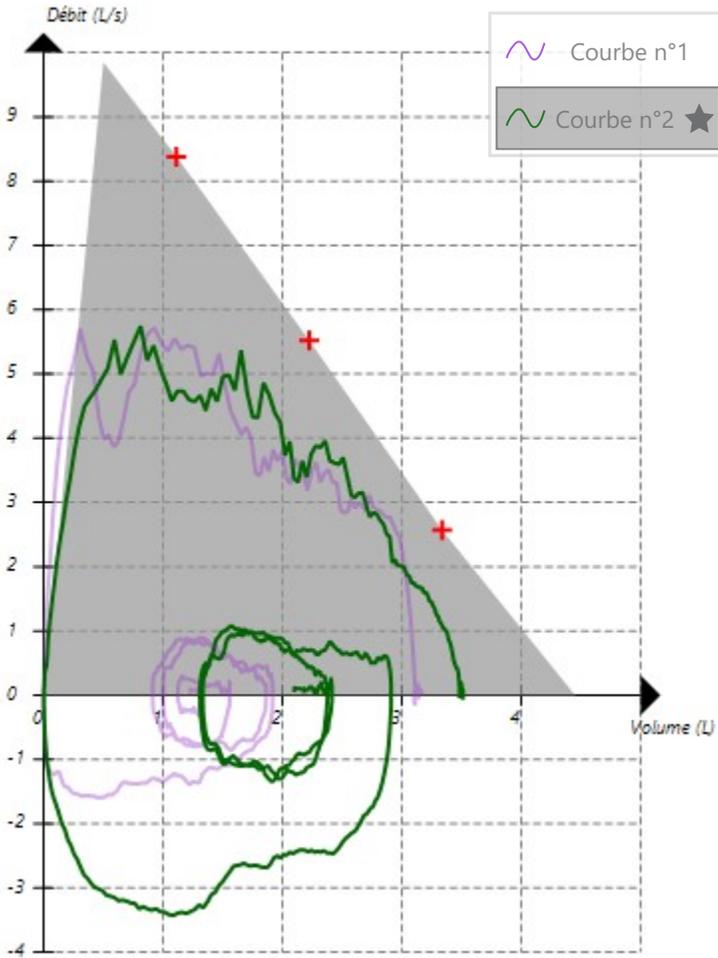

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,11 L	3,51 L	4,45 L	78,88 %
VEMS	3,11 L	3,41 L	3,76 L	90,69 %
DEP	6,07 L/s	6,32 L/s	9,85 L/s	64,16 %
VEMS/ CVF	100,00 %	97,15 %	82,56 %	117,67 %
Durée d'expiration	0,92 s	1,84 s	-	
DEMM	4,42 L/s	4,33 L/s	5,00 L/s	86,60 %
DEMM/ CVF	1,42 s-1	1,23 s-1	0,98 s-1	125,51 %
DE75	5,04 L/s	4,94 L/s	8,38 L/s	58,95 %
DE50	4,42 L/s	4,04 L/s	5,52 L/s	73,19 %
DE25	3,10 L/s	3,16 L/s	2,57 L/s	122,96 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: