

<b>Nom</b> SONOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JEAN FASSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/05/1990	<b>Profession</b> CHIMISTE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CEMED
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 10	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 54 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,5 °C  
 Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Humidité : 54 %

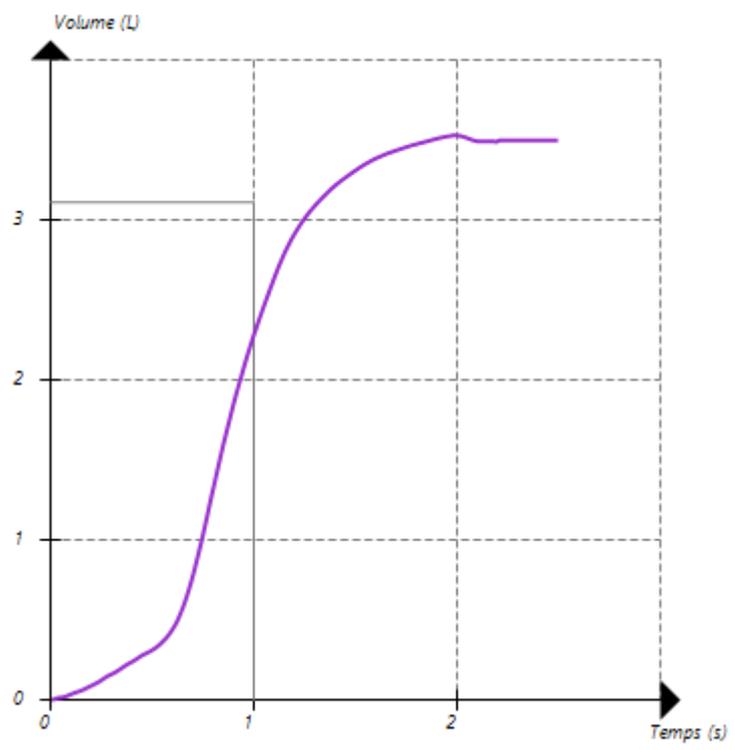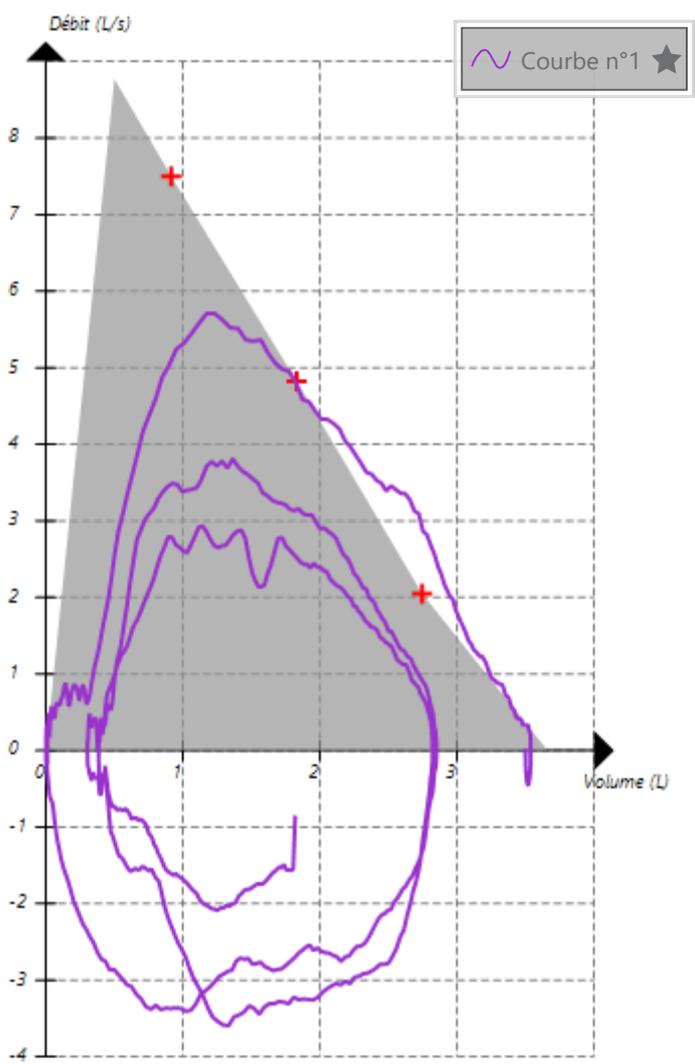

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,53 L	3,66 L	96,45 %
VEMS	3,36 L	3,11 L	108,04 %
DÉP	5,86 L/s	8,77 L/s	66,82 %
VEMS/ CVF	95,18 %	81,12 %	117,33 %
Durée d'expiration	1,99 s	-	
DEMM	4,63 L/s	4,43 L/s	104,51 %
DEMM/ CVF	1,31 s <sup>-1</sup>	1,05 s <sup>-1</sup>	124,76 %
DE75	5,03 L/s	7,50 L/s	67,07 %
DE50	4,94 L/s	4,82 L/s	102,49 %
DE25	3,30 L/s	2,05 L/s	160,98 %