



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIAKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/12/1993	<b>Profession</b> COLLECTEUR
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 111	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 62 %

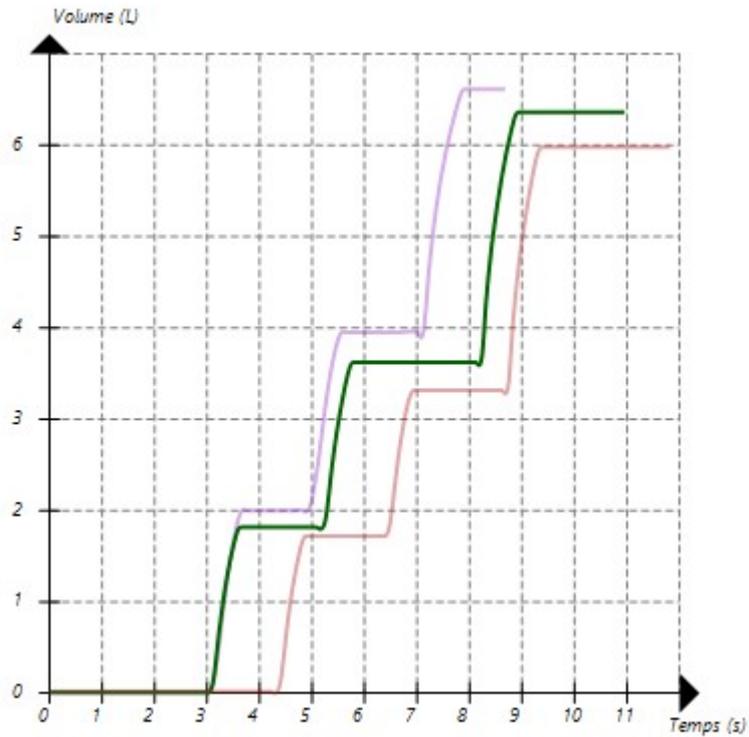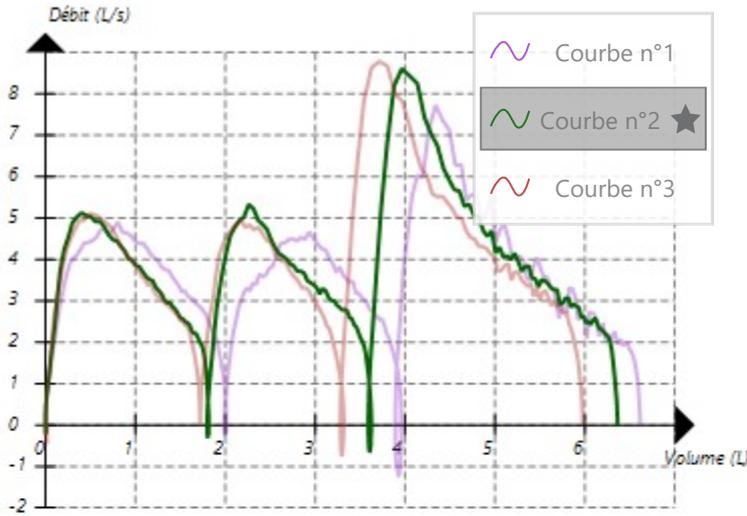

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,73 L	2,77 L	2,70 L	3,98 L	69,60 %
VEMS	2,73 L	2,77 L	2,70 L	3,35 L	82,69 %
DEP	8,13 L/s	8,87 L/s	8,92 L/s	8,67 L/s	102,31 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	0,85 s	0,76 s	0,71 s	-	
DEMM	4,09 L/s	4,55 L/s	4,91 L/s	3,79 L/s	120,05 %
DEMM/CVF	1,50 s-1	1,64 s-1	1,82 s-1	0,95 s-1	172,63 %
DE75	6,62 L/s	6,86 L/s	7,78 L/s	-	
DE50	3,73 L/s	4,61 L/s	4,98 L/s	-	
DE25	2,58 L/s	3,29 L/s	3,19 L/s	-	