



<b>Nom</b> BAYO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N VAFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 23/05/2001	<b>Profession</b> COLLECTEUR
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 123	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

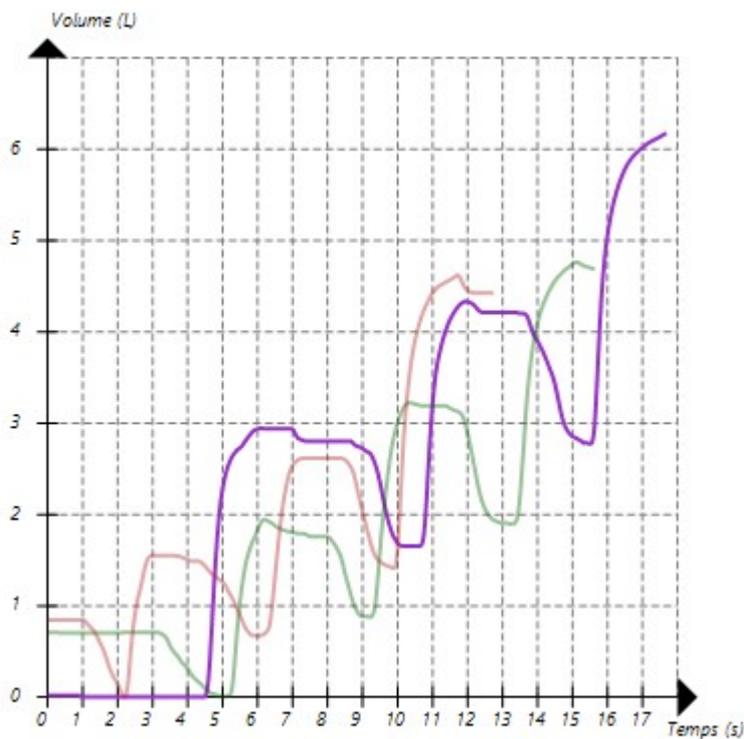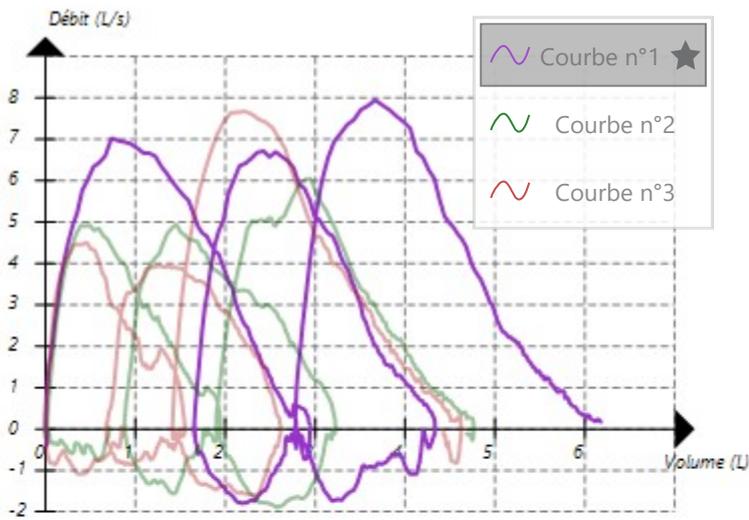

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,40 L	2,87 L	3,21 L	4,16 L	81,73 %
VEMS	3,09 L	2,64 L	3,00 L	3,56 L	86,80 %
DEP	8,08 L/s	6,11 L/s	7,74 L/s	9,05 L/s	89,28 %
VEMS/CVF	90,88 %	91,99 %	93,46 %	84,85 %	107,11 %
Durée d'expiration	2,23 s	1,89 s	1,85 s	-	
DEMM	4,26 L/s	3,68 L/s	4,37 L/s	4,12 L/s	103,40 %
DEMM/CVF	1,25 s-1	1,28 s-1	1,36 s-1	0,99 s-1	126,26 %
DE75	7,83 L/s	5,00 L/s	7,69 L/s	-	
DE50	5,00 L/s	4,33 L/s	4,58 L/s	-	
DE25	1,82 L/s	1,81 L/s	2,26 L/s	-	