



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ASTOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1997	<b>Profession</b> TRIEUR /COLLECTEUR
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 07	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 45 %

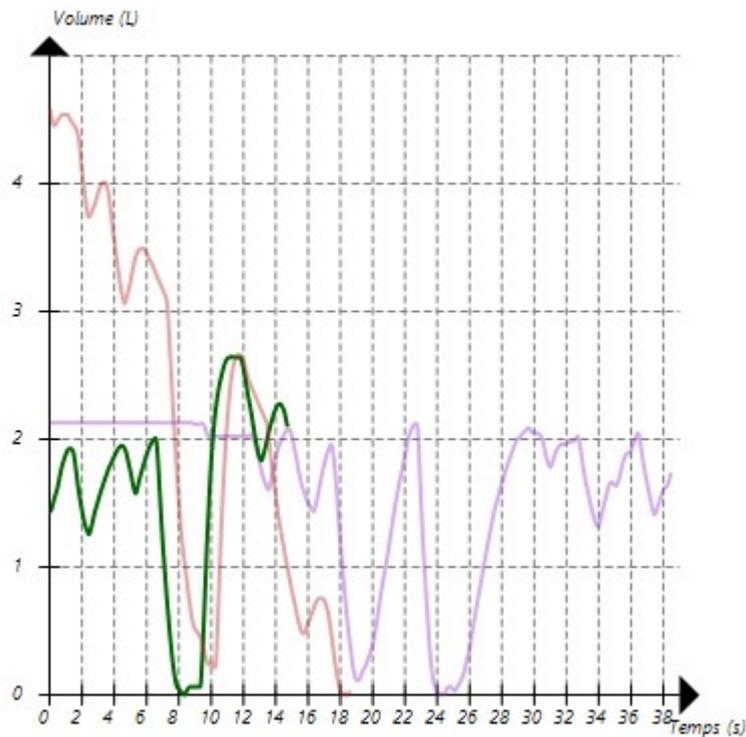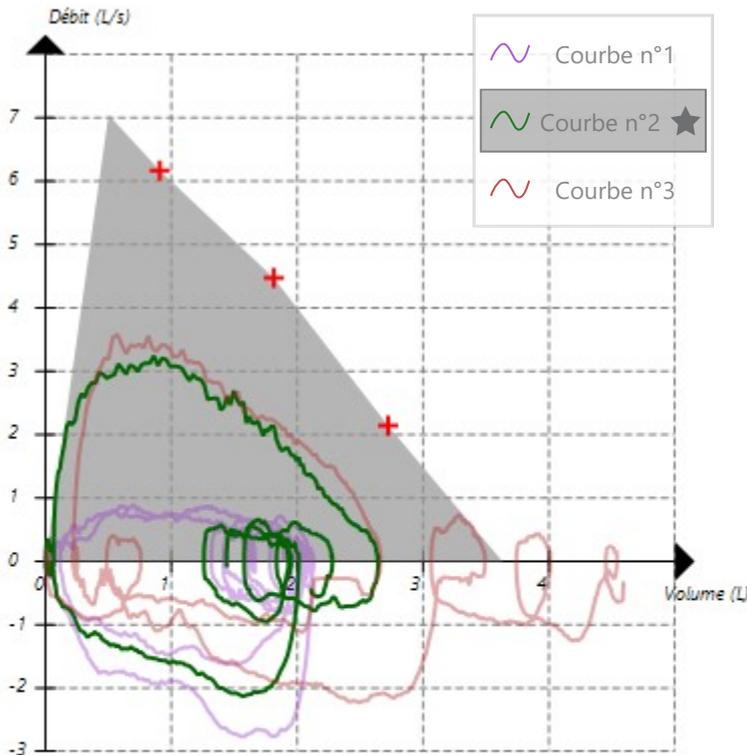

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,01 L	2,58 L	2,45 L	3,63 L	71,07 %
VEMS	0,84 L	2,27 L	2,31 L	3,16 L	71,84 %
DEP	0,90 L/s	3,33 L/s	3,66 L/s	7,05 L/s	47,23 %
VEMS/ CVF	41,79 %	87,98 %	94,29 %	83,92 %	104,84 %
Durée d'expiration	3,64 s	1,89 s	1,44 s	-	
DEMM	0,78 L/s	2,53 L/s	2,65 L/s	4,05 L/s	62,47 %
DEMM/ CVF	0,39 s-1	0,98 s-1	1,08 s-1	1,12 s-1	87,50 %
DE75	0,87 L/s	3,15 L/s	3,59 L/s	6,17 L/s	51,05 %
DE50	0,79 L/s	2,60 L/s	2,44 L/s	4,47 L/s	58,17 %
DE25	0,66 L/s	1,57 L/s	1,88 L/s	2,14 L/s	73,36 %