



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> TRIEUR /COLLECTEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 49 %

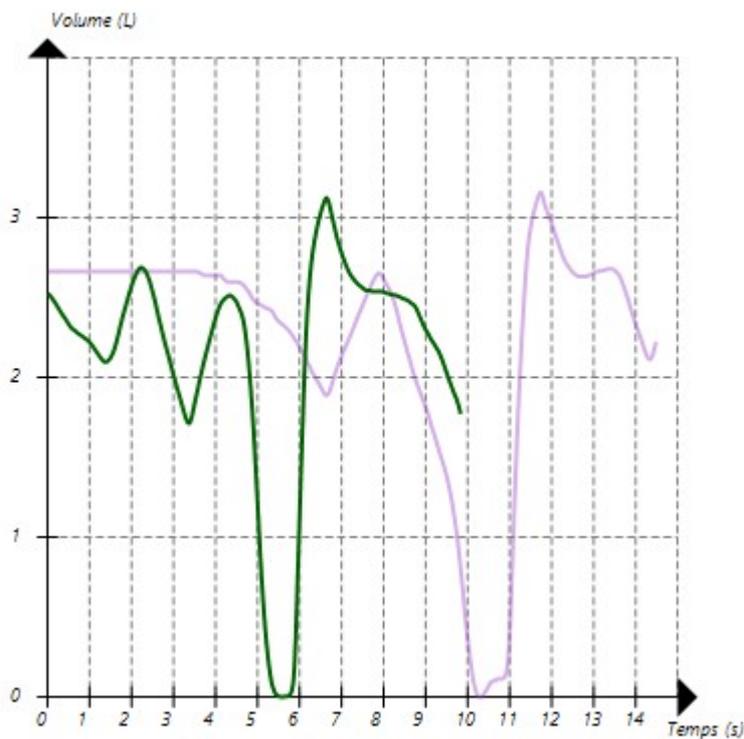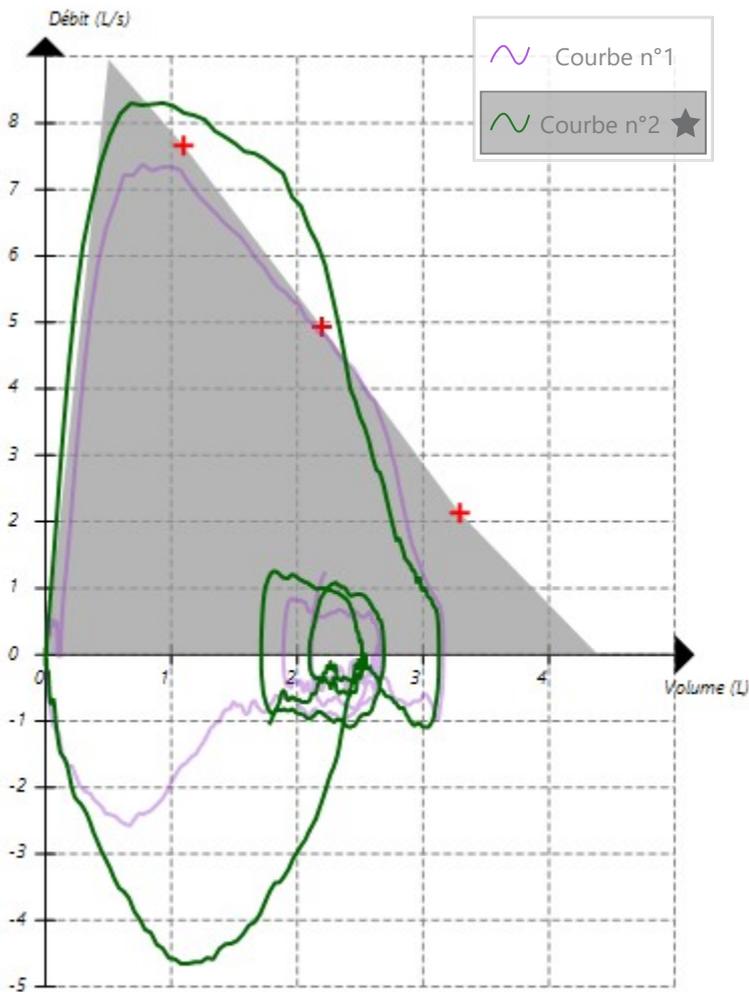

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,05 L	3,13 L	4,39 L	71,30 %
VEMS	3,05 L	3,13 L	3,70 L	84,59 %
DEP	7,42 L/s	8,44 L/s	8,96 L/s	94,20 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	0,94 s	1,09 s	-	
DEMM	5,98 L/s	7,41 L/s	4,48 L/s	165,40 %
DEMM/CVF	1,96 s-1	2,37 s-1	1,02 s-1	232,35 %
DE75	7,35 L/s	8,23 L/s	7,66 L/s	107,44 %
DE50	6,04 L/s	7,54 L/s	4,93 L/s	152,94 %
DE25	4,37 L/s	4,79 L/s	2,13 L/s	224,88 %