



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> CHAUFFEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> GST
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 26	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 49 %

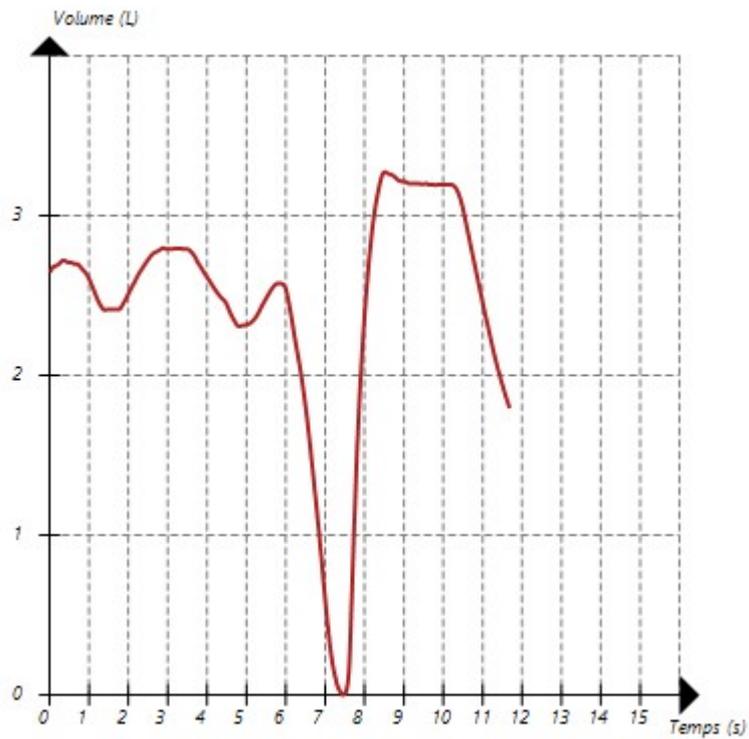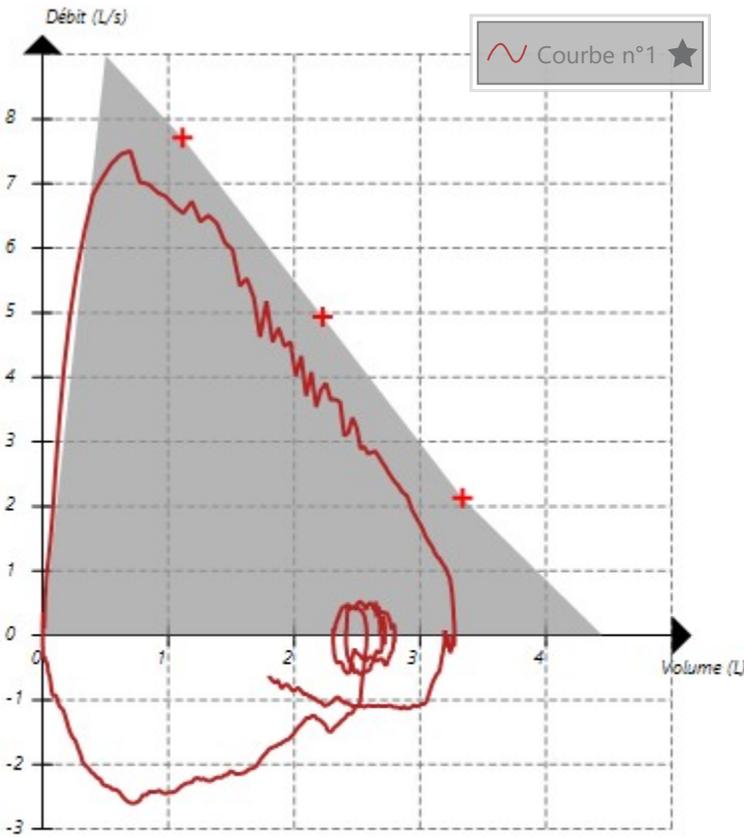

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,27 L	4,45 L	73,48 %
VEMS	3,27 L	3,73 L	87,67 %
DEP	7,56 L/s	8,99 L/s	84,09 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,77 %	123,81 %
Durée d'expiration	1,07 s	-	
DEMM	5,10 L/s	4,44 L/s	114,86 %
DEMM/ CVF	1,56 s-1	1,00 s-1	156,00 %
DE75	7,07 L/s	7,71 L/s	91,70 %
DE50	5,78 L/s	4,94 L/s	117,00 %
DE25	3,40 L/s	2,13 L/s	159,62 %