

**Nom BERETE**  
**Prénom SEKOU**  
**Né le** 01/02/1993  
**Age** 32 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 154  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 96 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** BUS DRIVER  
**Entreprise** GST  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 55 %

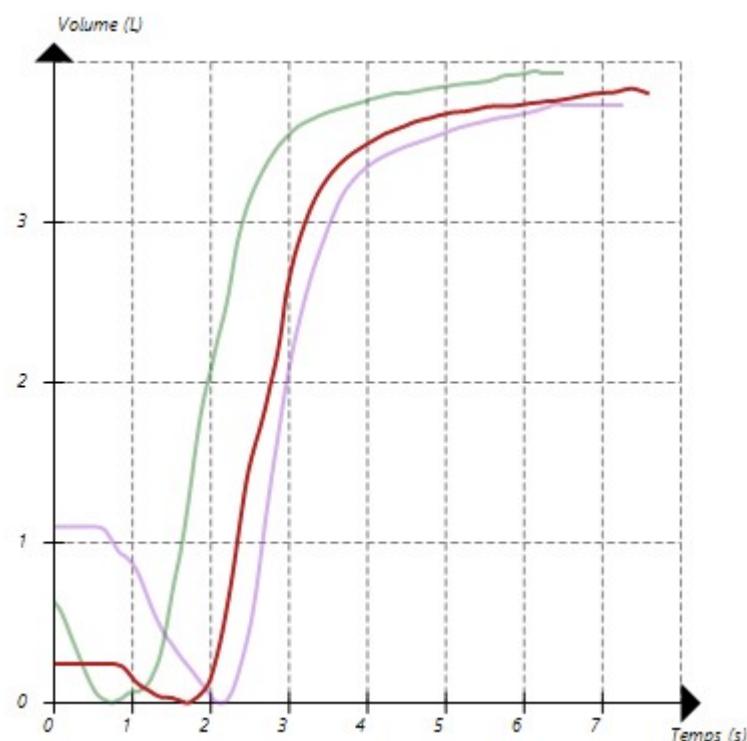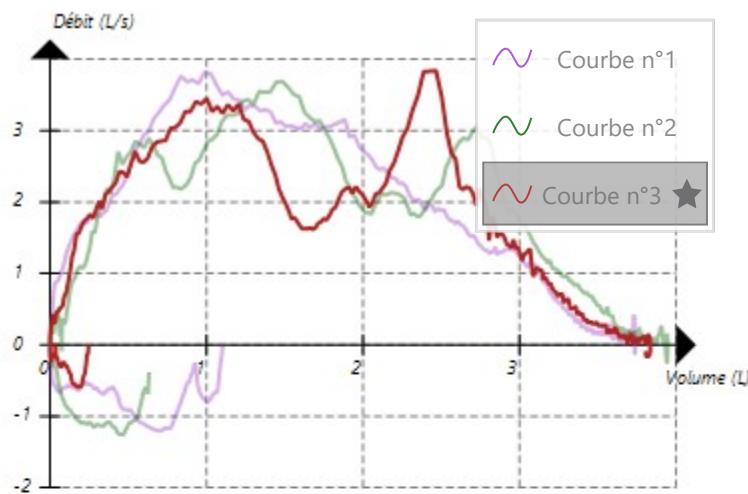

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,74 L	3,87 L	3,83 L	4,19 L	91,41 %
VEMS	2,83 L	2,91 L	3,08 L	3,51 L	87,75 %
DEP	3,94 L/s	3,75 L/s	4,00 L/s	9,01 L/s	44,40 %
VEMS/CVF	75,67 %	75,19 %	80,42 %	83,39 %	96,44 %
Durée d'expiration	4,27 s	5,08 s	5,65 s	-	
DEMM	2,54 L/s	2,61 L/s	2,41 L/s	3,89 L/s	61,95 %
DEMM/CVF	0,68 s <sup>-1</sup>	0,67 s <sup>-1</sup>	0,63 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	67,74 %
DE75	3,70 L/s	2,90 L/s	3,35 L/s	-	
DE50	3,17 L/s	1,85 L/s	2,23 L/s	-	
DE25	1,27 L/s	1,83 L/s	1,62 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: