



<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/07/1971	<b>Profession</b> OPERATEUR VL
<b>Age</b> 52 Ans	<b>Entreprise</b> GST
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 12	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %

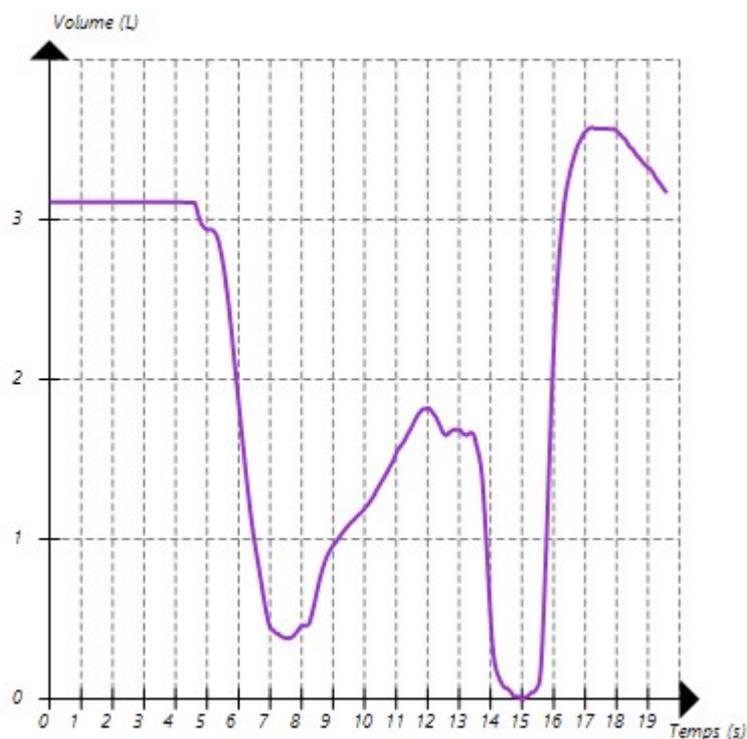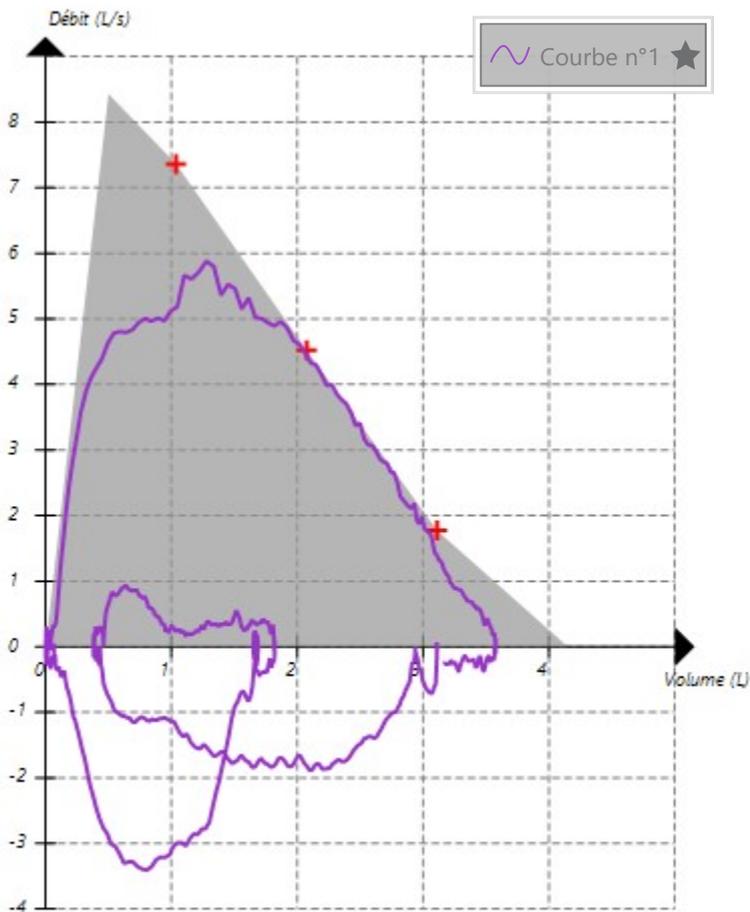

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,54 L	4,15 L	85,30 %
VEMS	3,32 L	3,35 L	99,10 %
DEP	6,02 L/s	8,43 L/s	71,41 %
VEMS/ CVF	93,79 %	77,90 %	120,40 %
Durée d'expiration	1,89 s	-	
DEMM	4,57 L/s	3,79 L/s	120,58 %
DEMM/ CVF	1,29 s-1	0,91 s-1	141,76 %
DE75	5,09 L/s	7,36 L/s	69,16 %
DE50	4,82 L/s	4,52 L/s	106,64 %
DE25	2,83 L/s	1,77 L/s	159,89 %