

**Nom SANOH**  
**Prénom MOUSSA**  
**Né le** 25/05/1988  
**Age** 37 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 174  
**Taille** 179 cm  
**Poids** 77 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR BUS  
**Entreprise** GST  
**Service**  
**Fumeur** Ancien fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 87,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 57 %

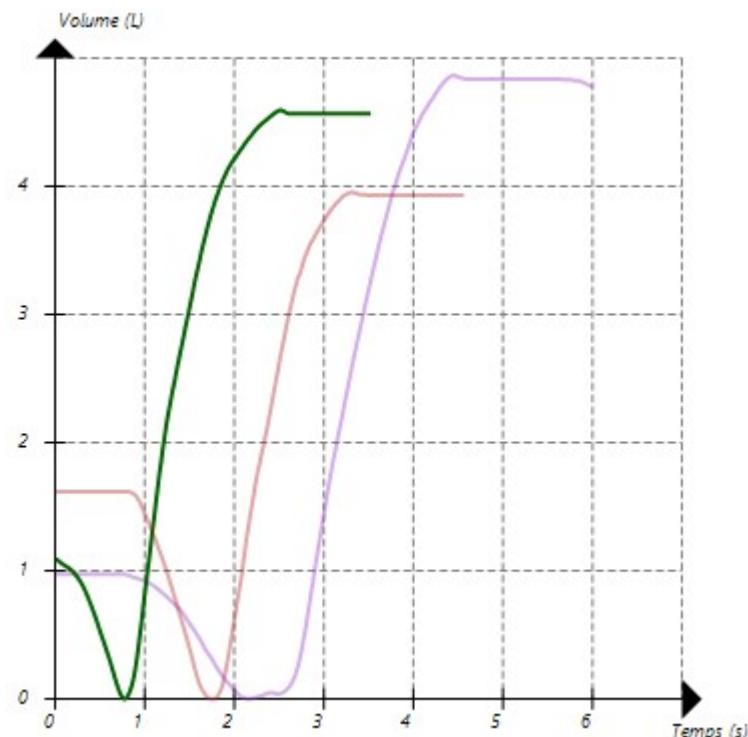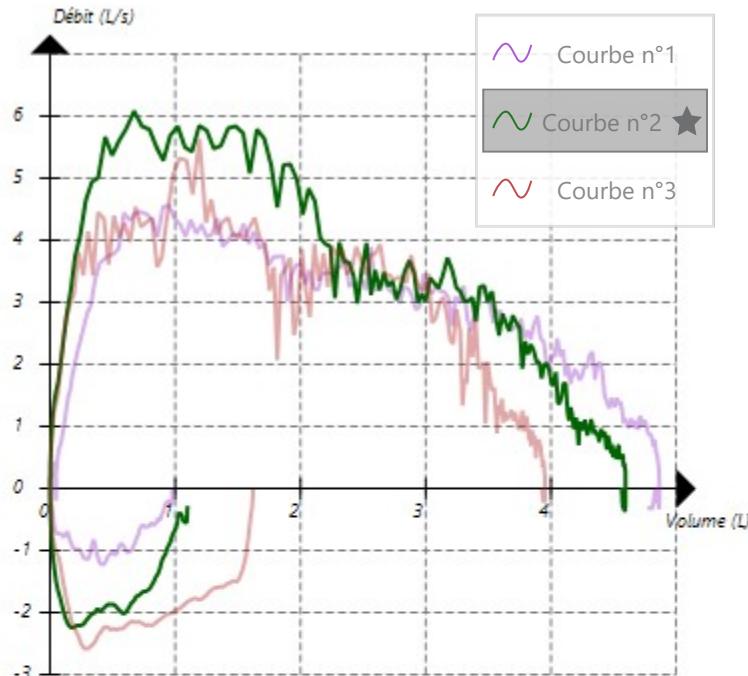

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,83 L	4,60 L	3,95 L	4,51 L	102,00 %
VEMS	3,68 L	4,03 L	3,62 L	3,71 L	108,63 %
DEP	4,83 L/s	6,25 L/s	5,75 L/s	9,47 L/s	66,00 %
VEMS/CVF	76,19 %	87,61 %	91,65 %	82,48 %	106,22 %
Durée d'expiration	1,97 s	1,74 s	1,55 s	-	
DEMM	3,43 L/s	4,09 L/s	3,86 L/s	3,93 L/s	104,07 %
DEMM/CVF	0,71 s-1	0,89 s-1	0,98 s-1	0,87 s-1	102,30 %
DE75	4,22 L/s	5,67 L/s	5,23 L/s	-	
DE50	3,35 L/s	3,69 L/s	2,84 L/s	-	
DE25	2,78 L/s	3,62 L/s	3,22 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: