



<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1987	<b>Profession</b> CHAUFFEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> GST
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 25	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 49 %

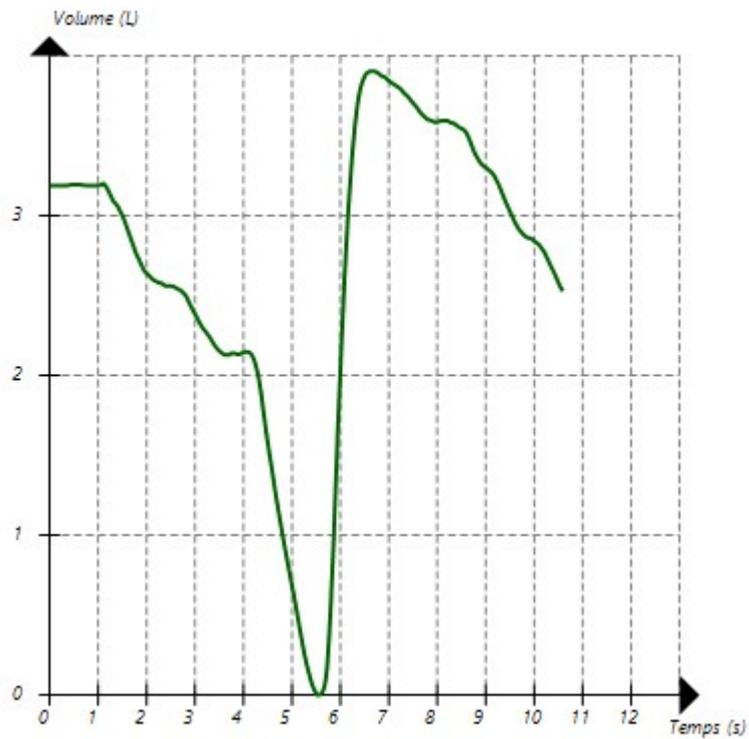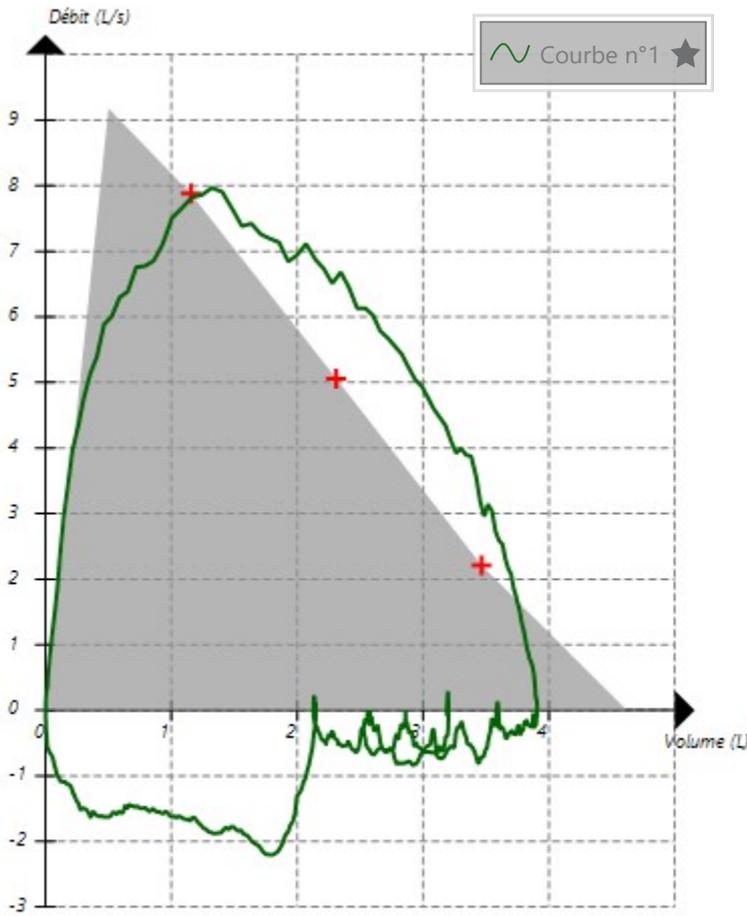

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,91 L	4,62 L	84,63 %
VEMS	3,91 L	3,86 L	101,30 %
DEP	8,06 L/s	9,18 L/s	87,80 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,77 %	123,81 %
Durée d'expiration	1,09 s	-	
DEMM	6,93 L/s	4,49 L/s	154,34 %
DEMM/ CVF	1,77 s-1	0,97 s-1	182,47 %
DE75	7,18 L/s	7,88 L/s	91,12 %
DE50	6,57 L/s	5,06 L/s	129,84 %
DE25	4,91 L/s	2,21 L/s	222,17 %