

**Nom** CAMARA  
**Prénom** MORY  
**Né le** 01/07/1982  
**Age** 43 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 170  
**Taille** 170 cm  
**Poids** 59 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR BUS  
**Entreprise** GST  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 87,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 57 %

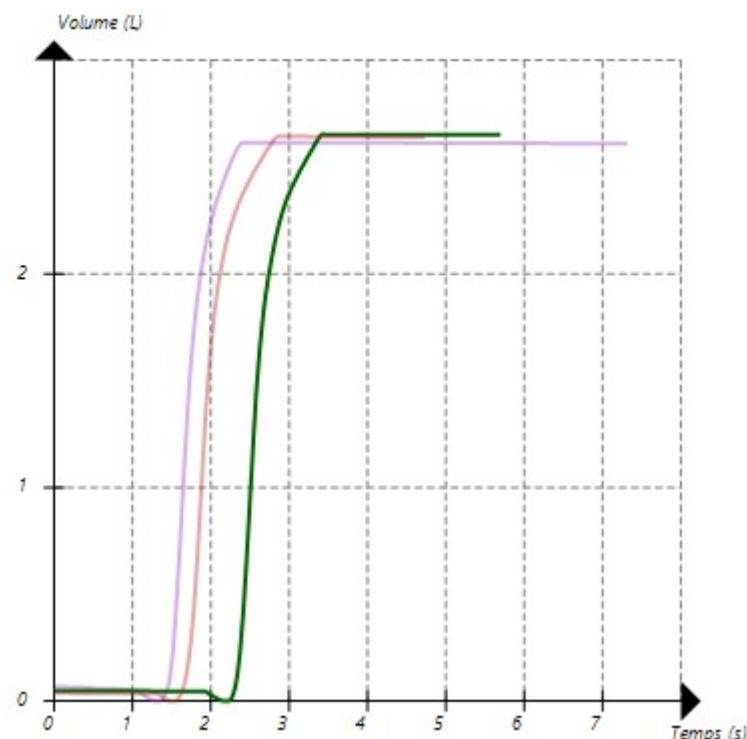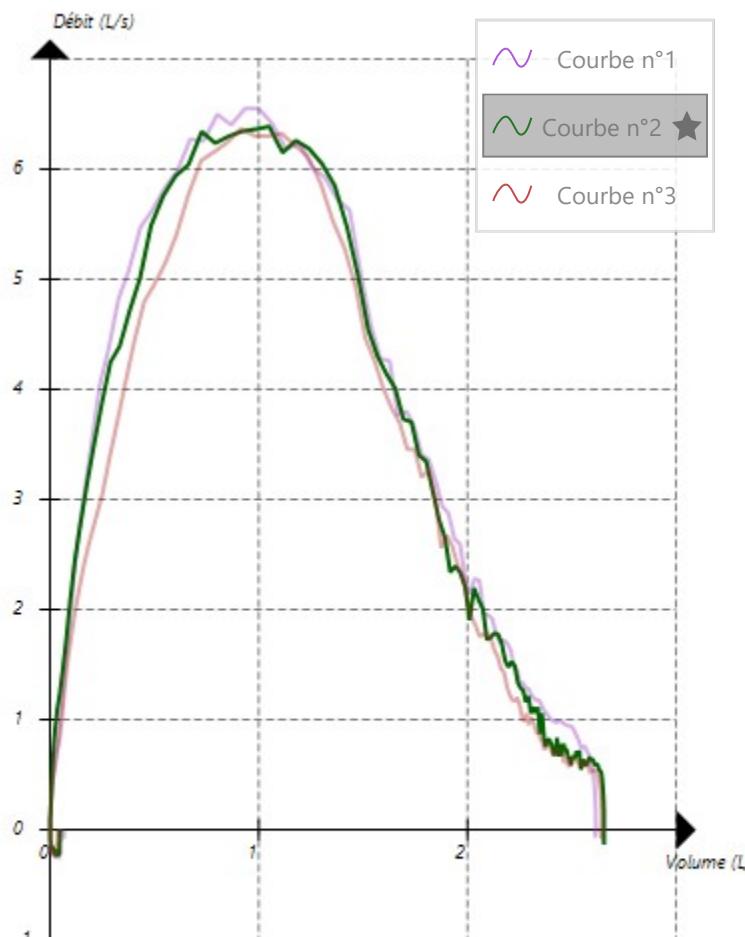

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,62 L	2,65 L	2,64 L	3,88 L	68,30 %
VEMS	2,62 L	2,62 L	2,58 L	3,16 L	82,91 %
DEP	6,67 L/s	6,56 L/s	6,43 L/s	8,37 L/s	78,38 %
VEMS/CVF	100,00 %	98,87 %	97,73 %	81,38 %	121,49 %
Durée d'expiration	1,09 s	1,27 s	1,37 s	-	
DEMM	4,99 L/s	4,72 L/s	4,67 L/s	3,35 L/s	140,90 %
DEMM/CVF	1,90 s <sup>-1</sup>	1,78 s <sup>-1</sup>	1,77 s <sup>-1</sup>	0,86 s <sup>-1</sup>	206,98 %
DE75	6,35 L/s	5,99 L/s	5,87 L/s	-	
DE50	5,98 L/s	5,96 L/s	5,63 L/s	-	
DE25	2,83 L/s	2,17 L/s	2,23 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: