

**Nom CONDE**  
**Prénom LAYE SIAKA**  
**Né le** 01/01/1994  
**Age** 31 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 161  
**Taille** 176 cm  
**Poids** 62 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CHAUFFEUR VL  
**Entreprise** GST  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,2 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 54 %

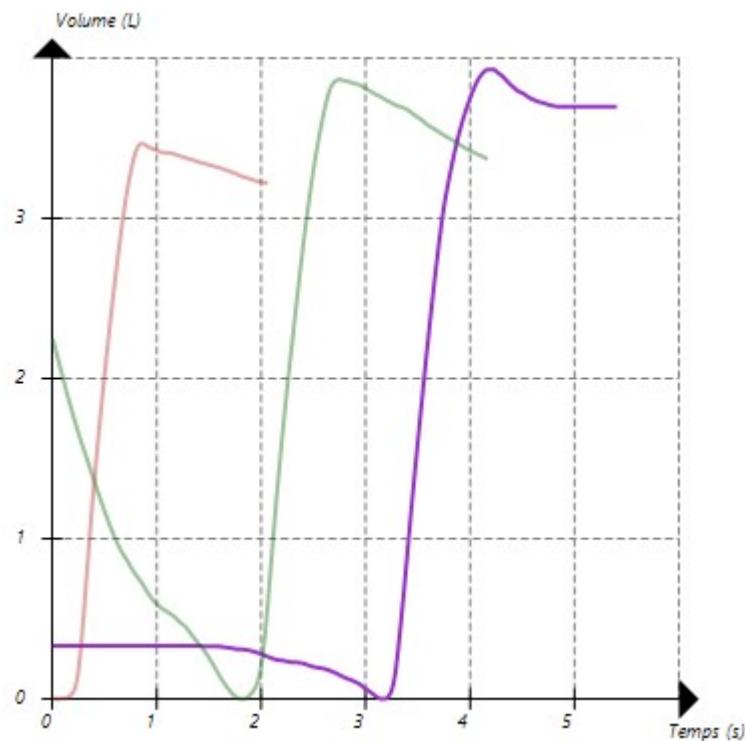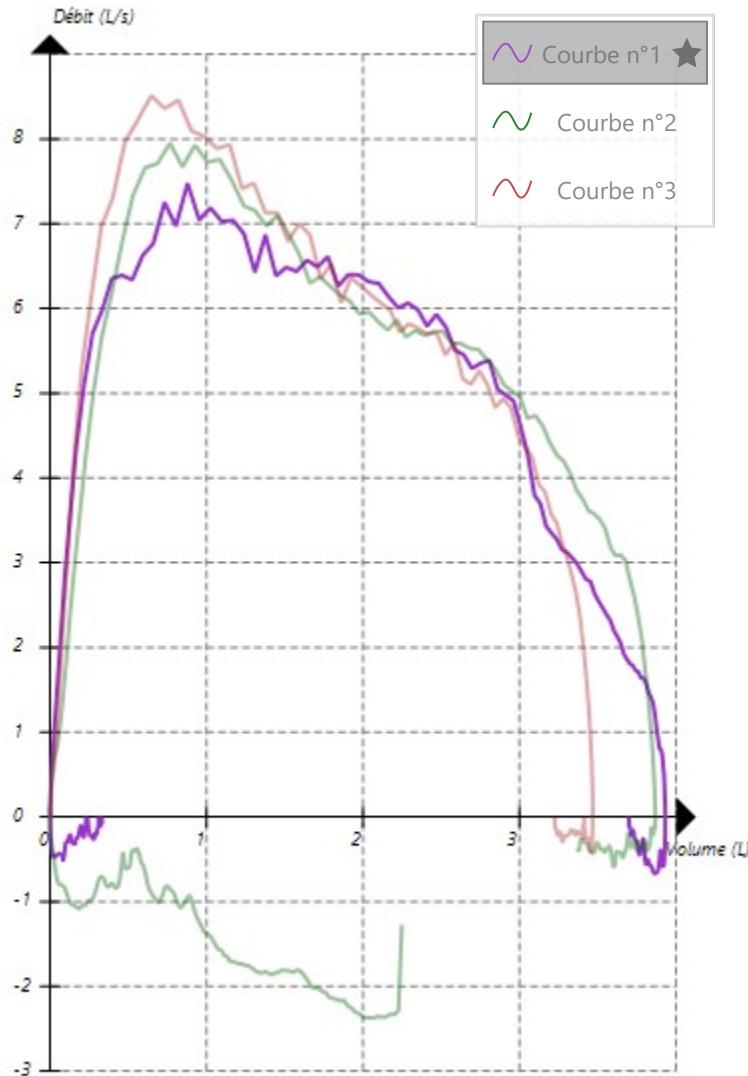

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,93 L	3,87 L	3,47 L	4,44 L	88,51 %
VEMS	3,93 L	3,87 L	3,47 L	3,71 L	105,93 %
DEP	7,76 L/s	8,07 L/s	8,60 L/s	9,43 L/s	82,29 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	1,03 s	0,94 s	0,83 s	-	
DEMM	6,26 L/s	6,34 L/s	6,75 L/s	4,07 L/s	153,81 %
DEMM/CVF	1,59 s <sup>-1</sup>	1,64 s <sup>-1</sup>	1,95 s <sup>-1</sup>	0,92 s <sup>-1</sup>	172,83 %
DE75	6,64 L/s	7,88 L/s	8,15 L/s	-	
DE50	6,35 L/s	6,05 L/s	6,26 L/s	-	
DE25	5,02 L/s	5,00 L/s	5,44 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: