



<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1981	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> GST
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 134	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 97 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %

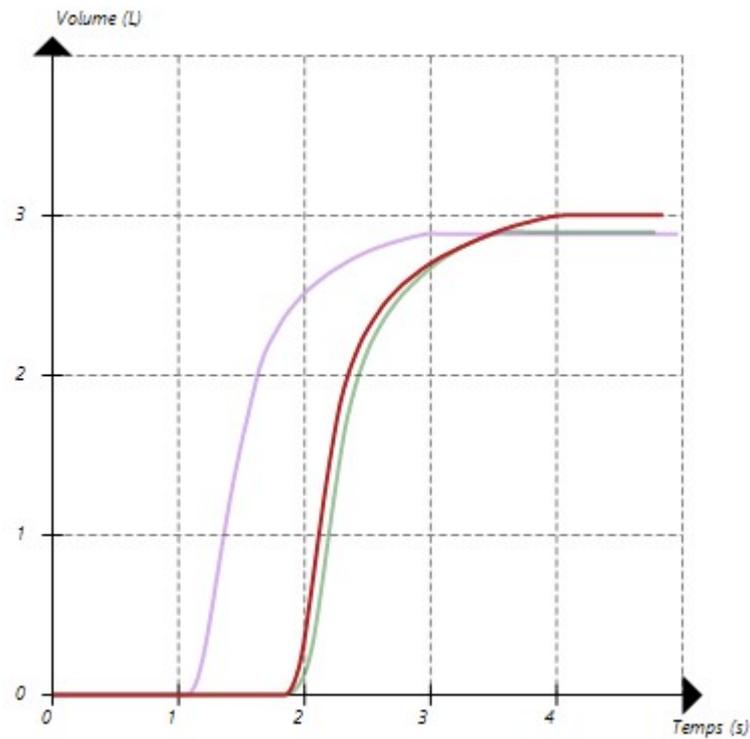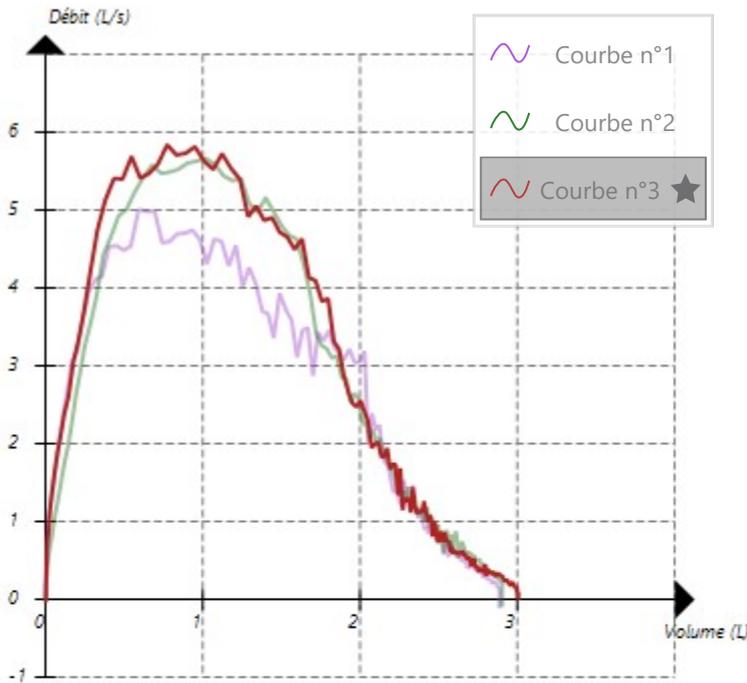

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,89 L	2,90 L	3,00 L	4,20 L	71,43 %
VEMS	2,61 L	2,68 L	2,67 L	3,41 L	78,30 %
DEP	5,35 L/s	5,87 L/s	6,16 L/s	8,90 L/s	69,21 %
VEMS/CVF	90,31 %	92,41 %	89,00 %	81,20 %	109,61 %
Durée d'expiration	2,99 s	1,89 s	2,31 s	-	
DEMM	3,64 L/s	3,93 L/s	3,73 L/s	3,52 L/s	105,97 %
DEMM/CVF	1,26 s-1	1,36 s-1	1,24 s-1	0,84 s-1	147,62 %
DE75	4,70 L/s	5,47 L/s	5,88 L/s	-	
DE50	3,47 L/s	5,01 L/s	4,76 L/s	-	
DE25	1,82 L/s	1,74 L/s	1,86 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: