



<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VAFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/06/1985	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GST
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 133	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 91 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 65 %

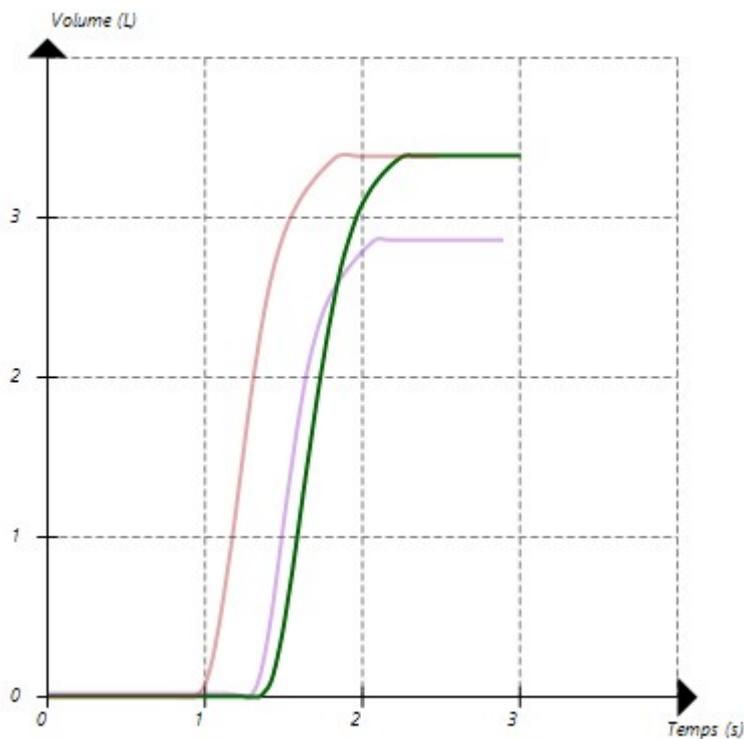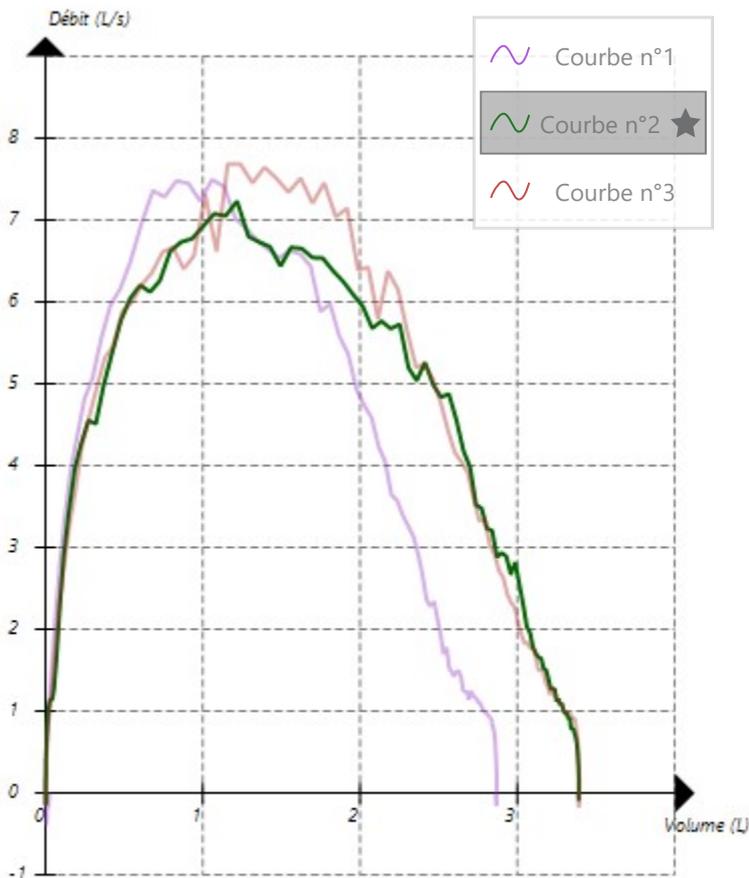

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,87 L	3,39 L	3,39 L	4,33 L	78,29 %
VEMS	2,87 L	3,39 L	3,39 L	3,55 L	95,49 %
DEP	7,66 L/s	7,36 L/s	8,16 L/s	9,16 L/s	80,35 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,93 %	122,06 %
Durée d'expiration	0,84 s	0,95 s	1,01 s	-	
DEMM	6,43 L/s	6,33 L/s	6,76 L/s	3,73 L/s	169,71 %
DEMM/CVF	2,24 s-1	1,87 s-1	1,99 s-1	0,86 s-1	217,44 %
DE75	7,28 L/s	6,69 L/s	6,42 L/s	-	
DE50	6,69 L/s	6,60 L/s	7,07 L/s	-	
DE25	4,04 L/s	4,86 L/s	4,45 L/s	-	