



<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BAKARI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> OPERATEUR VL
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> GST
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 06	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecacs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 24,3 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 47 %

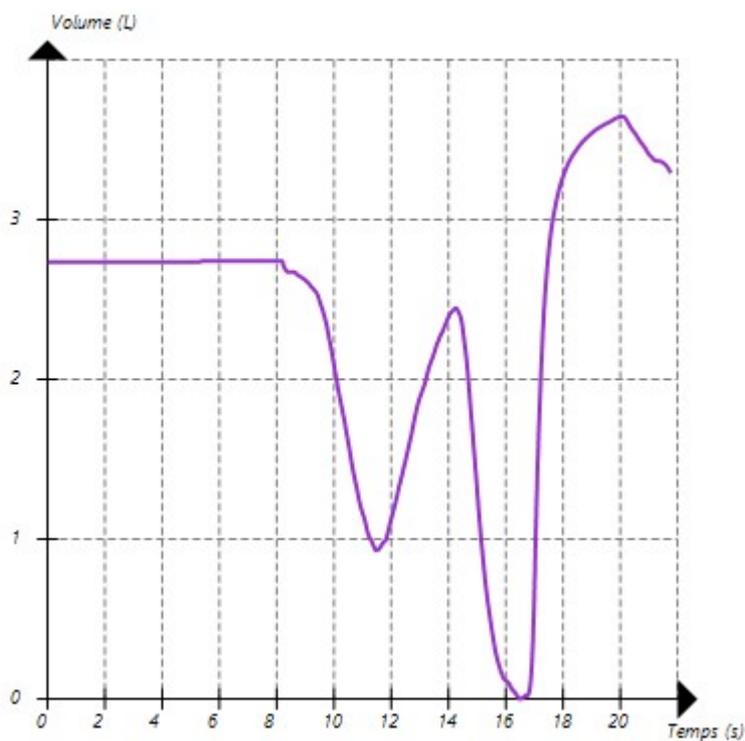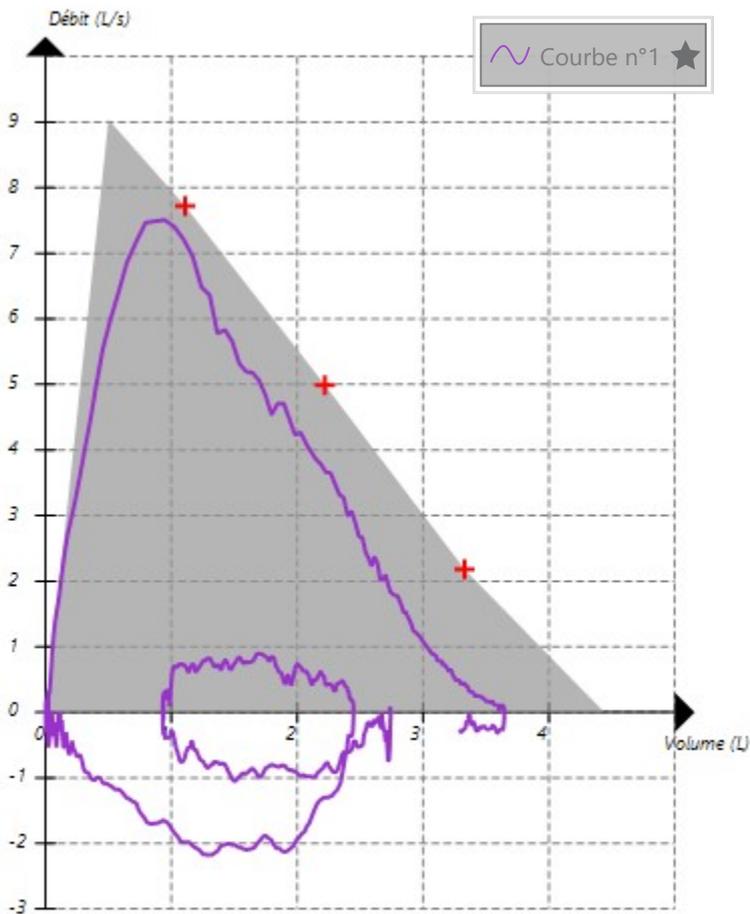

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,63 L	4,44 L	81,76 %
VEMS	3,20 L	3,76 L	85,11 %
DEP	7,89 L/s	9,04 L/s	87,28 %
VEMS/ CVF	88,15 %	81,48 %	108,19 %
Durée d'expiration	3,31 s	-	
DEMM	4,20 L/s	4,57 L/s	91,90 %
DEMM/ CVF	1,16 s-1	1,03 s-1	112,62 %
DE75	7,66 L/s	7,72 L/s	99,22 %
DE50	4,86 L/s	4,99 L/s	97,39 %
DE25	1,79 L/s	2,18 L/s	82,11 %