

| | |
|------------------------------------|--|
| Nom KOUROUMA | Adresse |
| Prénom IBRAHIMA | Exposition |
| Né le 01/01/1999 | Profession PLOMBIER |
| Age 25 Ans | Entreprise IBS |
| Genre Masculin | Service |
| ID 267 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 185 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 75 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur LY MAMOUDOU | |





Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
 Numéro de série : 232803
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 30,9 °C
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Humidité : 61 %

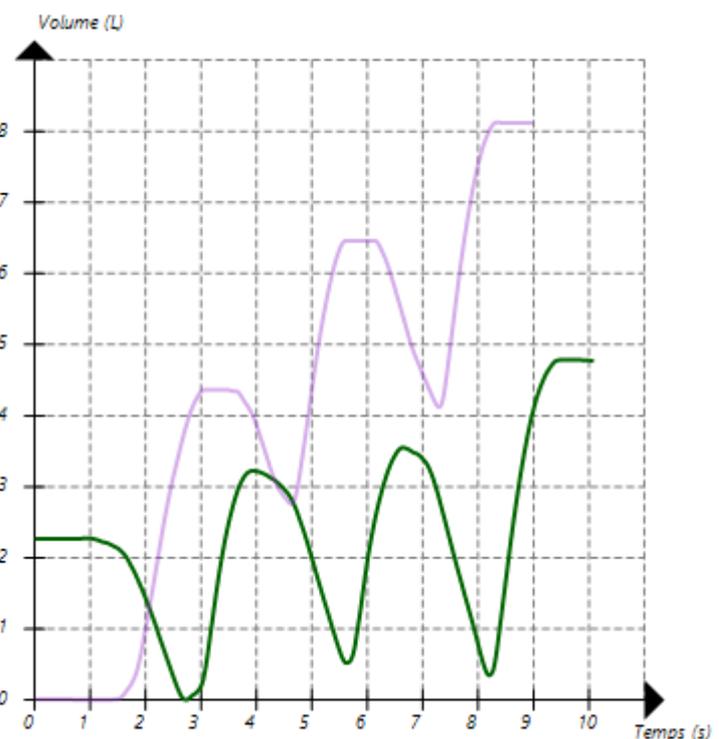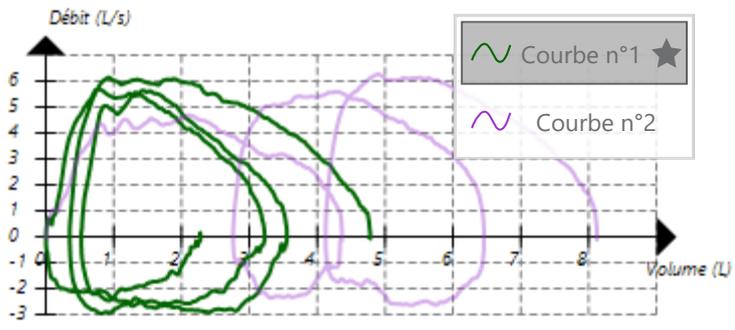

| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Courbe n°2 | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| CVF | 4,43 L | 4,00 L | 5,09 L | 87,03 % |
| VEMS | 4,31 L | 4,00 L | 4,28 L | 100,70 % |
| DÉP | 6,21 L/s | 6,39 L/s | 10,56 L/s | 58,81 % |
| VEMS/CVF | 97,29 % | 100,00 % | 84,67 % | 114,90 % |
| Durée d'expiration | 1,27 s | 1,06 s | - | |
| DEMM | 5,30 L/s | 5,45 L/s | 4,67 L/s | 113,49 % |
| DEMM/CVF | 1,20 s-1 | 1,36 s-1 | 0,92 s-1 | 130,43 % |
| DE75 | 6,00 L/s | 6,06 L/s | - | |
| DE50 | 5,41 L/s | 5,70 L/s | - | |
| DE25 | 3,92 L/s | 4,10 L/s | - | |