



<b>Nom</b> KONE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SARAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/11/1992	<b>Profession</b> AGENT HSE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 304	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 53 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 53 %

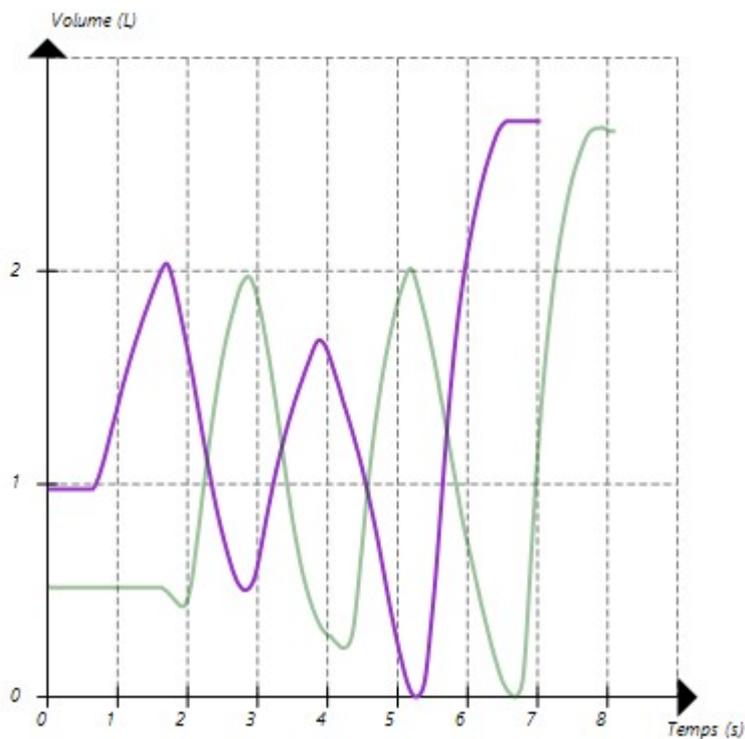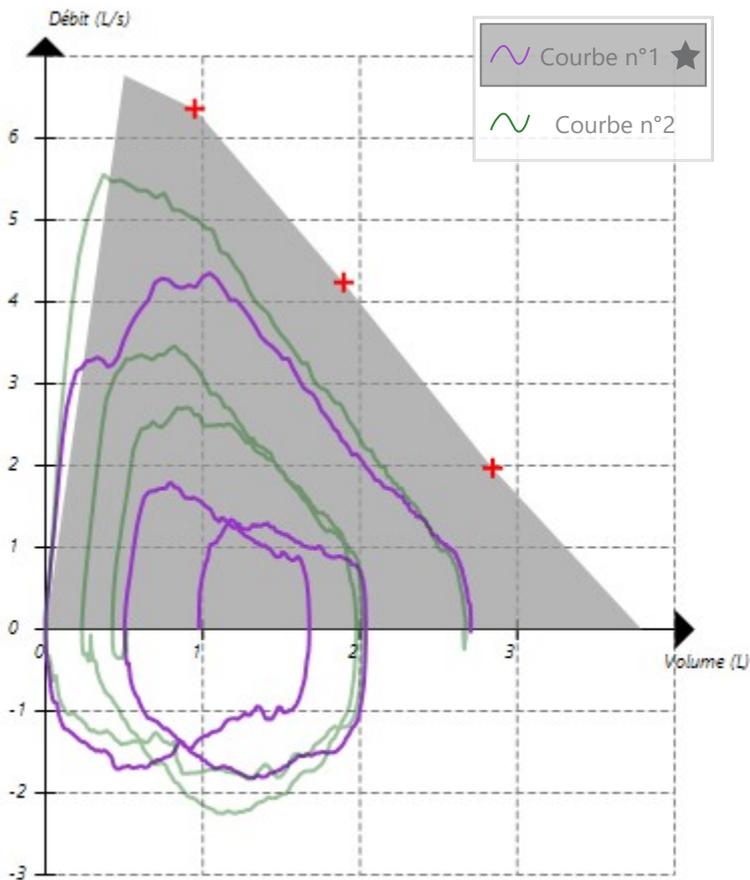

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,70 L	2,67 L	3,79 L	71,24 %
VEMS	2,64 L	2,66 L	3,20 L	82,50 %
DEP	4,40 L/s	5,59 L/s	6,77 L/s	64,99 %
VEMS/ CVF	97,78 %	99,63 %	84,52 %	115,69 %
Durée d'expiration	1,31 s	1,23 s	-	
DEMM	3,37 L/s	3,85 L/s	3,70 L/s	91,08 %
DEMM/ CVF	1,25 s-1	1,44 s-1	0,98 s-1	127,55 %
DE75	4,14 L/s	5,27 L/s	6,36 L/s	65,09 %
DE50	3,64 L/s	3,98 L/s	4,24 L/s	85,85 %
DE25	2,04 L/s	2,36 L/s	1,97 L/s	103,55 %