

**Nom** TRAORE  
**Prénom** BAKARY  
**Né le** 10/10/1992  
**Age** 31 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 132  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 59 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** PLOMBIER  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,2 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 50 %

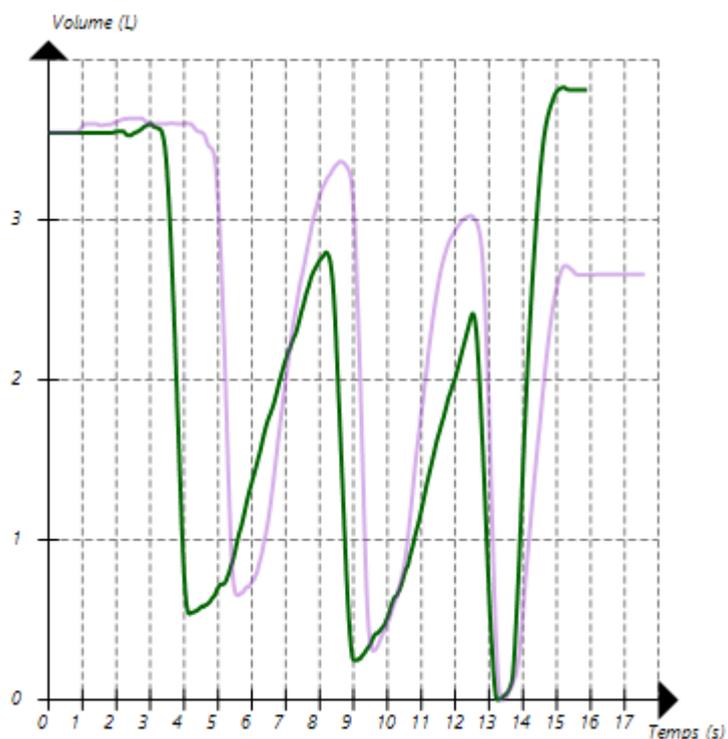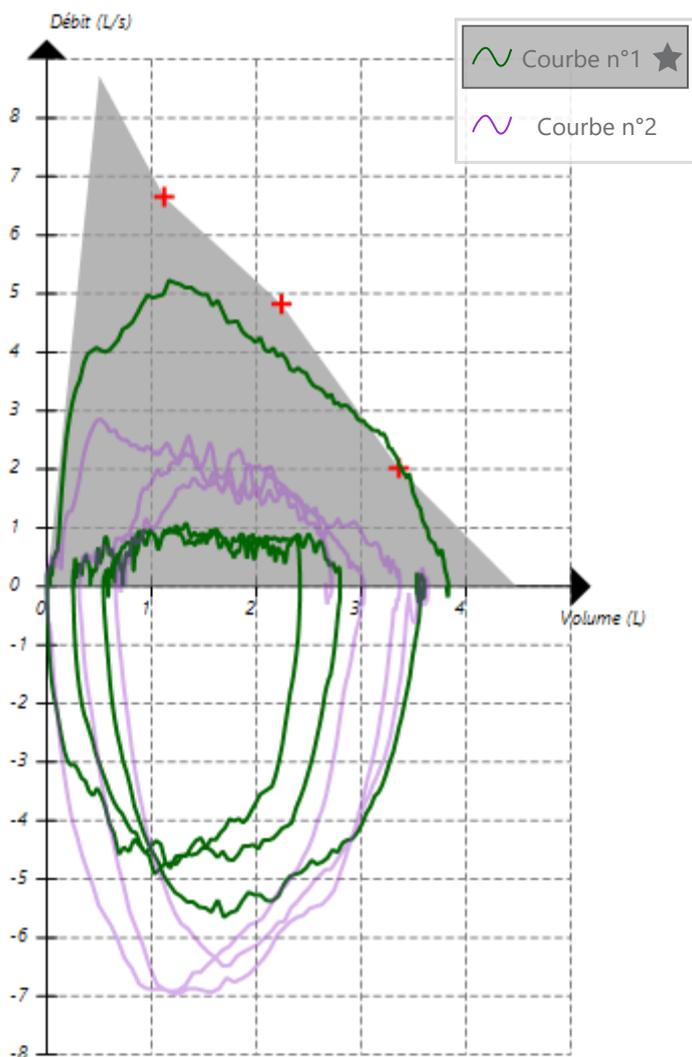

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,83 L	2,71 L	4,48 L	85,49 %
VEMS	3,63 L	2,33 L	3,76 L	96,54 %
DÉP	5,27 L/s	2,88 L/s	8,72 L/s	60,44 %
VEMS/ CVF	94,78 %	85,98 %	83,44 %	113,59 %
Durée d'expiration	1,91 s	1,86 s	-	
DEMM	4,25 L/s	2,28 L/s	4,08 L/s	104,17 %
DEMM/ CVF	1,11 s-1	0,84 s-1	0,91 s-1	121,98 %
DE75	4,98 L/s	2,55 L/s	6,65 L/s	74,89 %
DE50	4,34 L/s	2,62 L/s	4,82 L/s	90,04 %
DE25	3,08 L/s	2,08 L/s	2,02 L/s	152,48 %