



<b>Nom</b> BANGOURA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA SORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/05/1994	<b>Profession</b> MENUISIER MONTEUR
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0318	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 152 cm	<b>Groupe ethnique</b> Mexicain
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 68 %

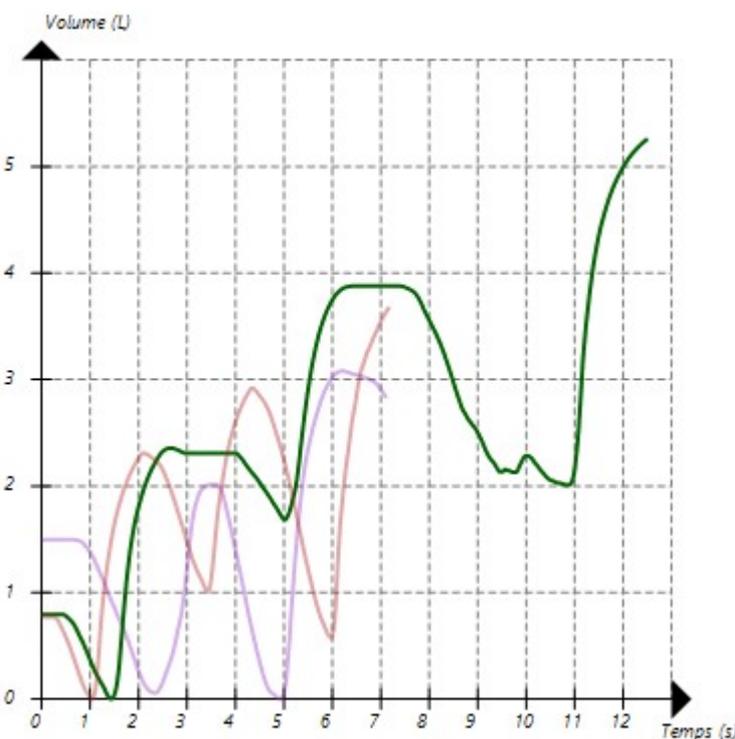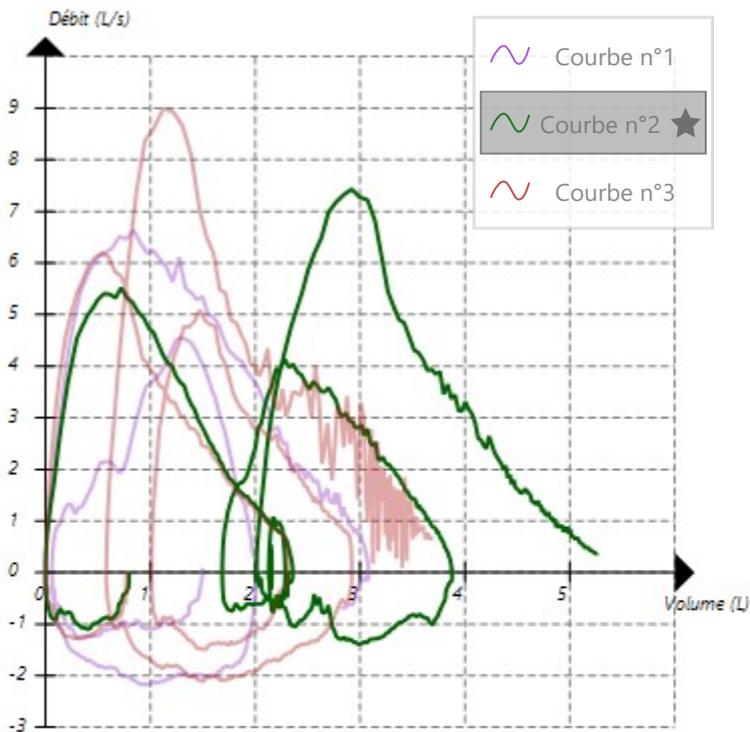

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,08 L	3,25 L	3,11 L	3,92 L	82,91 %
VEMS	3,04 L	2,99 L	2,99 L	3,24 L	92,28 %
DEP	6,74 L/s	7,63 L/s	9,12 L/s	7,97 L/s	95,73 %
VEMS/CVF	98,70 %	92,00 %	96,14 %	83,47 %	110,22 %
Durée d'expiration	1,28 s	1,68 s	1,21 s	-	
DEMM	4,58 L/s	3,82 L/s	3,91 L/s	3,59 L/s	106,41 %
DEMM/CVF	1,49 s-1	1,18 s-1	1,26 s-1	0,92 s-1	128,26 %
DE75	6,40 L/s	7,11 L/s	8,10 L/s	-	
DE50	4,94 L/s	3,85 L/s	3,72 L/s	-	
DE25	2,16 L/s	1,70 L/s	3,93 L/s	-	