



<b>Nom</b> SANOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1997	<b>Profession</b> MENUISIER MONTEUR
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 323	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 66 %

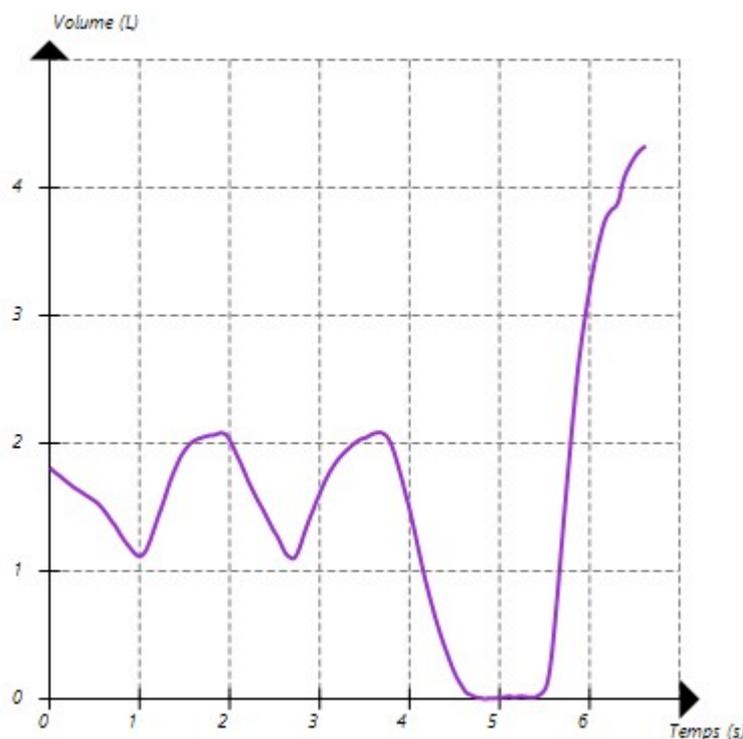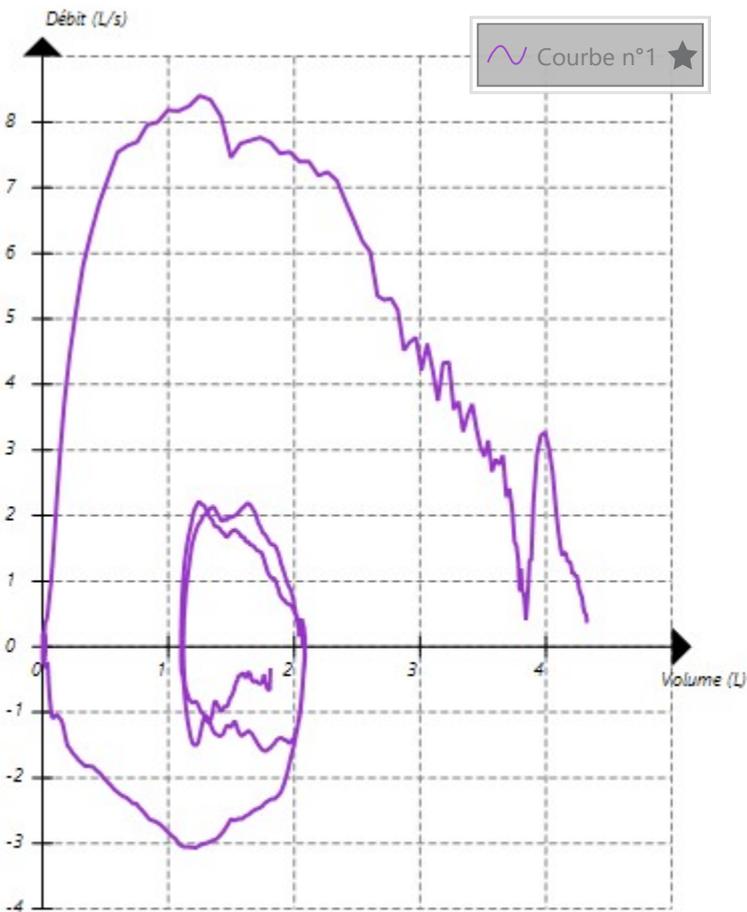

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,32 L	4,22 L	102,37 %
VEMS	4,27 L	3,58 L	119,27 %
DEP	8,48 L/s	9,12 L/s	92,98 %
VEMS/CVF	98,84 %	84,30 %	117,25 %
Durée d'expiration	1,26 s	-	
DEMM	6,48 L/s	4,06 L/s	159,61 %
DEMM/CVF	1,50 s-1	0,96 s-1	156,25 %
DE75	8,18 L/s	-	
DE50	7,20 L/s	-	
DE25	3,86 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: