

<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DOUTY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/07/2002	<b>Profession</b> MENUISIER MONTEUR
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 325	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 64 %

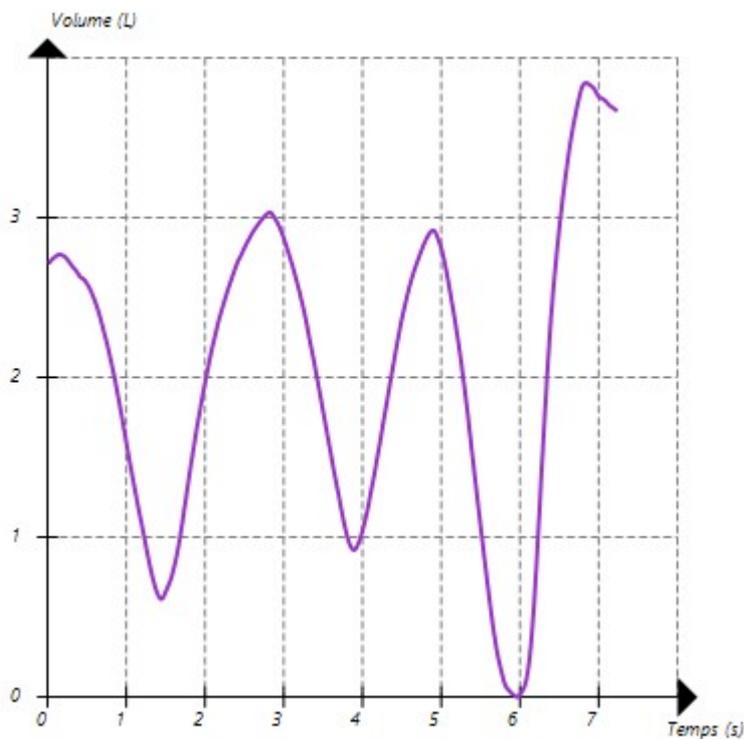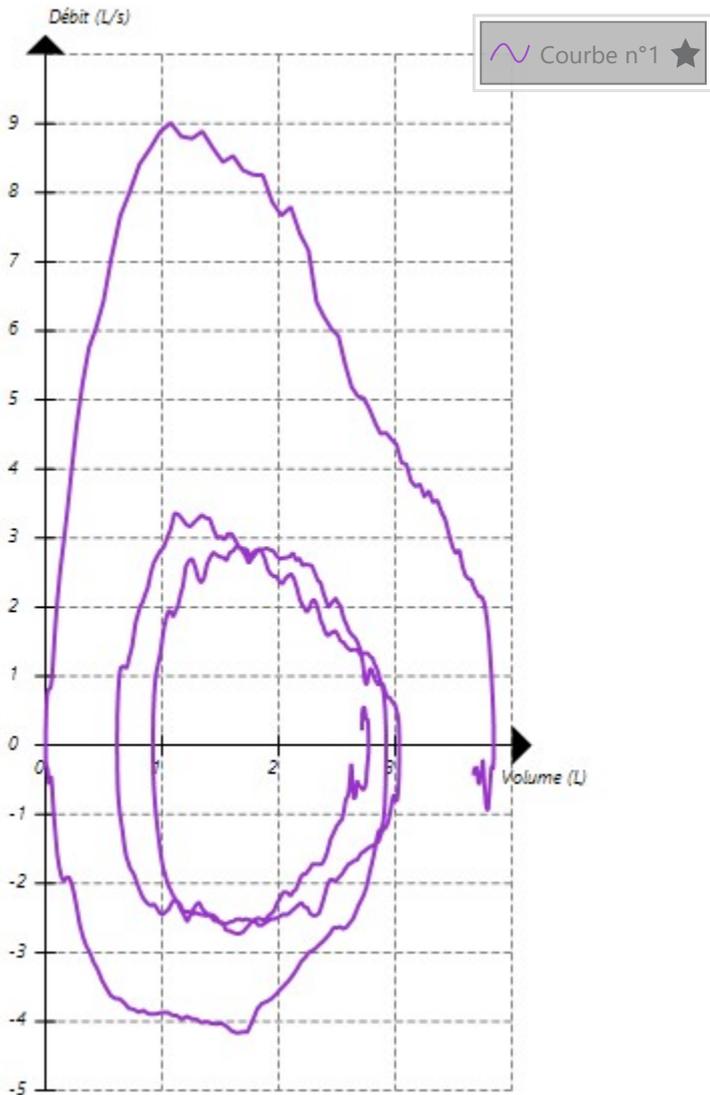

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,84 L	4,09 L	93,89 %
VEMS	3,84 L	3,51 L	109,40 %
DEP	9,07 L/s	8,95 L/s	101,34 %
VEMS/ CVF	100,00 %	85,22 %	117,34 %
Durée d'expiration	0,87 s	-	
DEMM	7,28 L/s	4,13 L/s	176,27 %
DEMM/ CVF	1,90 s-1	1,01 s-1	188,12 %
DE75	8,93 L/s	-	
DE50	7,79 L/s	-	
DE25	4,47 L/s	-	