



<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISMAEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> MENUISIER MONTEUR
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 322	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 65 %

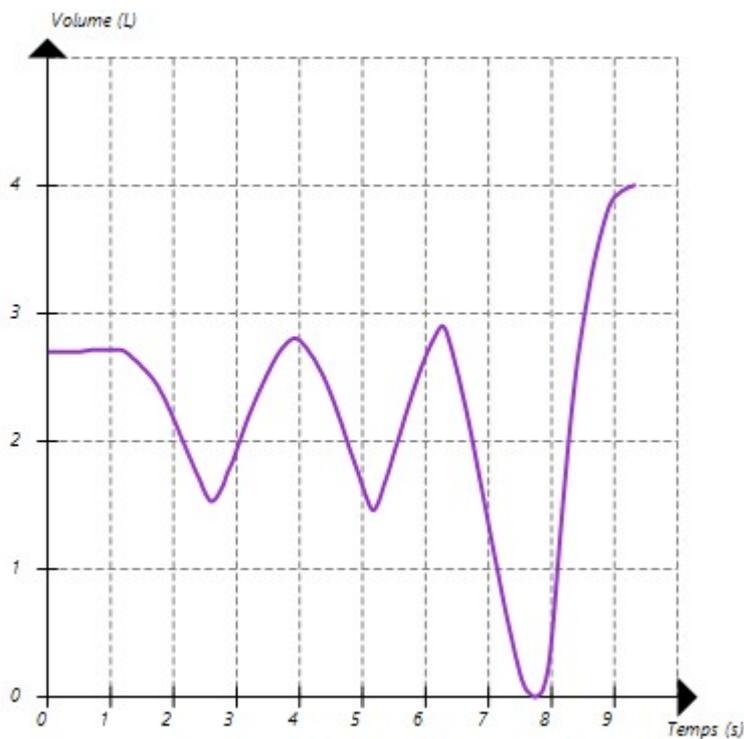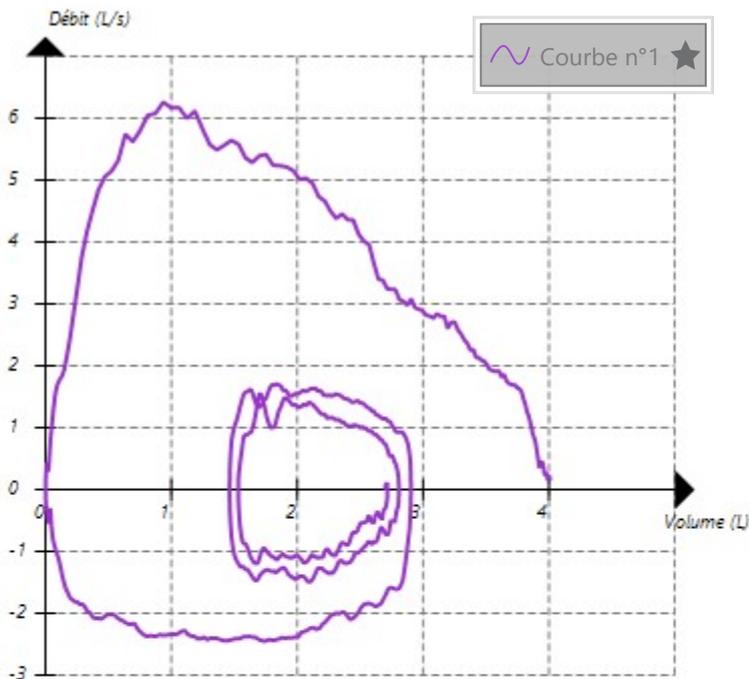

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,01 L	4,80 L	83,54 %
VEMS	3,86 L	4,06 L	95,07 %
DEP	6,30 L/s	10,10 L/s	62,38 %
VEMS/ CVF	96,26 %	84,85 %	113,45 %
Durée d'expiration	1,61 s	-	
DEMM	4,62 L/s	4,52 L/s	102,21 %
DEMM/ CVF	1,15 s-1	0,94 s-1	122,34 %
DE75	6,17 L/s	-	
DE50	5,03 L/s	-	
DE25	2,86 L/s	-	