

| | |
|--|--|
| Nom CONDE | Adresse |
| Prénom KALIL MAKAGBE | Exposition |
| Né le 07/06/1988 | Profession MENUISIER MONTEUR |
| Age 36 Ans | Entreprise IBS |
| Genre Masculin | Service |
| ID 326 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 168 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 75 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 66 %

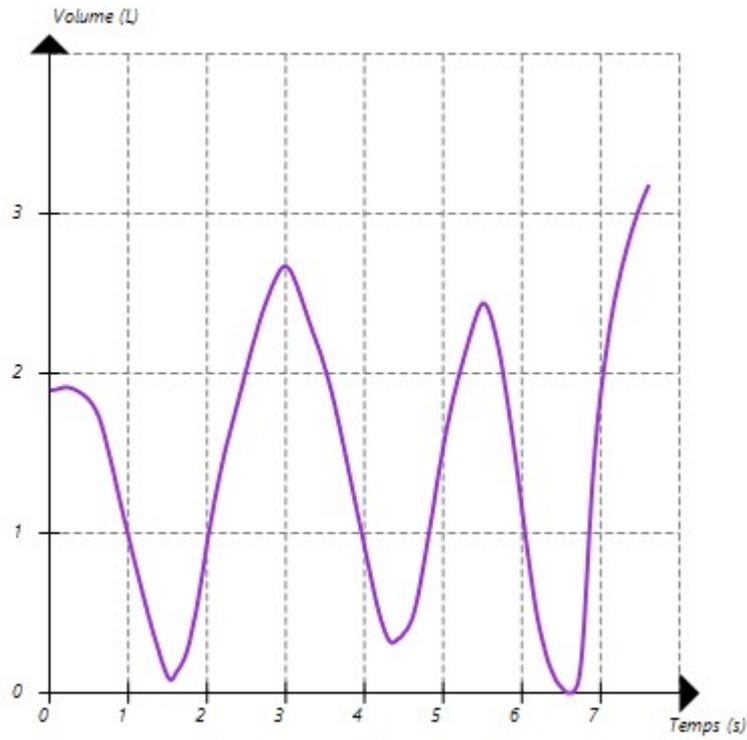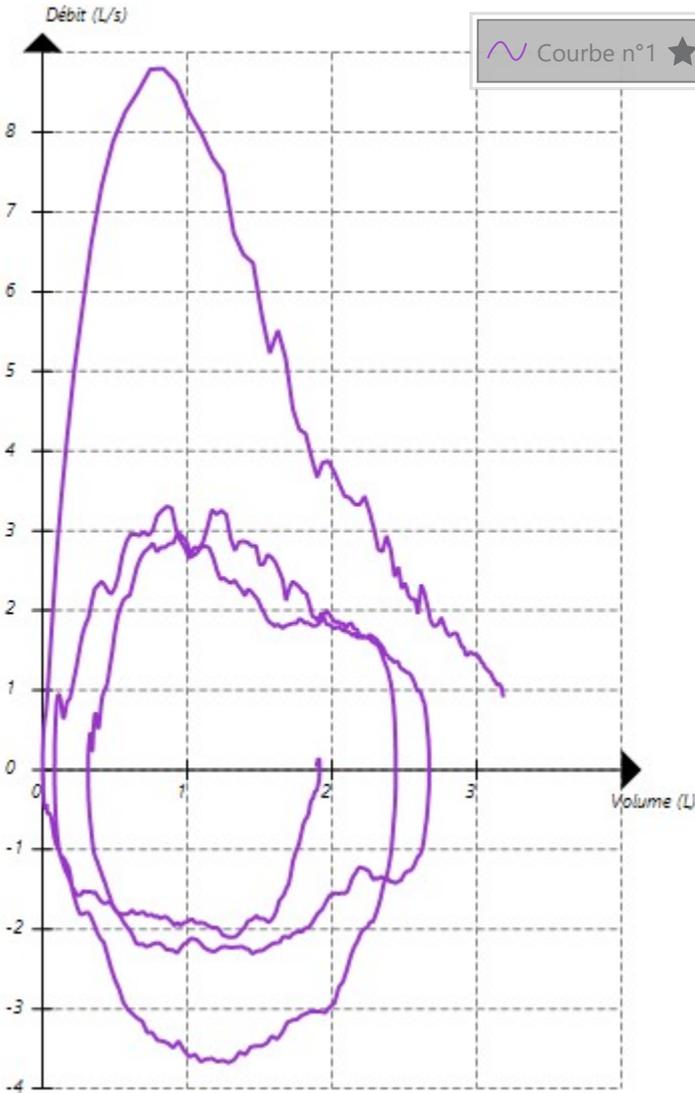

| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,19 L | 3,89 L | 82,01 % |
| VEMS | 3,19 L | 3,23 L | 98,76 % |
| DEP | 8,94 L/s | 8,47 L/s | 105,55 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 82,66 % | 120,98 % |
| Durée d'expiration | 1,00 s | - | |
| DEMM | 5,00 L/s | 3,57 L/s | 140,06 % |
| DEMM/CVF | 1,57 s-1 | 0,92 s-1 | 170,65 % |
| DE75 | 8,69 L/s | - | |
| DE50 | 5,68 L/s | - | |
| DE25 | 2,84 L/s | - | |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: