

<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/05/1995	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFER
<b>ID</b> 359	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

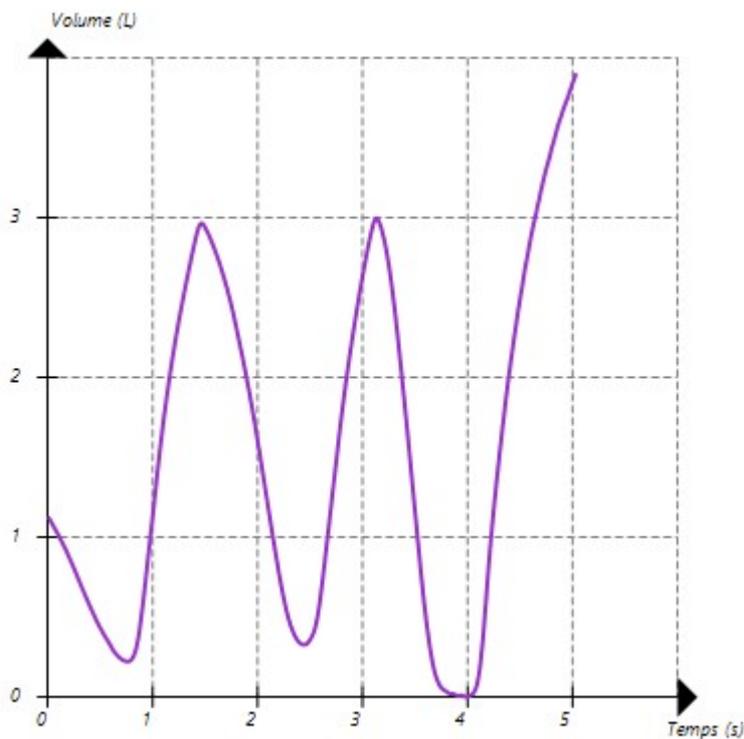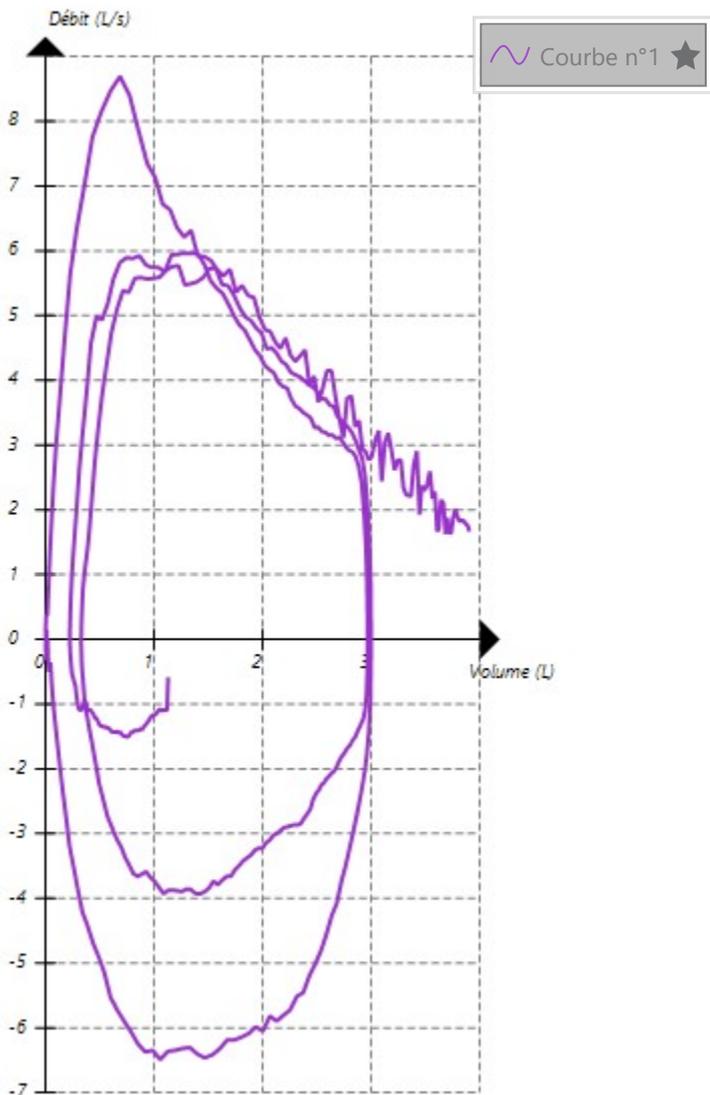

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,92 L	4,65 L	84,30 %
VEMS	3,92 L	3,90 L	100,51 %
DEP	8,84 L/s	9,80 L/s	90,20 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,94 %	119,13 %
Durée d'expiration	1,06 s	-	
DEMM	4,89 L/s	4,27 L/s	114,52 %
DEMM/CVF	1,25 s-1	0,92 s-1	135,87 %
DE75	7,12 L/s	-	
DE50	5,08 L/s	-	
DE25	3,26 L/s	-	