



<b>Nom</b> KPOGHOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MATHIAS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/01/1995	<b>Profession</b> AGENT HSE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 306	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 52 %

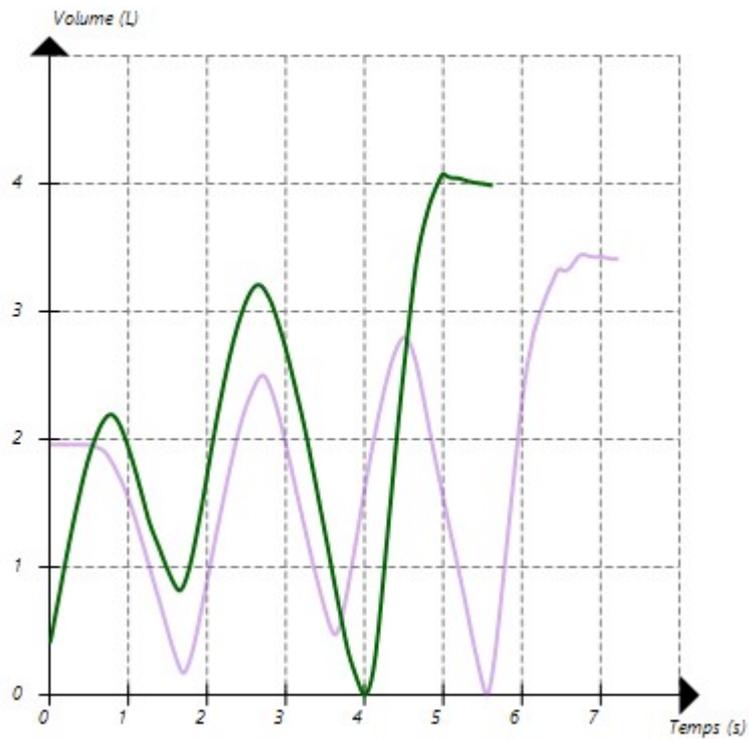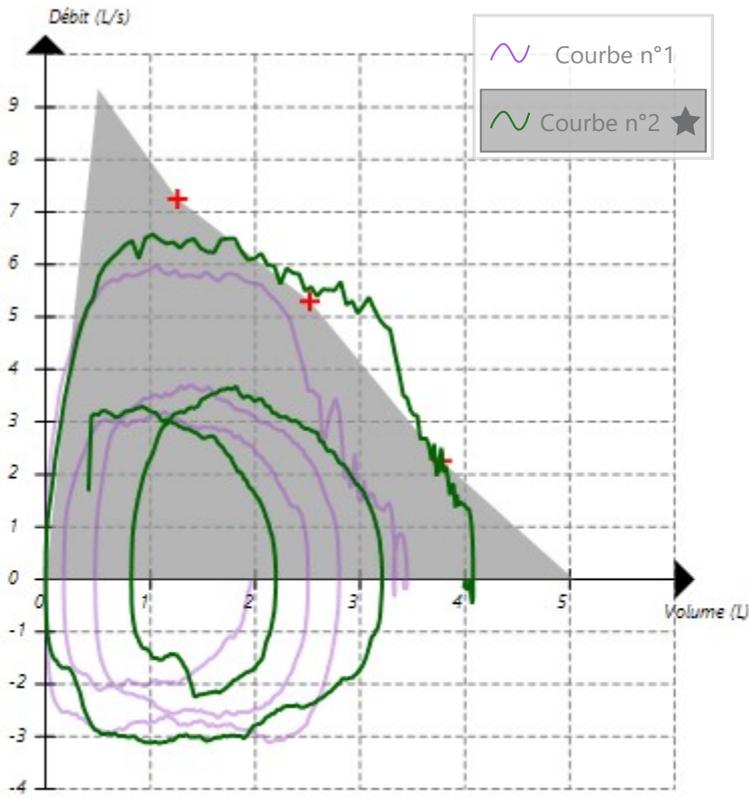

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,33 L	4,08 L	5,04 L	80,95 %
VEMS	3,33 L	4,08 L	4,21 L	96,91 %
DEP	6,08 L/s	6,78 L/s	9,35 L/s	72,51 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	83,66 %	119,53 %
Durée d'expiration	0,93 s	1,00 s	-	
DEMM	5,63 L/s	6,07 L/s	4,50 L/s	134,89 %
DEMM/ CVF	1,69 s-1	1,49 s-1	0,89 s-1	167,42 %
DE75	5,80 L/s	6,66 L/s	7,25 L/s	91,86 %
DE50	5,67 L/s	6,25 L/s	5,30 L/s	117,92 %
DE25	3,72 L/s	5,23 L/s	2,25 L/s	232,44 %