

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFER
<b>ID</b> 358	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

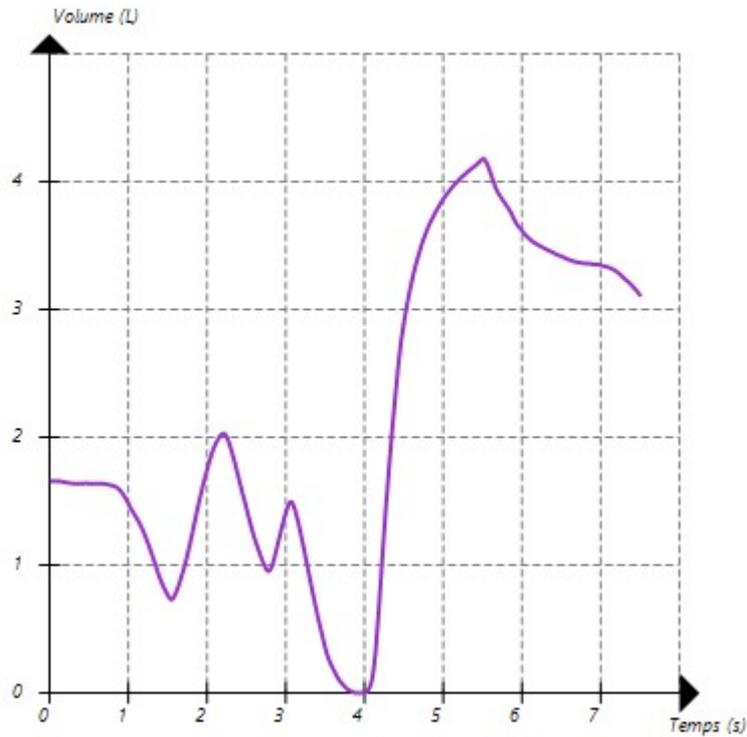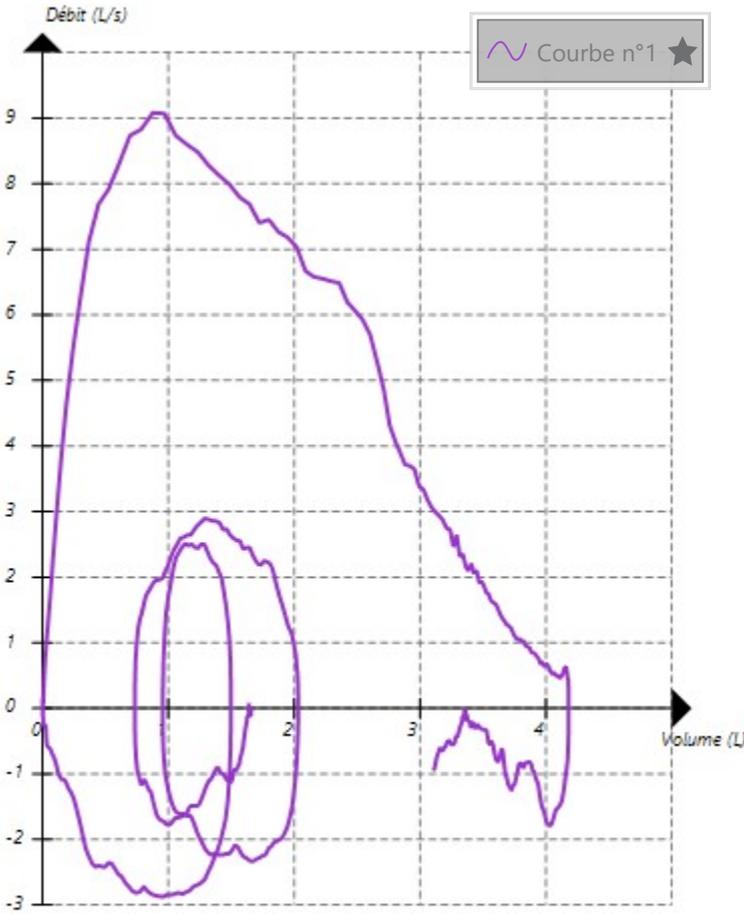

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,18 L	4,10 L	101,95 %
VEMS	3,95 L	3,39 L	116,52 %
DEP	9,20 L/s	8,80 L/s	104,55 %
VEMS/CVF	94,50 %	82,48 %	114,57 %
Durée d'expiration	1,56 s	-	
DEMM	6,03 L/s	3,67 L/s	164,31 %
DEMM/CVF	1,44 s-1	0,90 s-1	160,00 %
DE75	8,71 L/s	-	
DE50	6,68 L/s	-	
DE25	2,95 L/s	-	