

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DJIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 223	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 52 %

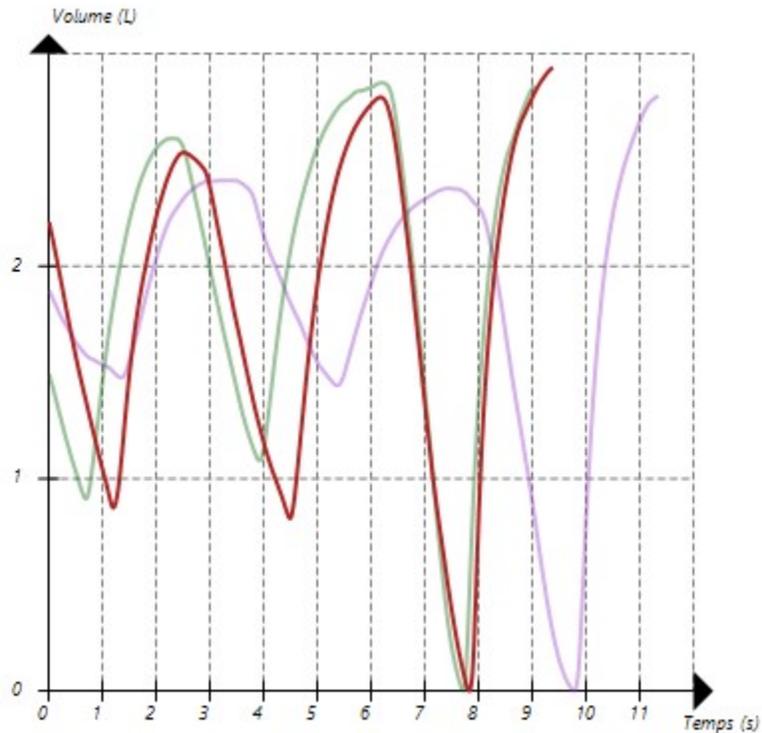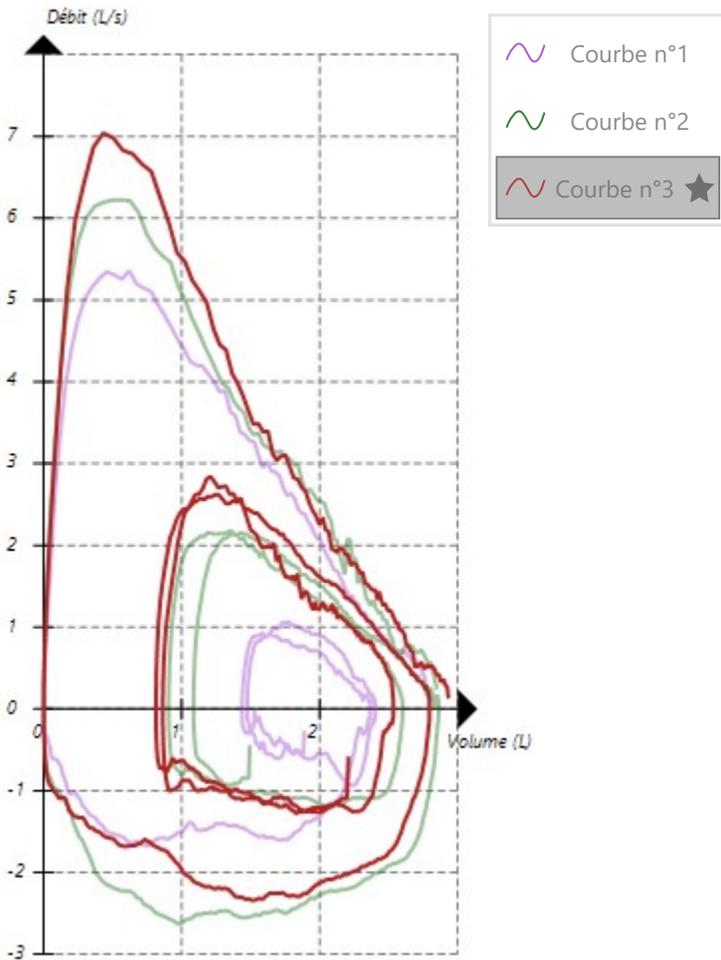

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	2,85 L	2,94 L	4,52 L	65,04 %
VEMS	2,58 L	2,69 L	2,73 L	3,81 L	71,65 %
DEP	5,38 L/s	6,28 L/s	7,13 L/s	-	
VEMS/ CVF	92,14 %	94,39 %	92,86 %	83,87 %	110,72 %
Durée d'expiration	1,58 s	1,34 s	1,57 s	-	
DEMM	3,29 L/s	3,64 L/s	3,54 L/s	4,21 L/s	84,09 %
DEMM/ CVF	1,18 s-1	1,28 s-1	1,20 s-1	0,93 s-1	129,03 %
DE75	5,13 L/s	5,97 L/s	6,69 L/s	-	
DE50	3,53 L/s	3,66 L/s	3,73 L/s	-	
DE25	1,69 L/s	1,85 L/s	1,90 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: