

<b>Nom</b> DRAME	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YOUSOUF ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/04/1995	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 243	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 30,2 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 58 %

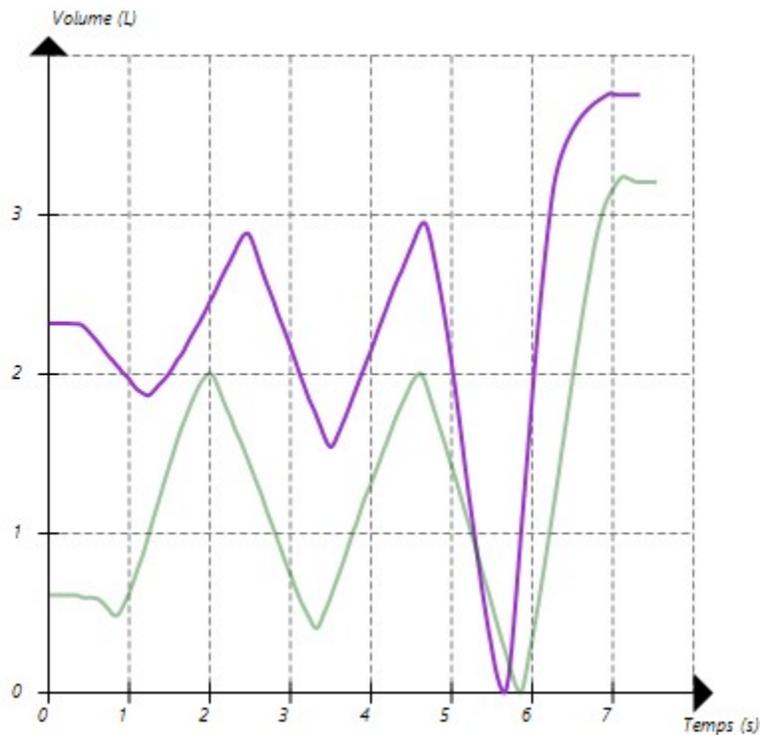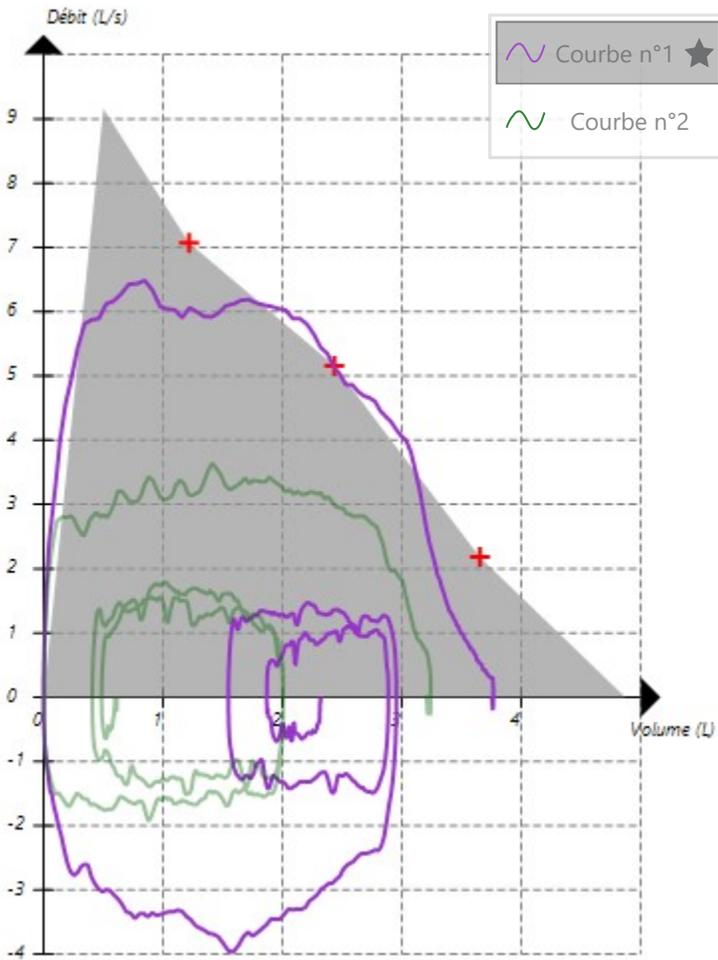

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,77 L	3,24 L	4,87 L	77,41 %
VEMS	3,67 L	3,09 L	4,08 L	89,95 %
DEP	6,58 L/s	3,70 L/s	9,16 L/s	71,83 %
VEMS/ CVF	97,35 %	95,37 %	83,66 %	116,36 %
Durée d'expiration	1,32 s	1,28 s	-	
DEMM	5,77 L/s	3,34 L/s	4,39 L/s	131,44 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,03 s-1	0,90 s-1	170,00 %
DE75	6,22 L/s	3,14 L/s	7,07 L/s	87,98 %
DE50	6,12 L/s	3,26 L/s	5,16 L/s	118,60 %
DE25	4,44 L/s	3,00 L/s	2,18 L/s	203,67 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: