



<b>Nom SOW</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MAMADOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 22/08/1971</b>	<b>Profession DIRECTEUR GENERAL</b>
<b>Age 53 Ans</b>	<b>Entreprise IBS</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 556</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 196 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %

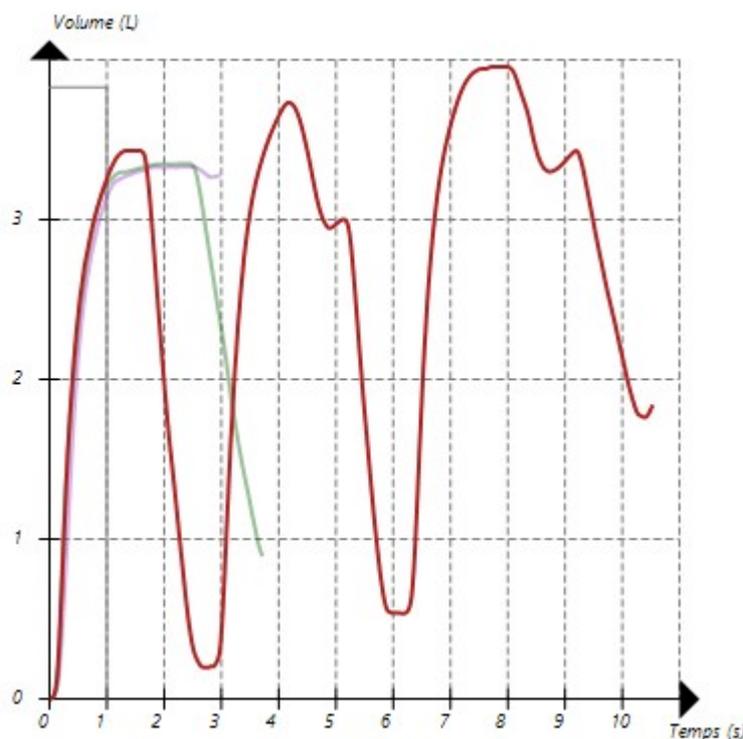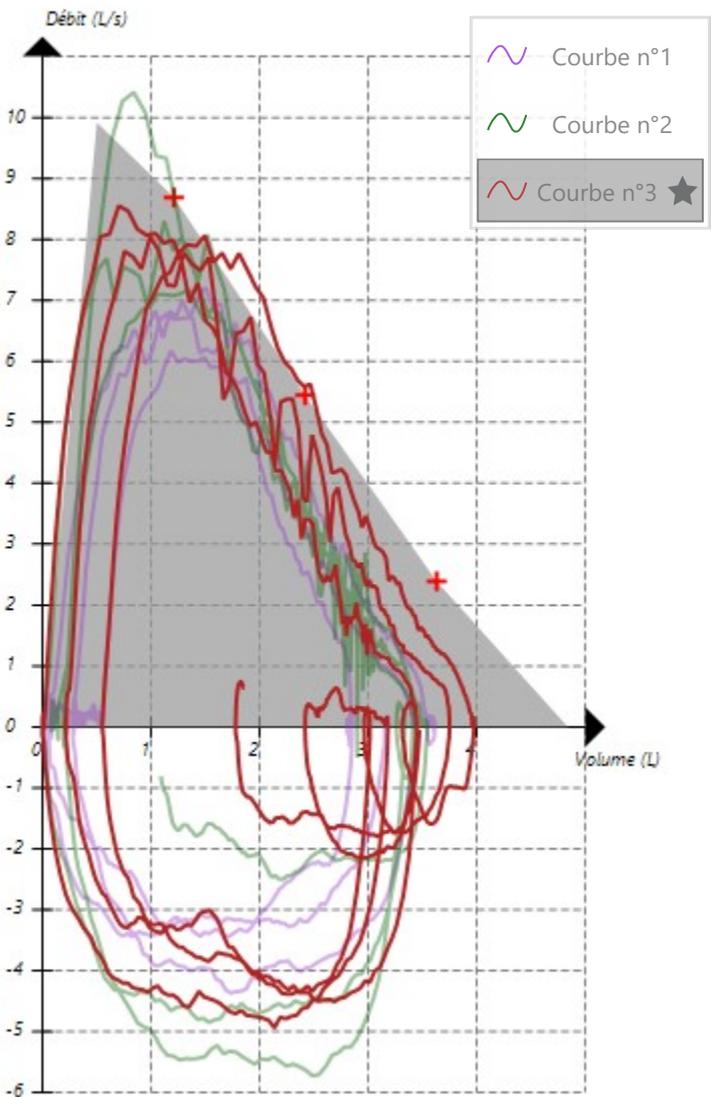

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,33 L	3,35 L	3,43 L	4,84 L	70,87 %
VEMS	3,24 L	3,28 L	3,36 L	3,83 L	87,73 %
DEP	7,58 L/s	10,78 L/s	9,13 L/s	9,92 L/s	92,04 %
VEMS/ CVF	97,30 %	97,91 %	97,96 %	77,72 %	126,04 %
Durée d'expiration	2,34 s	2,39 s	1,40 s	-	
DEMM	5,21 L/s	5,00 L/s	5,25 L/s	4,23 L/s	124,11 %
DEMM/ CVF	1,56 s-1	1,49 s-1	1,53 s-1	0,76 s-1	201,32 %
DE75	6,67 L/s	9,30 L/s	8,18 L/s	8,69 L/s	94,13 %
DE50	6,23 L/s	5,11 L/s	5,52 L/s	5,44 L/s	101,47 %
DE25	2,86 L/s	2,94 L/s	2,17 L/s	2,39 L/s	90,79 %