



<b>Nom</b> GUILAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MASSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 18/12/2000	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 331	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %

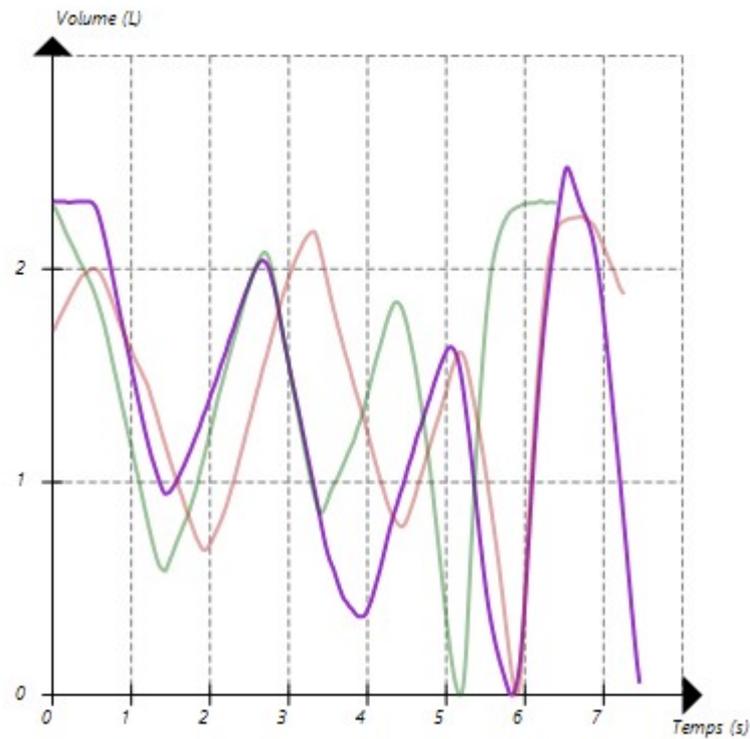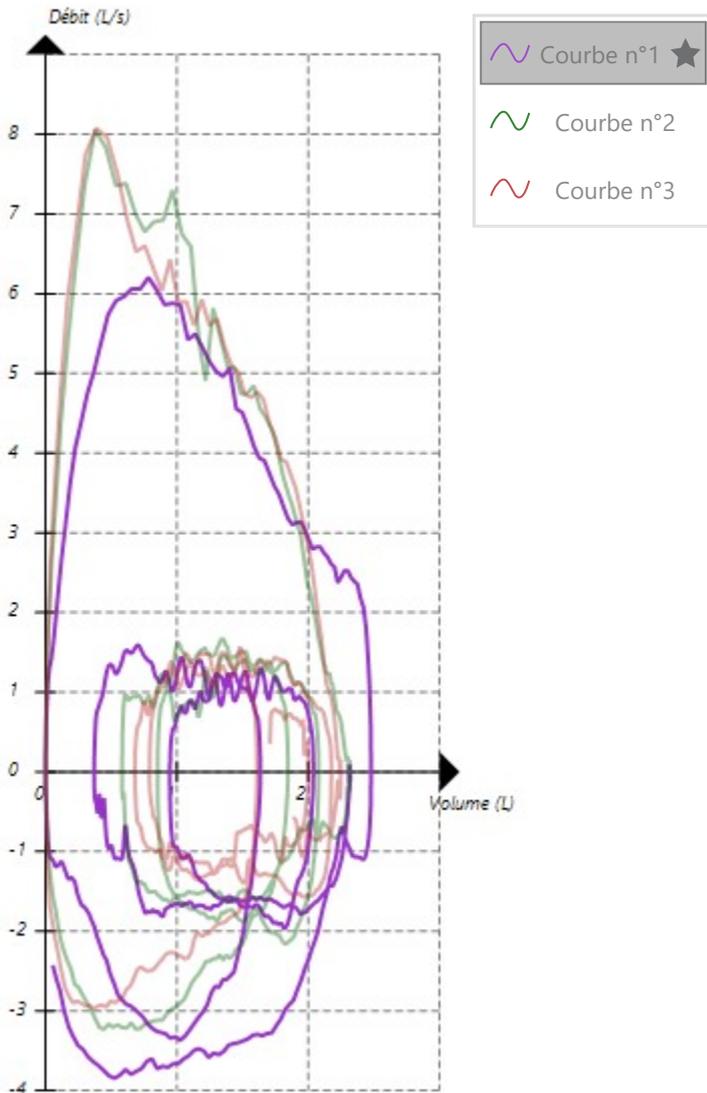

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,48 L	2,32 L	2,25 L	3,91 L	63,43 %
VEMS	2,48 L	2,32 L	2,25 L	3,36 L	73,81 %
DEP	6,22 L/s	8,25 L/s	8,13 L/s	8,64 L/s	71,99 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,03 %	117,61 %
Durée d'expiration	0,70 s	1,02 s	0,82 s	-	
DEMM	4,96 L/s	5,86 L/s	5,82 L/s	3,99 L/s	124,31 %
DEMM/ CVF	2,00 s-1	2,53 s-1	2,59 s-1	1,02 s-1	196,08 %
DE75	6,05 L/s	7,49 L/s	7,35 L/s	-	
DE50	5,08 L/s	5,20 L/s	5,76 L/s	-	
DE25	3,12 L/s	4,20 L/s	4,46 L/s	-	