

**Nom** KEITA  
**Prénom** SIDIKI  
**Né le** 01/01/1989  
**Age** 35 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 79  
**Taille** 171 cm  
**Poids** 77 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,9 °C

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Humidité : 48 %

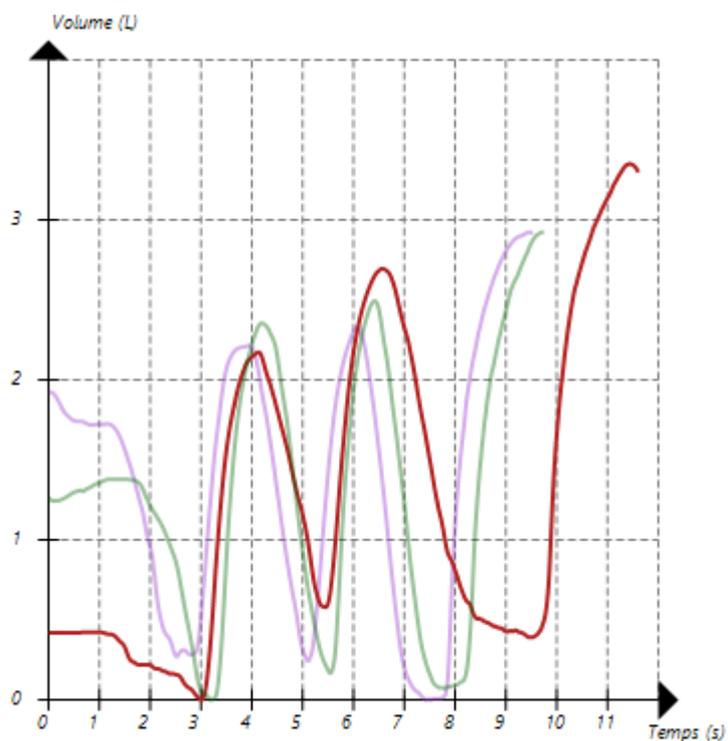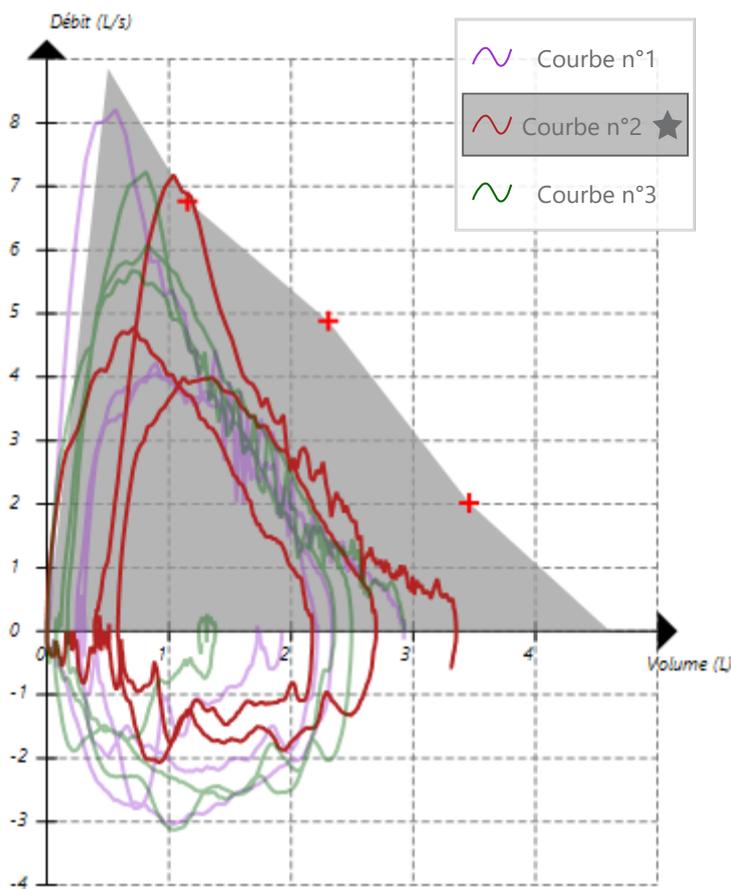

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,92 L	2,96 L	2,84 L	4,61 L	64,21 %
VEMS	2,70 L	2,60 L	2,59 L	3,84 L	67,71 %
DÉP	8,31 L/s	7,28 L/s	7,28 L/s	8,86 L/s	82,17 %
VEMS/ CVF	92,47 %	87,84 %	91,20 %	83,02 %	105,81 %
Durée d'expiration	1,93 s	1,92 s	1,86 s	-	
DEMM	3,18 L/s	2,99 L/s	2,97 L/s	4,11 L/s	72,75 %
DEMM/ CVF	1,09 s <sup>-1</sup>	1,01 s <sup>-1</sup>	1,05 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	113,48 %
DE75	6,81 L/s	6,90 L/s	7,20 L/s	6,77 L/s	101,92 %
DE50	4,40 L/s	3,33 L/s	3,13 L/s	4,88 L/s	68,24 %
DE25	1,65 L/s	1,10 L/s	1,65 L/s	2,02 L/s	54,46 %