

**Nom** BEAVOGUI  
**Prénom** BALE  
**Né le** 01/01/1977  
**Age** 47 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 98  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 85 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MAçon  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 46 %

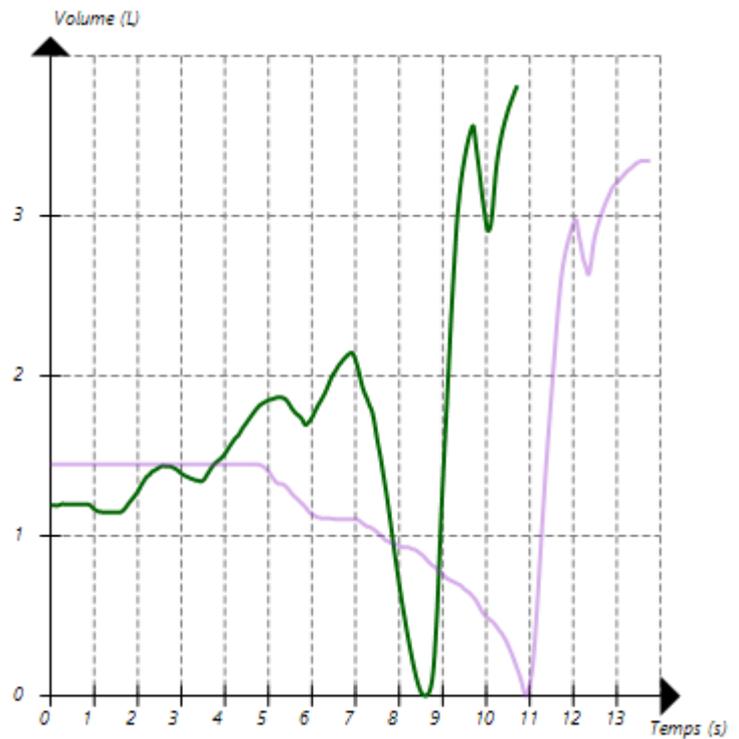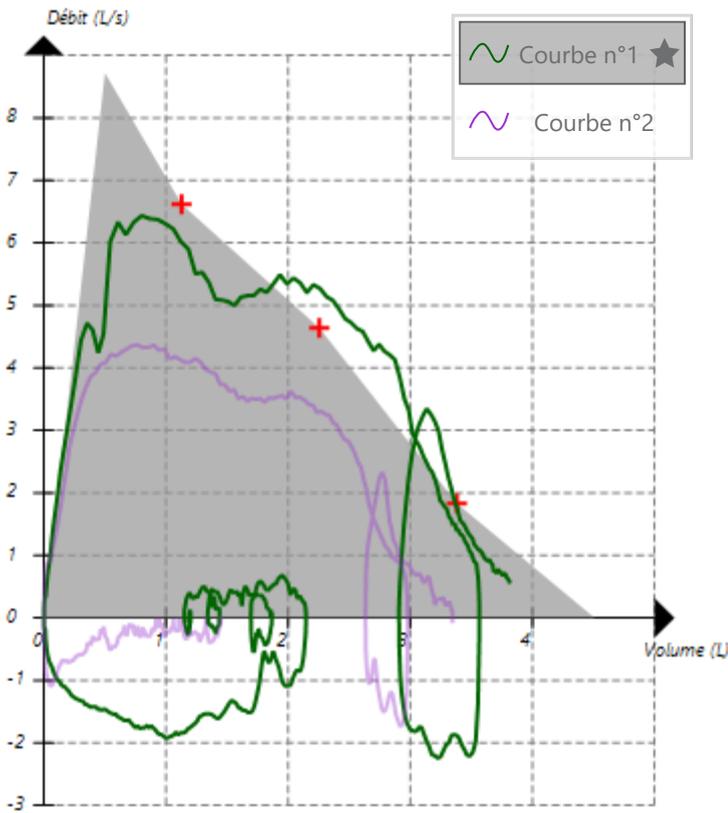

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,57 L	2,98 L	4,51 L	79,16 %
VEMS	3,57 L	2,98 L	3,69 L	96,75 %
DÉP	6,57 L/s	4,45 L/s	8,72 L/s	75,34 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	81,76 %	122,31 %
Durée d'expiration	1,10 s	1,15 s	-	
DEMM	5,40 L/s	3,87 L/s	3,85 L/s	140,26 %
DEMM/ CVF	1,51 s-1	1,30 s-1	0,85 s-1	177,65 %
DE75	6,16 L/s	4,40 L/s	6,62 L/s	93,05 %
DE50	5,29 L/s	3,71 L/s	4,64 L/s	114,01 %
DE25	4,07 L/s	3,29 L/s	1,83 L/s	222,40 %