

**Nom** KOUROUMA  
**Prénom** BANGALY  
**Né le** 01/01/1984  
**Age** 40 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 47  
**Taille** 176 cm  
**Poids** 80 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR BETONNIE  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 49 %

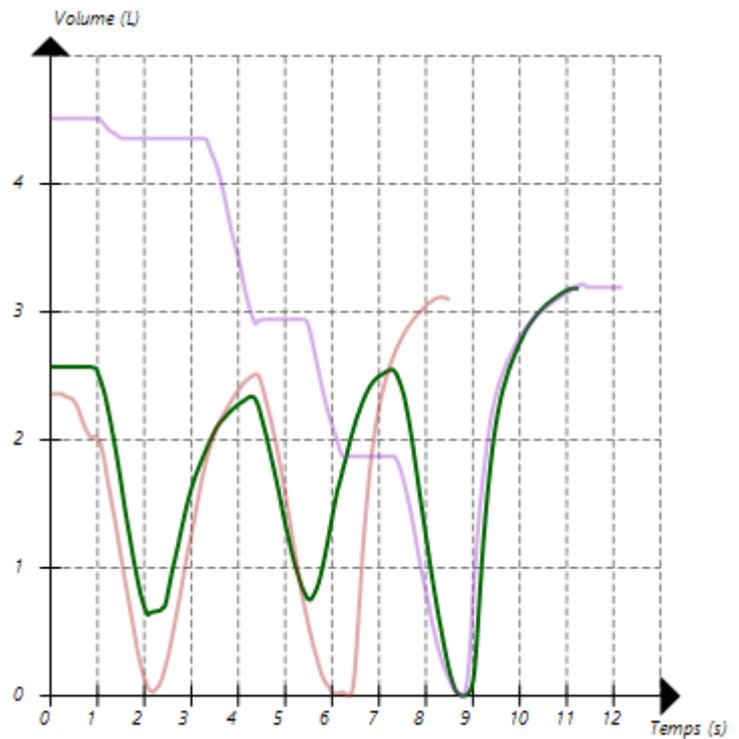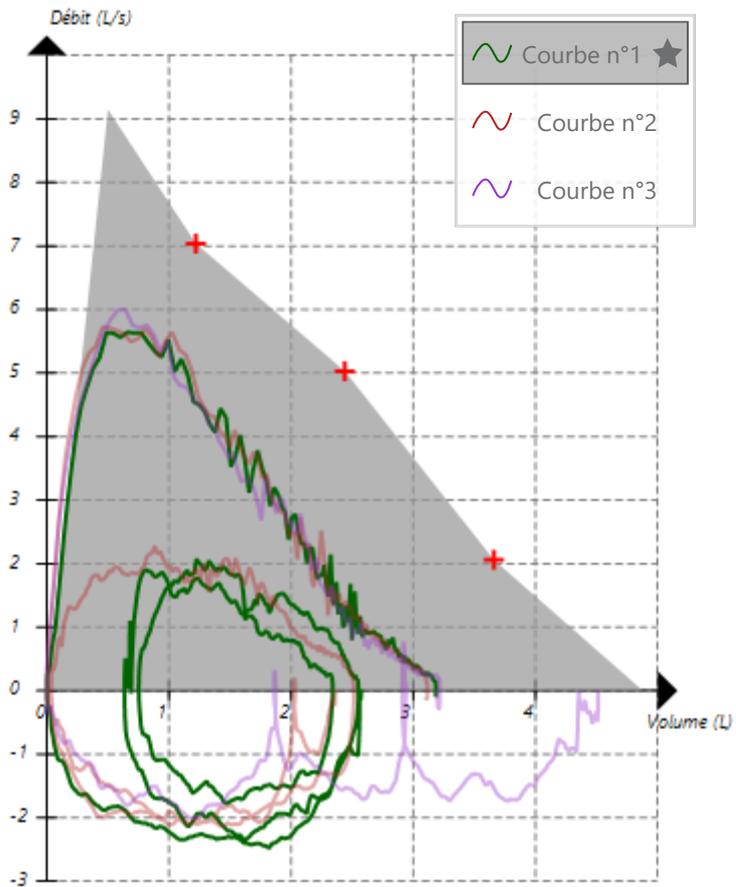

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,19 L	3,12 L	3,22 L	4,88 L	65,37 %
VEMS	2,76 L	2,78 L	2,72 L	4,03 L	68,49 %
DÉP	5,80 L/s	5,91 L/s	6,10 L/s	9,15 L/s	63,39 %
VEMS/ CVF	86,52 %	89,10 %	84,47 %	82,50 %	104,87 %
Durée d'expiration	2,32 s	1,95 s	2,57 s	-	
DEMM	3,25 L/s	3,41 L/s	3,06 L/s	4,22 L/s	77,01 %
DEMM/ CVF	1,02 s <sup>-1</sup>	1,09 s <sup>-1</sup>	0,95 s <sup>-1</sup>	0,86 s <sup>-1</sup>	118,60 %
DE75	5,46 L/s	5,70 L/s	5,71 L/s	7,04 L/s	77,56 %
DE50	3,92 L/s	3,98 L/s	3,15 L/s	5,03 L/s	77,93 %
DE25	1,36 L/s	1,68 L/s	1,35 L/s	2,06 L/s	66,02 %