

<b>Nom</b> DIOUBATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1974	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 50 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 308	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 62 %

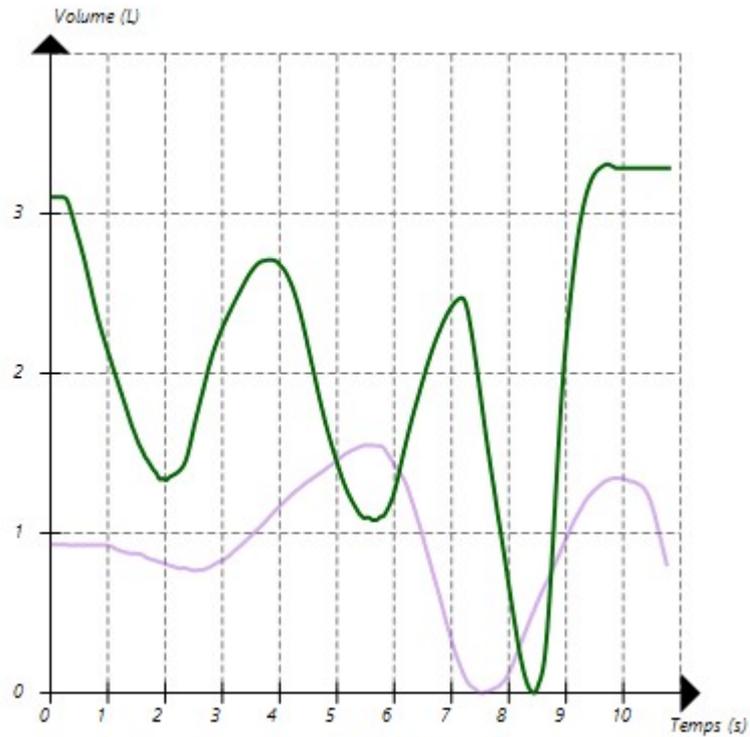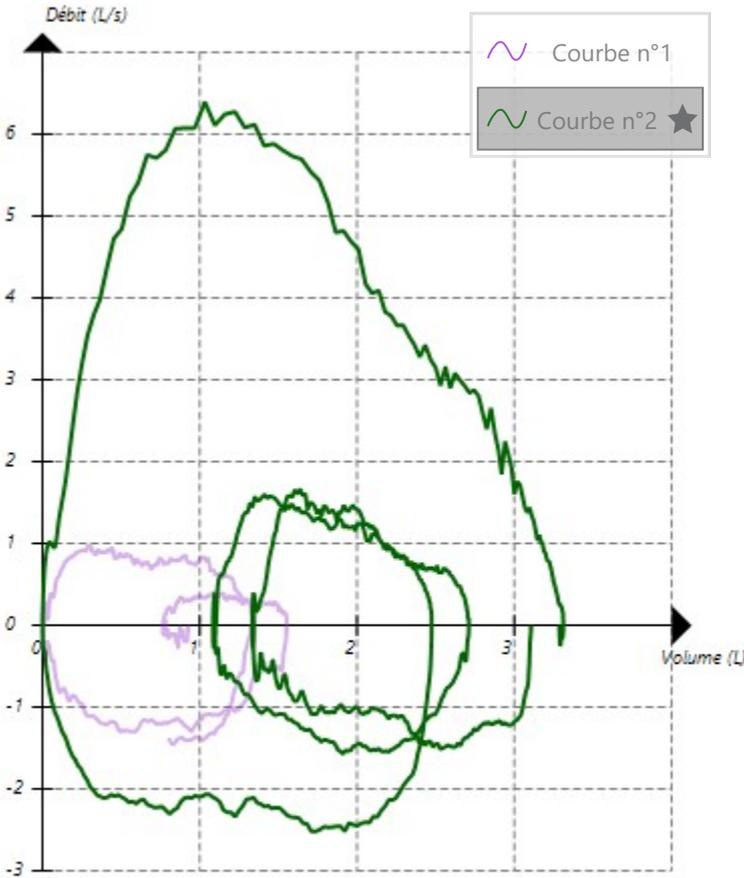

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,34 L	3,31 L	3,75 L	88,27 %
VEMS	0,87 L	3,29 L	3,00 L	109,67 %
DEP	1,02 L/s	6,51 L/s	8,08 L/s	80,57 %
VEMS/CVF	64,93 %	99,40 %	80,10 %	124,09 %
Durée d'expiration	2,28 s	1,27 s	-	
DEMM	0,82 L/s	5,05 L/s	3,05 L/s	165,57 %
DEMM/CVF	0,61 s-1	1,53 s-1	0,81 s-1	188,89 %
DE75	0,89 L/s	6,12 L/s	-	
DE50	0,74 L/s	5,52 L/s	-	
DE25	0,82 L/s	3,10 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: