



<b>Nom</b> BILIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FOROMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/1994	<b>Profession</b> AGENT HSE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 301	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 51 %

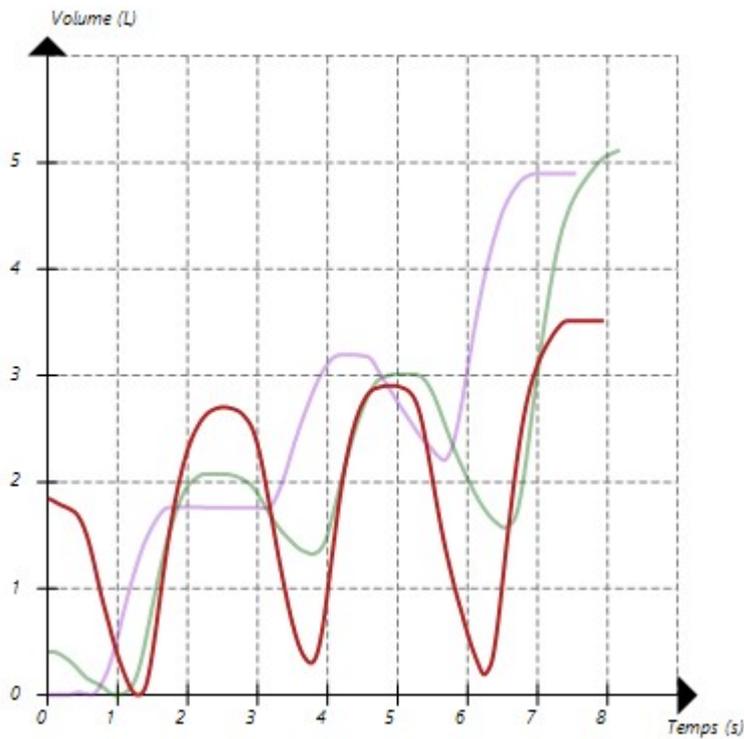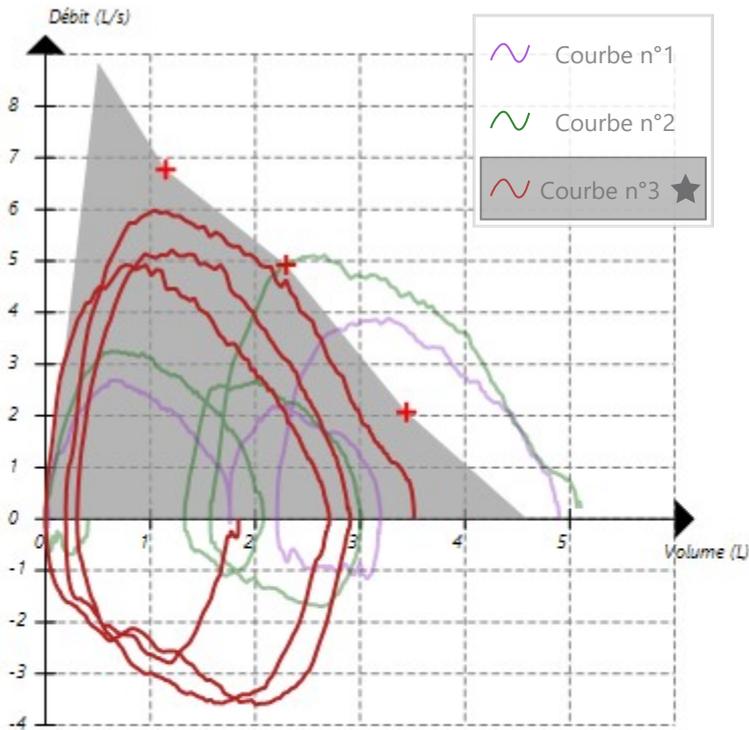

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,69 L	3,55 L	3,32 L	4,59 L	72,33 %
VEMS	2,63 L	3,30 L	3,30 L	3,85 L	85,71 %
DEP	3,94 L/s	5,20 L/s	6,06 L/s	8,85 L/s	68,47 %
VEMS/CVF	97,77 %	92,96 %	99,40 %	83,55 %	118,97 %
Durée d'expiration	1,33 s	1,67 s	1,19 s	-	
DEMM	3,36 L/s	4,31 L/s	5,02 L/s	4,18 L/s	120,10 %
DEMM/CVF	1,25 s-1	1,21 s-1	1,51 s-1	0,91 s-1	165,93 %
DE75	3,78 L/s	5,14 L/s	5,98 L/s	6,77 L/s	88,33 %
DE50	3,44 L/s	4,43 L/s	5,27 L/s	4,92 L/s	107,11 %
DE25	2,34 L/s	2,76 L/s	3,18 L/s	2,07 L/s	153,62 %