

<b>Nom</b> DOUKOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/06/1984	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 241	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 89 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %

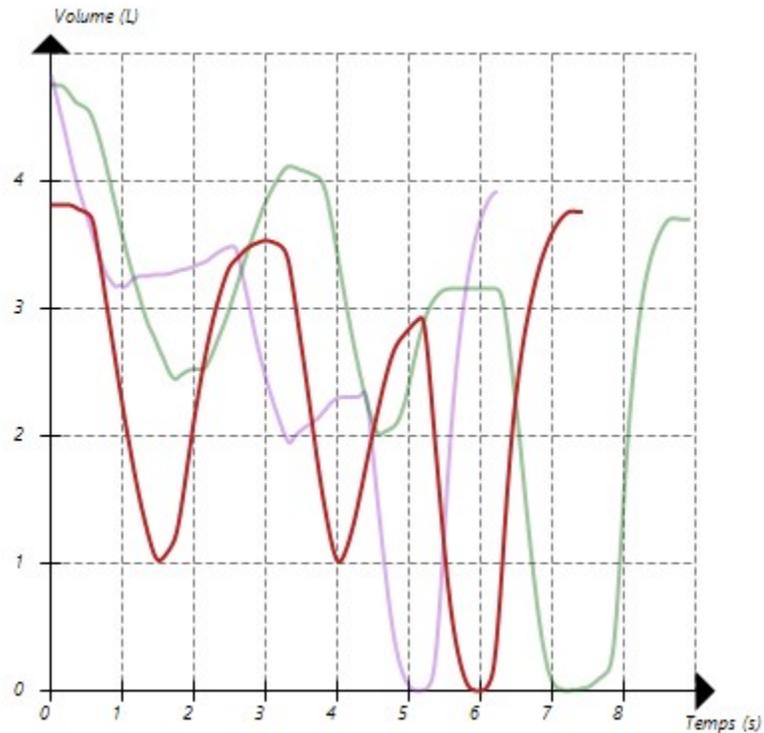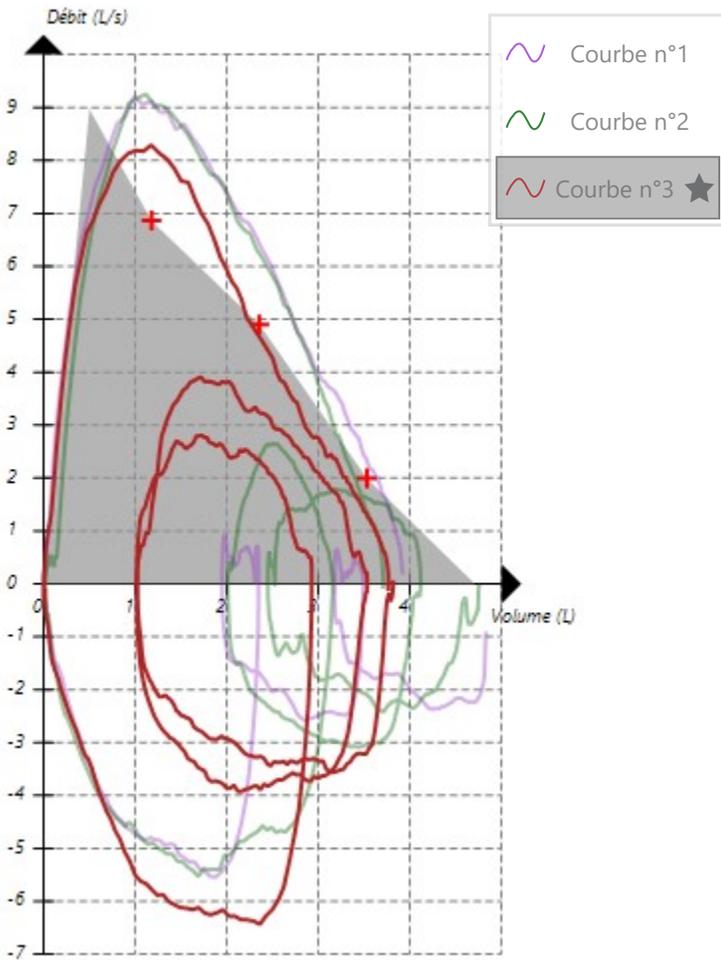

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,92 L	3,69 L	3,77 L	4,71 L	80,04 %
VEMS	3,92 L	3,69 L	3,74 L	3,89 L	96,14 %
DEP	9,29 L/s	9,34 L/s	8,38 L/s	8,97 L/s	93,42 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	99,20 %	82,50 %	120,24 %
Durée d'expiration	1,14 s	1,25 s	1,33 s	-	
DEMM	7,05 L/s	7,38 L/s	5,79 L/s	4,10 L/s	141,22 %
DEMM/ CVF	1,80 s-1	2,00 s-1	1,54 s-1	0,87 s-1	177,01 %
DE75	9,28 L/s	9,17 L/s	7,95 L/s	6,86 L/s	115,89 %
DE50	7,60 L/s	7,73 L/s	6,29 L/s	4,90 L/s	128,37 %
DE25	4,12 L/s	4,76 L/s	3,10 L/s	1,99 L/s	155,78 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: