

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Nom</b> DRAMOU                   | <b>Adresse</b>                           |
| <b>Prénom</b> HENRY                 | <b>Exposition</b>                        |
| <b>Né le</b> 03/07/1974             | <b>Profession</b> MACON                  |
| <b>Age</b> 49 Ans                   | <b>Entreprise</b> IBS                    |
| <b>Genre</b> Masculin               | <b>Service</b>                           |
| <b>ID</b> 219                       | <b>Fumeur</b> Fumeur                     |
| <b>Taille</b> 171 cm                | <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine |
| <b>Poids</b> 65 kg                  | <b>Prescripteur:</b>                     |
| <b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo) | <b>Smoking Pack Years</b> : 0            |
| <b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU        |  |



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 48 %

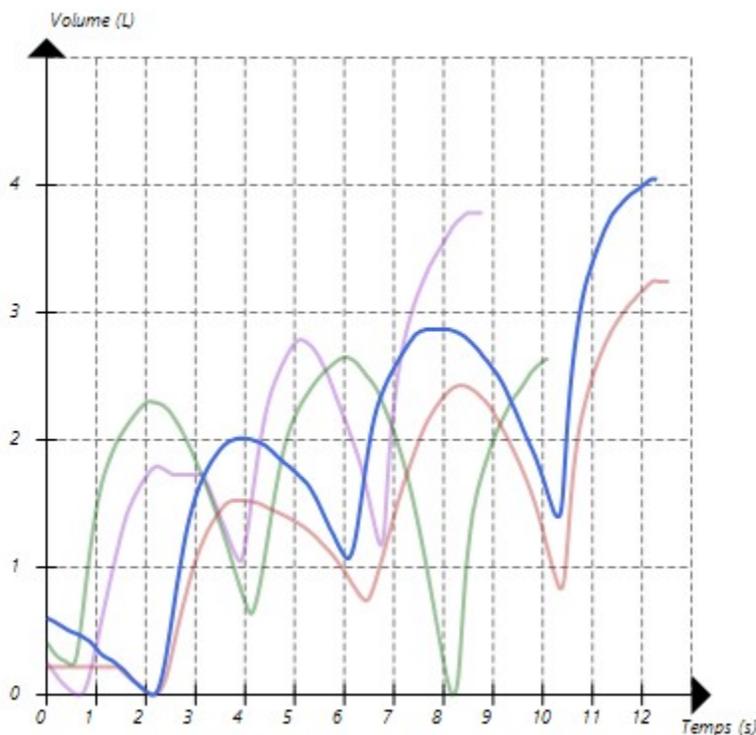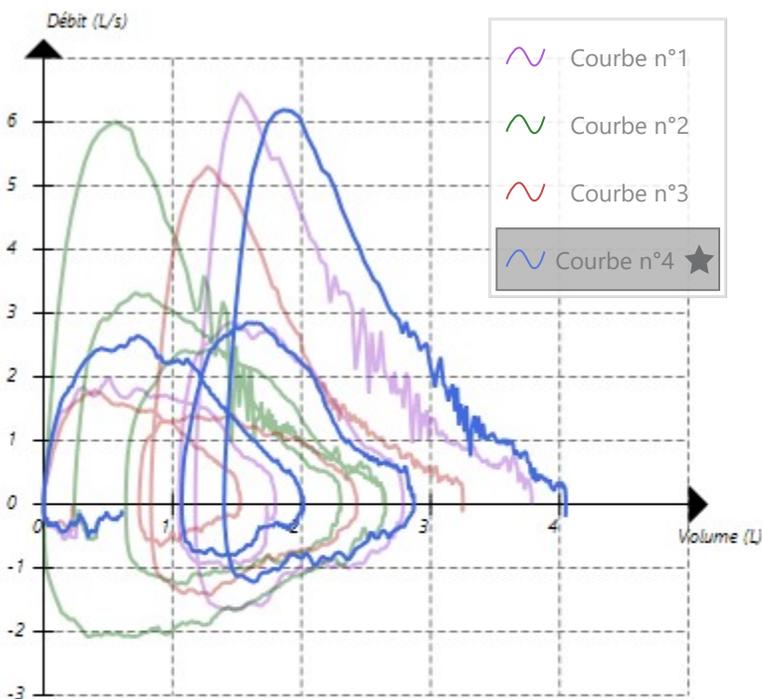

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 | Courbe n°4 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,61 L     | 2,64 L     | 2,42 L     | 2,65 L               | 4,56 L   | 58,11 %   |
| VEMS               | 2,24 L     | 2,23 L     | 2,05 L     | 2,36 L               | 3,69 L   | 63,96 %   |
| DEP                | 6,53 L/s   | 6,07 L/s   | 5,33 L/s   | 6,24 L/s             | -        |           |
| VEMS/ CVF          | 85,82 %    | 84,47 %    | 84,71 %    | 89,06 %              | 80,81 %  | 110,21 %  |
| Durée d'expiration | 1,76 s     | 1,92 s     | 1,88 s     | 1,90 s               | -        |           |
| DEMM               | 2,28 L/s   | 2,24 L/s   | 2,04 L/s   | 2,60 L/s             | 3,76 L/s | 69,15 %   |
| DEMM/ CVF          | 0,87 s-1   | 0,85 s-1   | 0,84 s-1   | 0,98 s-1             | 0,82 s-1 | 119,51 %  |
| DE75               | 5,40 L/s   | 5,89 L/s   | 4,89 L/s   | 5,73 L/s             | -        |           |
| DE50               | 3,12 L/s   | 2,20 L/s   | 2,23 L/s   | 2,94 L/s             | -        |           |
| DE25               | 0,95 L/s   | 1,07 L/s   | 0,89 L/s   | 0,99 L/s             | -        |           |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: