

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1976	<b>Profession</b> CHAUFFEUR BUS
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 187	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Humidité : 56 %

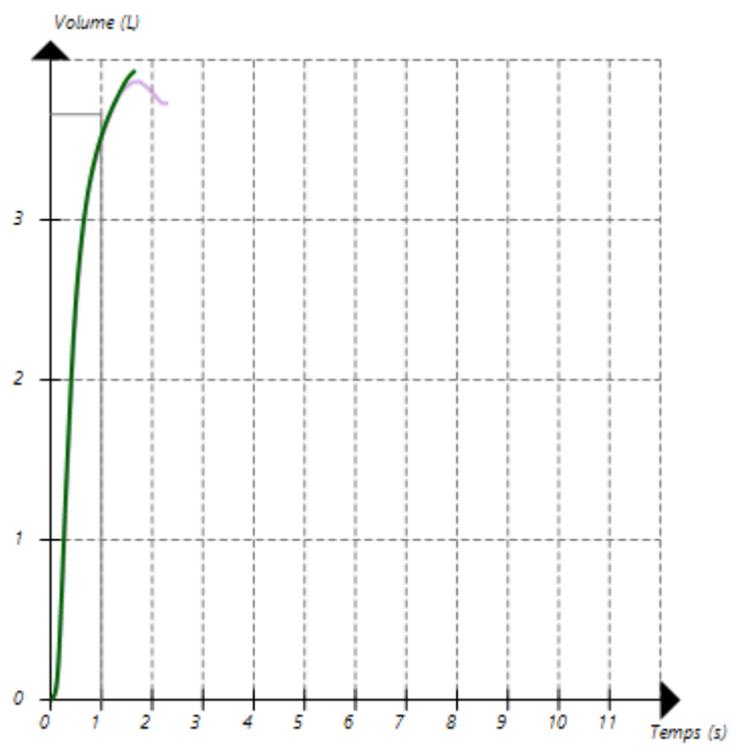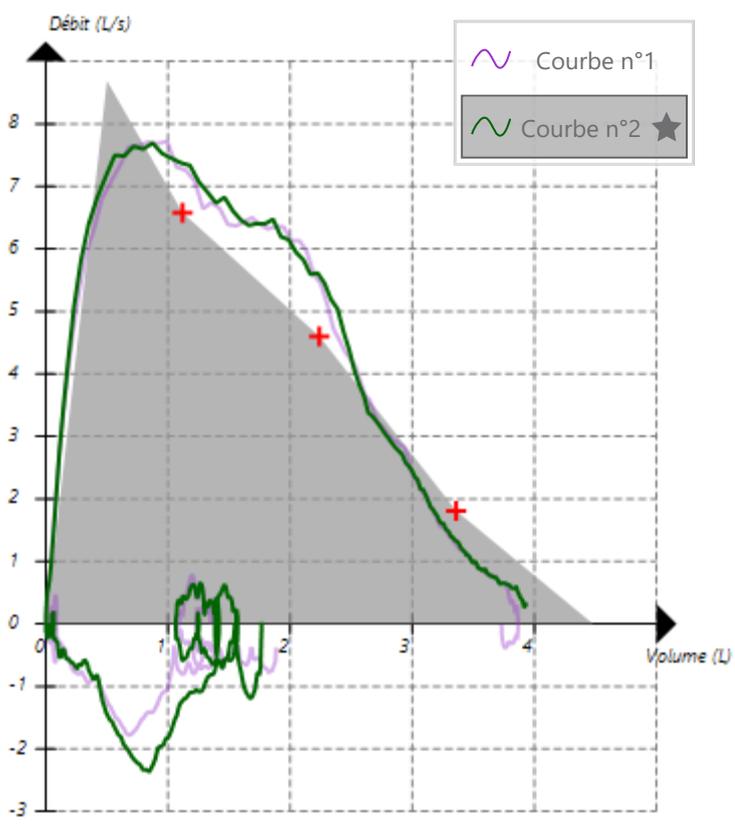

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,87 L	3,94 L	4,48 L	87,95 %
VEMS	3,63 L	3,64 L	3,66 L	99,45 %
DÉP	7,88 L/s	7,81 L/s	8,69 L/s	89,87 %
VEMS/ CVF	93,80 %	92,39 %	81,66 %	113,14 %
Durée d'expiration	1,72 s	1,75 s	-	
DEMM	5,34 L/s	5,18 L/s	3,81 L/s	135,96 %
DEMM/ CVF	1,38 s-1	1,31 s-1	0,85 s-1	154,12 %
DE75	7,88 L/s	7,37 L/s	6,58 L/s	112,01 %
DE50	6,26 L/s	6,08 L/s	4,60 L/s	132,17 %
DE25	2,88 L/s	2,55 L/s	1,81 L/s	140,88 %