

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/03/1998	<b>Profession</b> AGENT DE SECURITE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> G4S
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 12	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,2 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 59 %

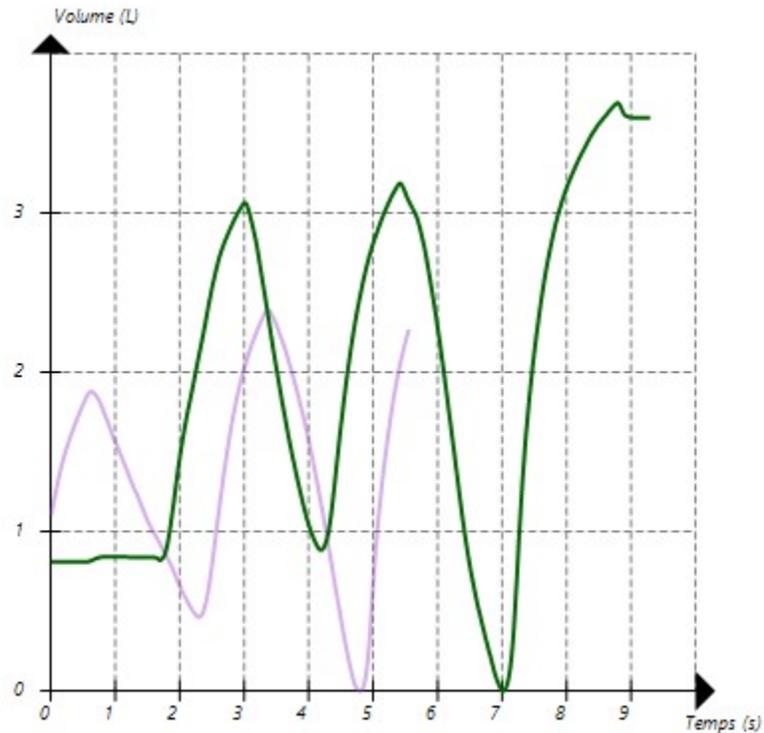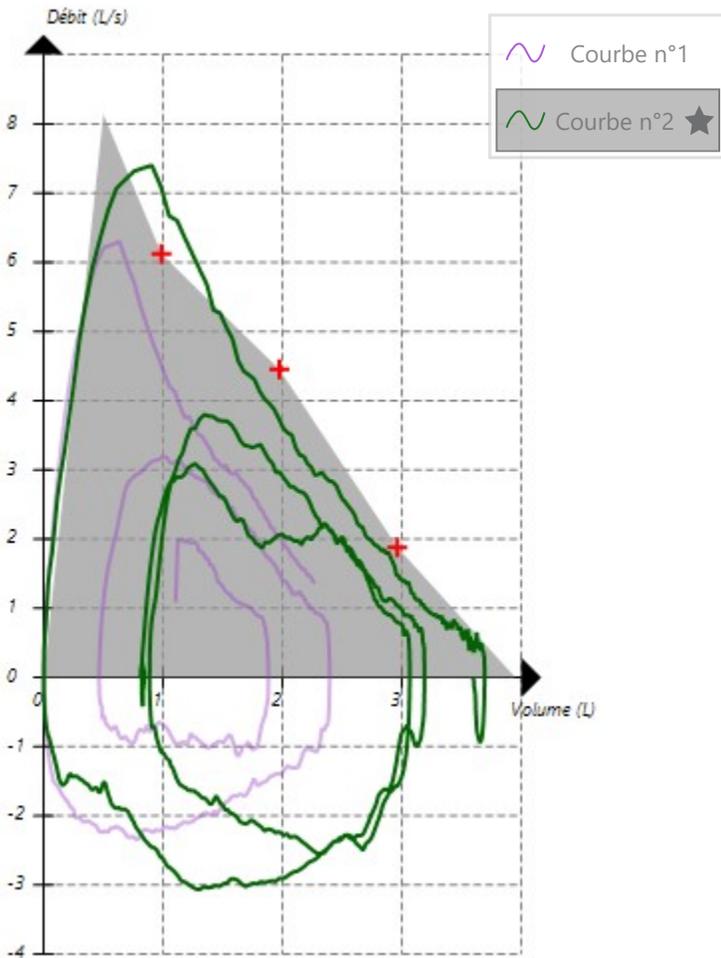

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,29 L	3,69 L	3,95 L	93,42 %
VEMS	2,29 L	3,29 L	3,37 L	97,63 %
DEP	6,37 L/s	7,43 L/s	8,14 L/s	91,28 %
VEMS/ CVF	100,00 %	89,16 %	83,97 %	106,18 %
Durée d'expiration	0,78 s	1,78 s	-	
DEMM	4,01 L/s	3,81 L/s	3,80 L/s	100,26 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	1,03 s-1	0,96 s-1	107,29 %
DE75	6,25 L/s	7,40 L/s	6,12 L/s	120,92 %
DE50	3,90 L/s	4,00 L/s	4,45 L/s	89,89 %
DE25	2,76 L/s	1,91 L/s	1,88 L/s	101,60 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: