



<b>Nom</b> KALIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BARRET KOLIA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/09/1995	<b>Profession</b> VIGIL
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> G4S
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 87	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 59 %

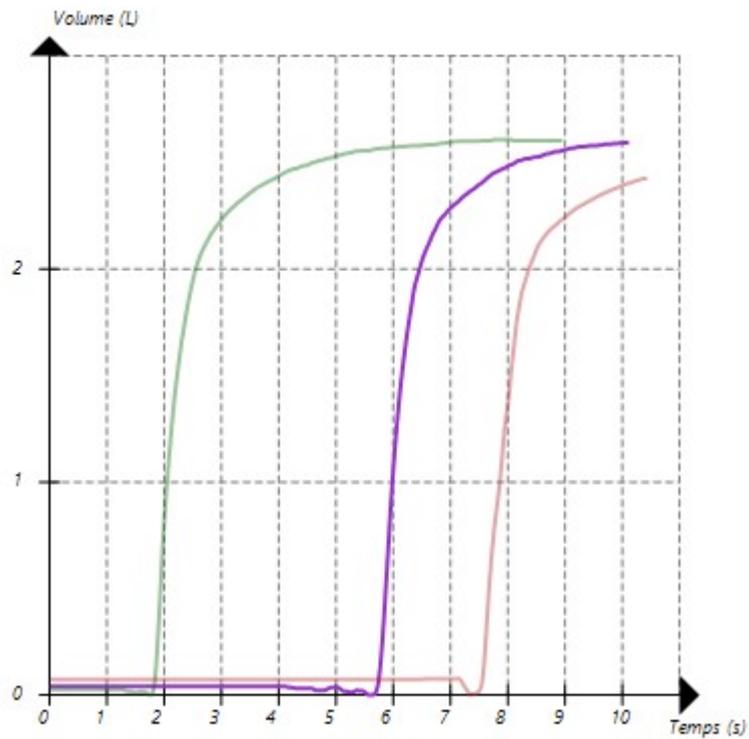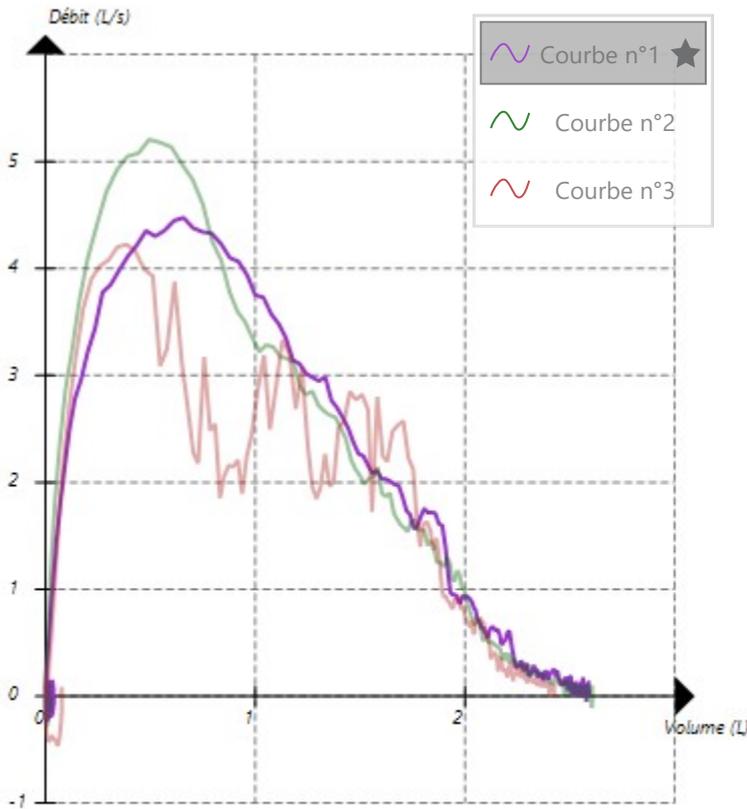

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,59 L	2,61 L	2,42 L	4,71 L	54,99 %
VEMS	2,20 L	2,17 L	2,11 L	3,95 L	55,70 %
DEP	4,58 L/s	5,33 L/s	4,33 L/s	9,90 L/s	46,26 %
VEMS/ CVF	84,94 %	83,14 %	87,19 %	83,94 %	101,19 %
Durée d'expiration	4,50 s	6,21 s	2,95 s	-	
DEMM	2,61 L/s	2,40 L/s	2,46 L/s	4,31 L/s	60,56 %
DEMM/ CVF	1,01 s-1	0,92 s-1	1,02 s-1	0,92 s-1	109,78 %
DE75	4,41 L/s	5,06 L/s	4,14 L/s	-	
DE50	3,10 L/s	2,66 L/s	3,02 L/s	-	
DE25	0,96 L/s	1,13 L/s	1,78 L/s	-	