



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAMINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> TAPICIER
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> MBCEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 06	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 46 %

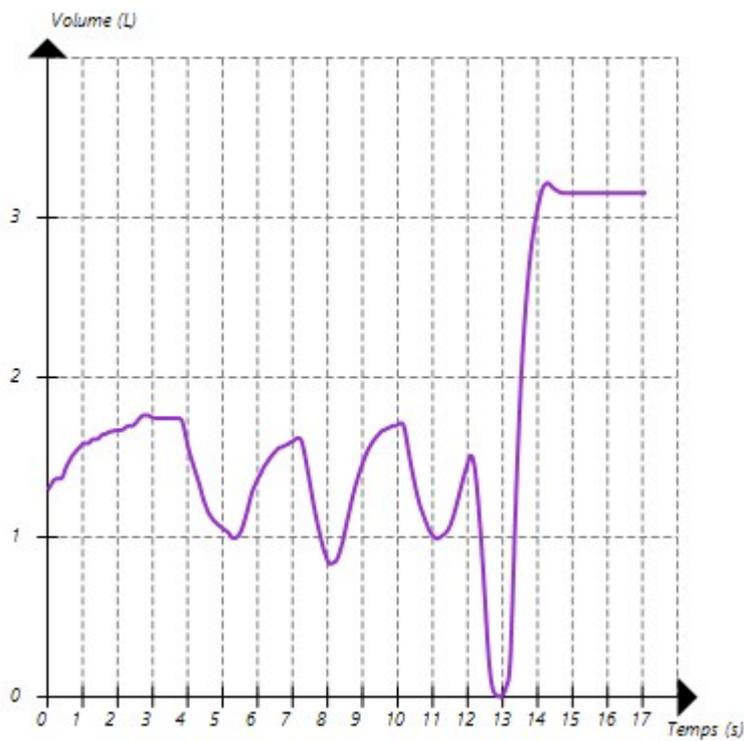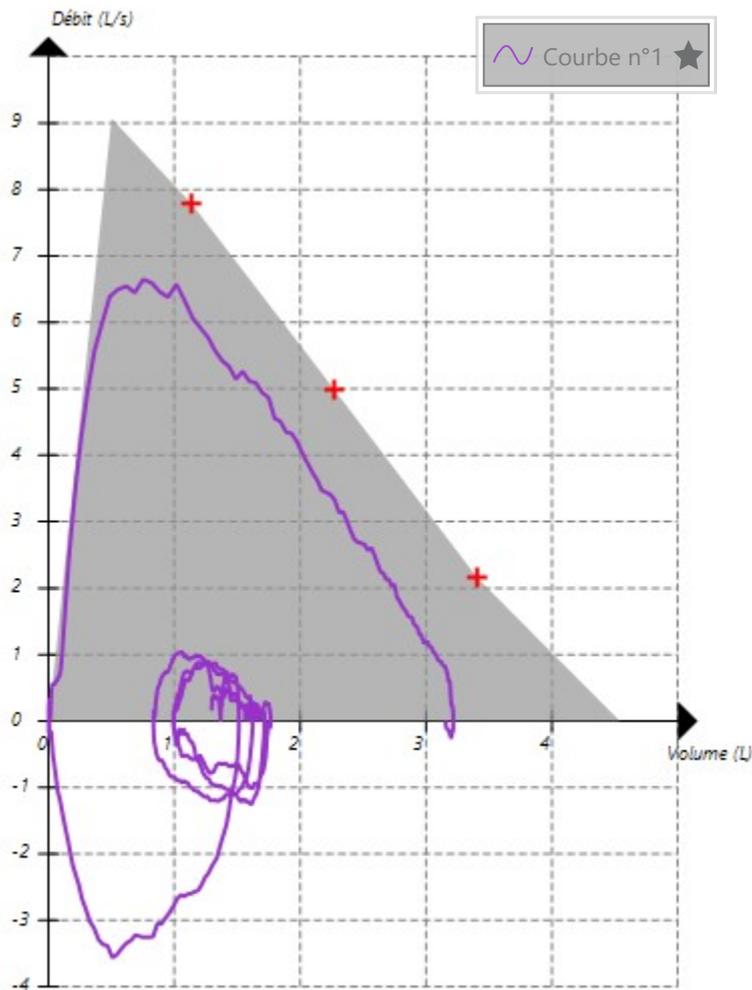

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,22 L	4,54 L	70,93 %
VEMS	3,20 L	3,79 L	84,43 %
DEP	6,75 L/s	9,07 L/s	74,42 %
VEMS/ CVF	99,38 %	80,59 %	123,32 %
Durée d'expiration	1,34 s	-	
DEMM	4,79 L/s	4,43 L/s	108,13 %
DEMM/ CVF	1,49 s-1	0,98 s-1	152,04 %
DE75	6,59 L/s	7,79 L/s	84,60 %
DE50	5,09 L/s	4,99 L/s	102,00 %
DE25	2,83 L/s	2,16 L/s	131,02 %