


<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2003	<b>Profession</b> TAPICIER
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> MBEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 03	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 45 %

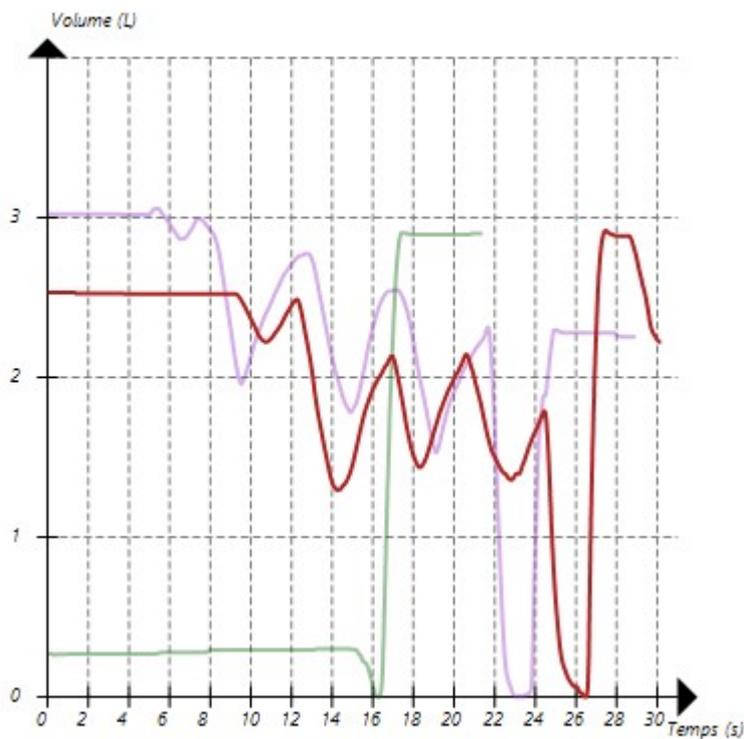

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,27 L	2,91 L	2,92 L	4,79 L	60,96 %
VEMS	2,21 L	2,91 L	2,92 L	4,09 L	71,39 %
DEP	6,43 L/s	5,66 L/s	8,70 L/s	9,53 L/s	91,29 %
VEMS/CVF	97,36 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,22 s	1,18 s	1,02 s	-	
DEMM	3,49 L/s	4,08 L/s	5,23 L/s	4,93 L/s	106,09 %
DEMM/CVF	1,54 s-1	1,40 s-1	1,79 s-1	1,03 s-1	173,79 %
DE75	5,66 L/s	5,12 L/s	8,20 L/s	8,09 L/s	101,36 %
DE50	4,46 L/s	4,46 L/s	5,27 L/s	5,32 L/s	99,06 %
DE25	0,96 L/s	3,12 L/s	3,38 L/s	2,44 L/s	138,52 %