


<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/10/1993	<b>Profession</b> ELINGEURRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> SOGEFEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 36	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %

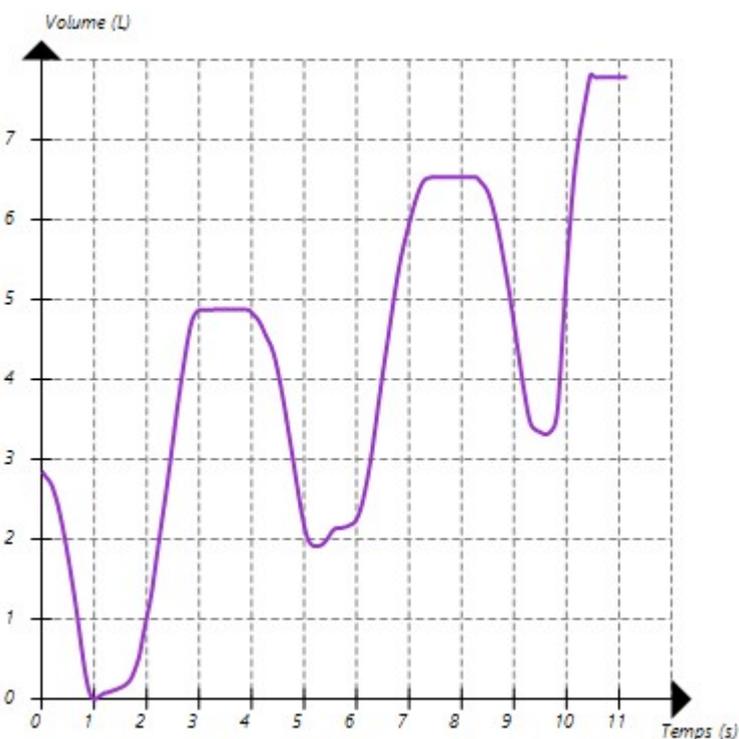

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,51 L	4,00 L	112,75 %
VEMS	4,51 L	3,37 L	133,83 %
DEP	11,25 L/s	8,72 L/s	129,01 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	0,89 s	-	
DEMM	8,81 L/s	3,83 L/s	230,03 %
DEMM/CVF	1,95 s-1	0,96 s-1	203,12 %
DE75	10,96 L/s	-	
DE50	7,91 L/s	-	
DE25	4,95 L/s	-	