



<b>Nom</b> BARO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FACELY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1971	<b>Profession</b> CHAUFFEUR
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> SOGEFEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 25	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 8
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 52 %

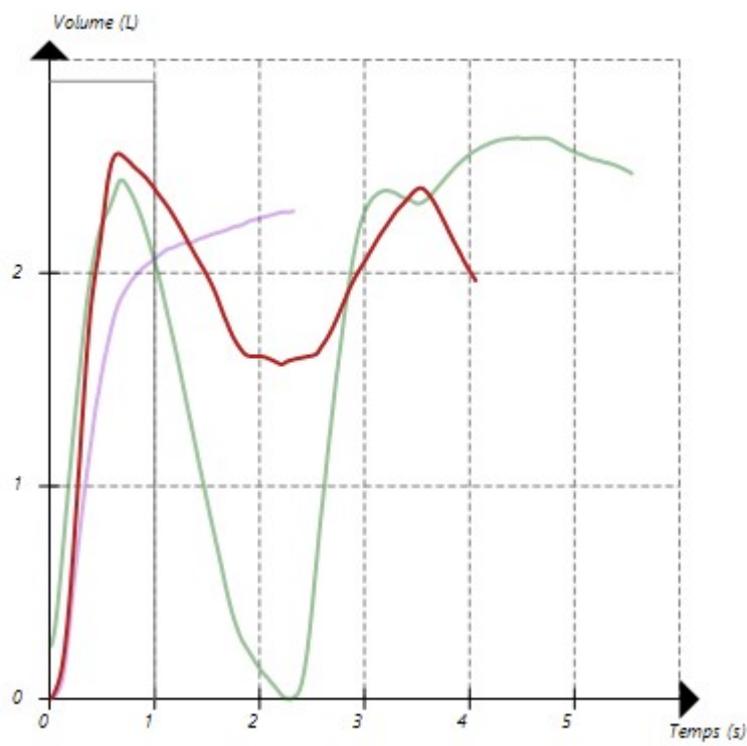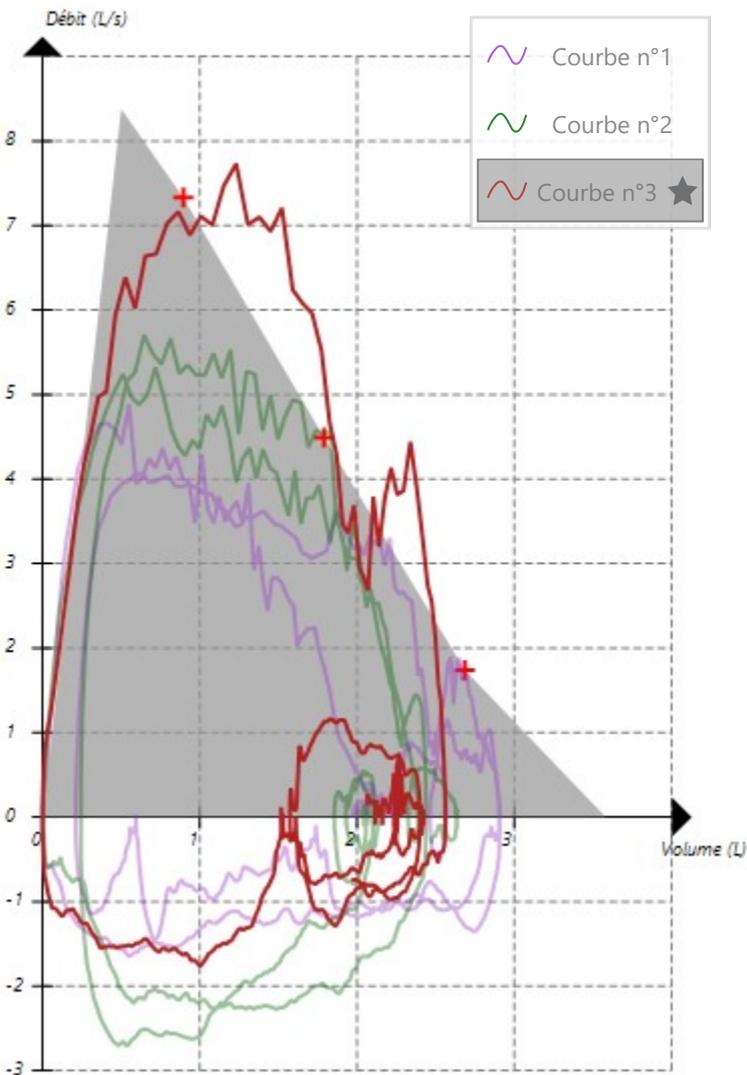

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,29 L	2,20 L	2,56 L	3,58 L	71,51 %
VEMS	2,11 L	2,20 L	2,56 L	2,90 L	88,28 %
DEP	5,15 L/s	5,93 L/s	8,03 L/s	8,38 L/s	95,82 %
VEMS/ CVF	92,14 %	100,00 %	100,00 %	77,72 %	128,67 %
Durée d'expiration	2,35 s	0,68 s	0,65 s	-	
DEMM	3,36 L/s	4,99 L/s	6,53 L/s	3,74 L/s	174,60 %
DEMM/ CVF	1,47 s-1	2,27 s-1	2,55 s-1	0,91 s-1	280,22 %
DE75	4,70 L/s	5,77 L/s	6,62 L/s	7,33 L/s	90,31 %
DE50	3,98 L/s	5,28 L/s	7,05 L/s	4,49 L/s	157,02 %
DE25	2,28 L/s	3,24 L/s	3,97 L/s	1,74 L/s	228,16 %