



<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU DJOUMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/12/1971	<b>Profession</b> superviseur pro et log
<b>Age</b> 52 Ans	<b>Entreprise</b> SOGEFEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 23	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 71 %

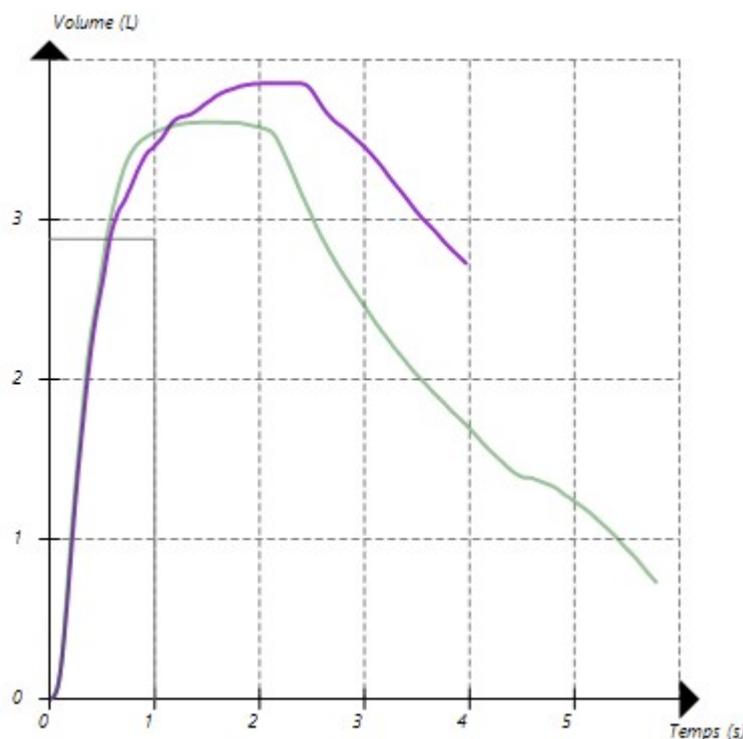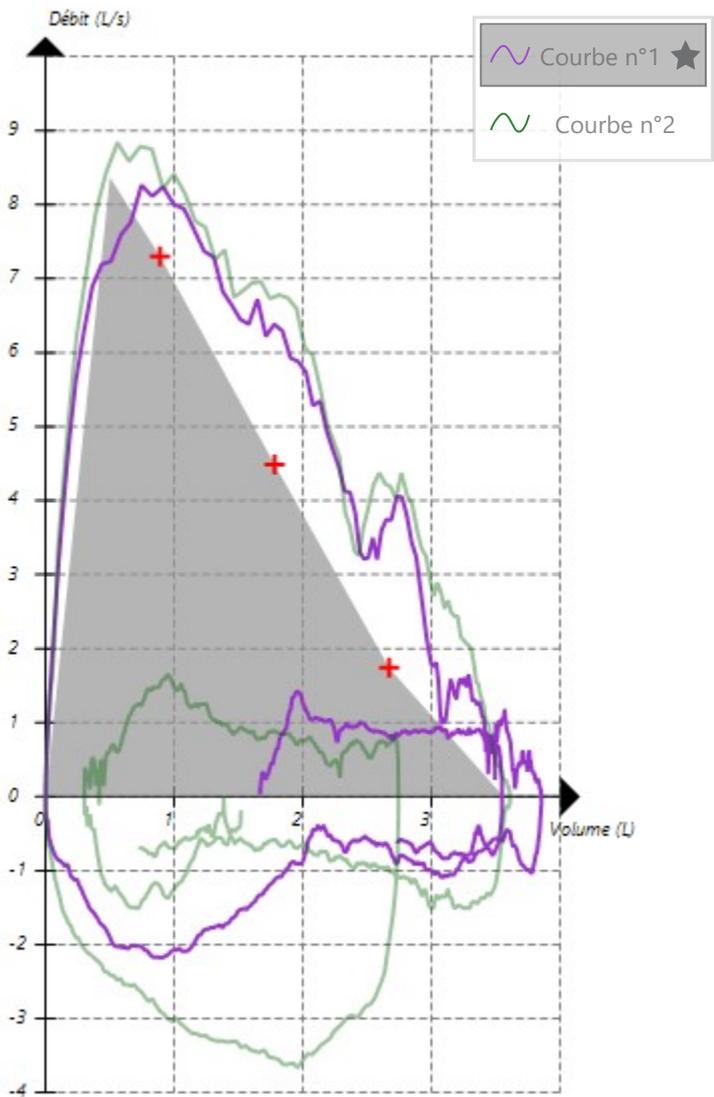

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,85 L	3,61 L	3,56 L	108,15 %
VEMS	3,53 L	3,57 L	2,88 L	122,57 %
DEP	8,40 L/s	9,03 L/s	8,37 L/s	100,36 %
VEMS/ CVF	91,69 %	98,89 %	77,90 %	117,70 %
Durée d'expiration	2,02 s	1,52 s	-	
DEMM	5,25 L/s	5,88 L/s	3,77 L/s	139,26 %
DEMM/ CVF	1,36 s-1	1,63 s-1	0,92 s-1	147,83 %
DE75	7,88 L/s	8,23 L/s	7,30 L/s	107,95 %
DE50	5,77 L/s	6,80 L/s	4,49 L/s	128,51 %
DE25	3,10 L/s	3,94 L/s	1,74 L/s	178,16 %