



<b>Nom</b> BAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU BAILO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/09/1982	<b>Profession</b> TOPOGRAPHE
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> SOGEFEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 09	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 64 %

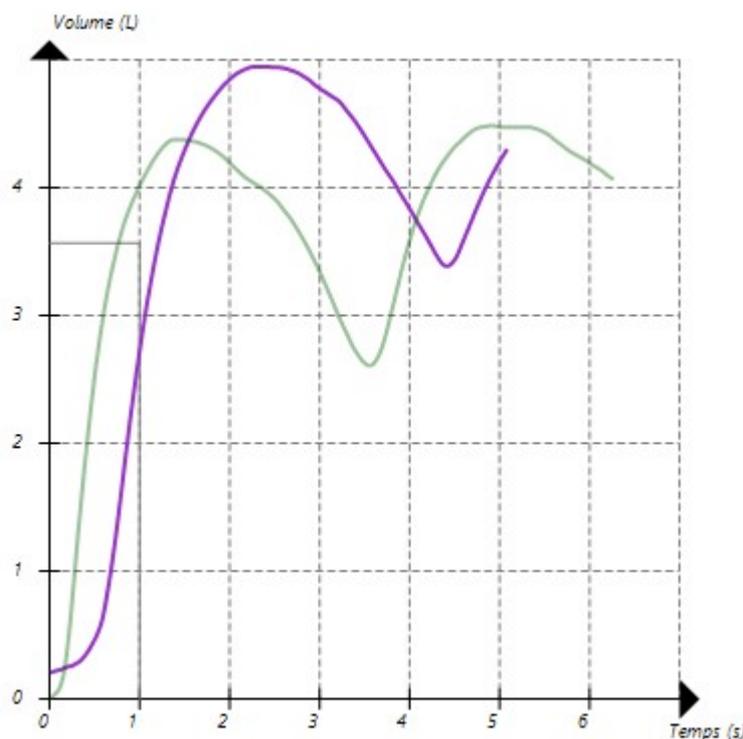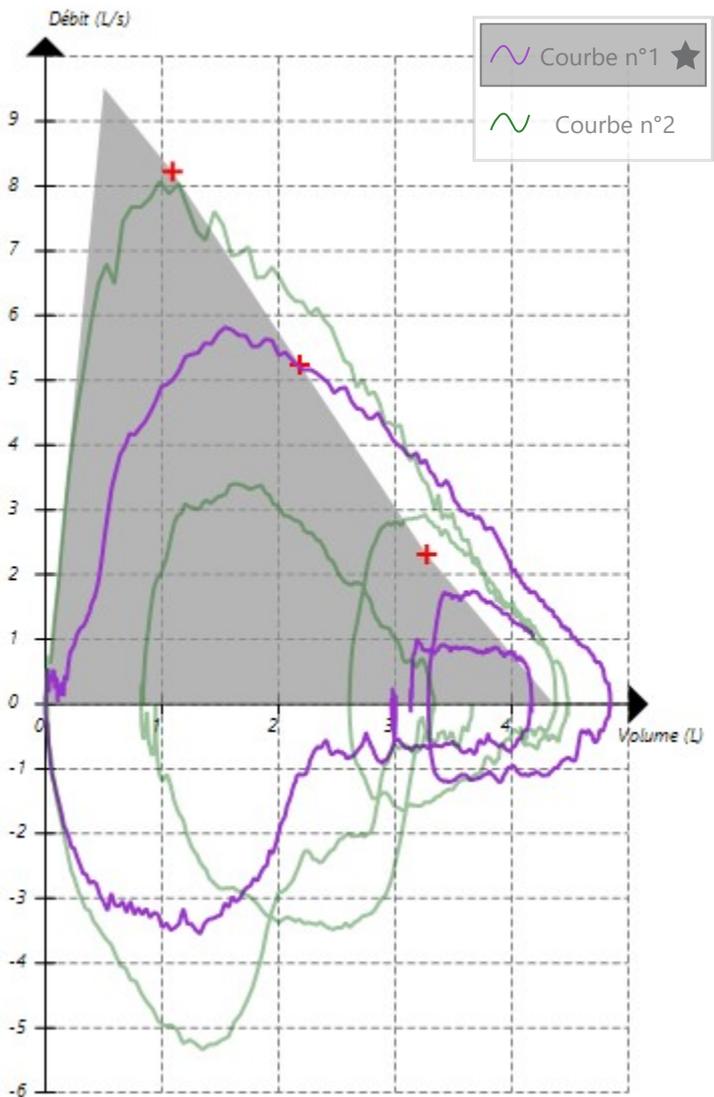

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	4,84 L	4,37 L	4,36 L	111,01 %
VEMS	4,25 L	4,22 L	3,57 L	119,05 %
DEP	5,93 L/s	8,33 L/s	9,52 L/s	62,29 %
VEMS/CVF	87,81 %	96,57 %	79,87 %	109,94 %
Durée d'expiration	2,62 s	1,49 s	-	
DEMM	4,66 L/s	5,77 L/s	4,45 L/s	104,72 %
DEMM/CVF	0,96 s-1	1,32 s-1	0,89 s-1	107,87 %
DE75	5,41 L/s	8,31 L/s	8,22 L/s	65,82 %
DE50	4,94 L/s	6,18 L/s	5,24 L/s	94,27 %
DE25	2,90 L/s	3,36 L/s	2,31 L/s	125,54 %