



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BAKARY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/02/1994	<b>Profession</b> ELECTRICIEN BATIMENT
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> SOGEFEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 170	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,9 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %

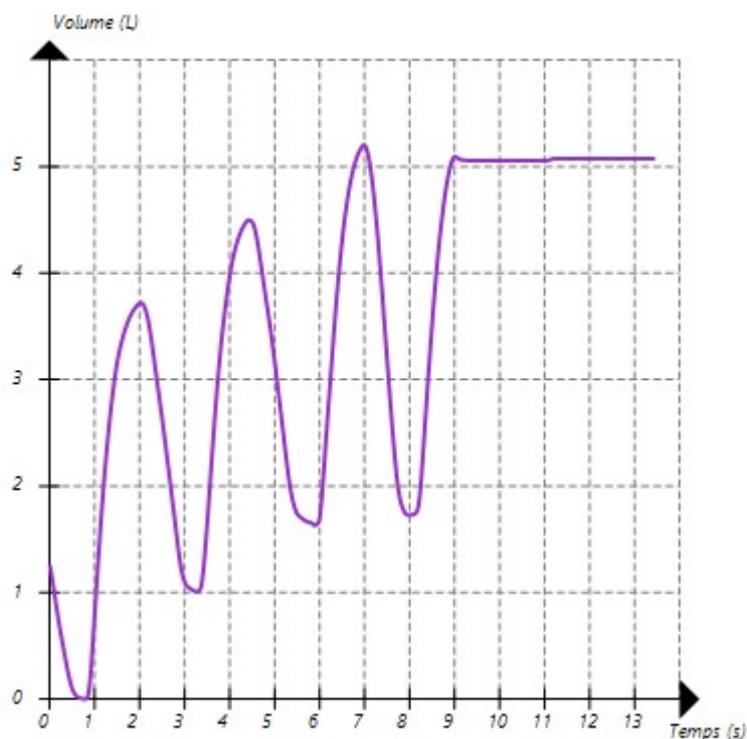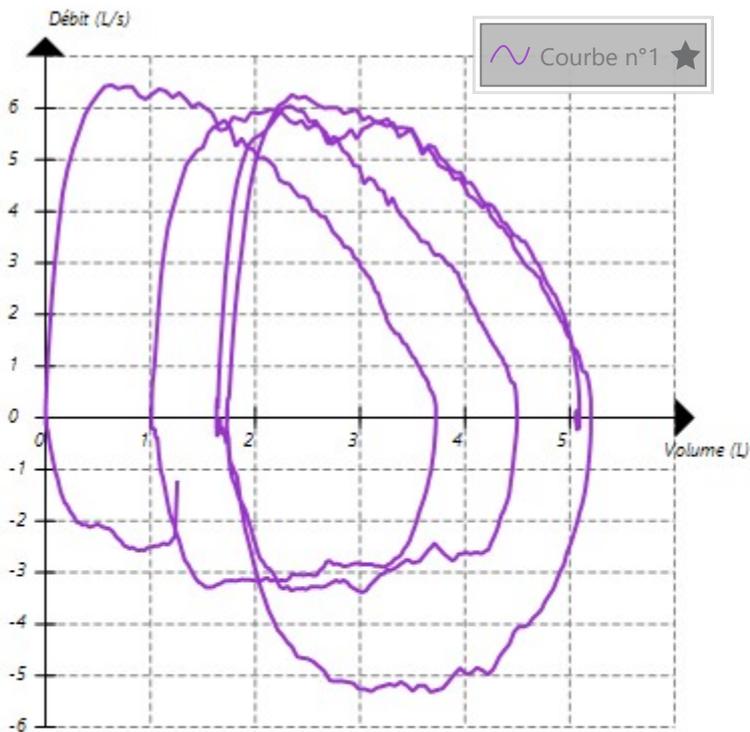

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,72 L	3,93 L	94,66 %
VEMS	3,66 L	3,30 L	110,91 %
DEP	6,56 L/s	8,58 L/s	76,46 %
VEMS/ CVF	98,39 %	83,57 %	117,73 %
Durée d'expiration	1,26 s	-	
DEMM	5,20 L/s	3,75 L/s	138,67 %
DEMM/ CVF	1,40 s-1	0,95 s-1	147,37 %
DE75	6,22 L/s	-	
DE50	5,46 L/s	-	
DE25	3,54 L/s	-	